

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE D'AGULLES, LLANCETES, PALOMETES I CATÈTERS,
PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. PER LOTS**

EXP. CONTR/2023/0000000064

PROCEDIMENT OBERT

SUBJECTE REGULACIÓ HARMONITZADA

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	4
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	4
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS	4
3.1.1 MOSTRES REQUERIDES	5
3.1.2 NORMATIVA	6
3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	6
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR SOBRE DIGITAL	23
4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	23
4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. VALORABLE	23
4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA. VALORABLE	24
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	24
5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS	24
5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	30
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	31
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	33
8 DADES DE CONTACTE	33
9 ANNEXES	
9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS	34
9.2 ANNEX 2. MOSTRES REQUERIDES	38
9.3 ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA I RAPEL	41

1 ANTECEDENTS

L'**Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i desuport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'**OBJECTE** del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible sanitari de d'agulles, llancetes, palometes i catèters, per cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS
LOT 1	AGULLA HIPODÈRMICA	2.963,61 €	8.890,83 €
LOT 2	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA	614,81 €	1.844,43 €
LOT 3	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA PLOMA	12.186,61 €	36.559,83 €
LOT 4	AGULLA ESPINAL	1.669,14 €	5.007,42 €
LOT 5	AGULLA ESPINAL WHITACRE	11.011,00 €	33.033,00 €
LOT 6	AGULLA/KIT EPIDURAL	21.484,60 €	64.453,80 €
LOT 7	AGULLA EPIDURAL AMB XERINGA	2.467,80 €	7.403,40 €
LOT 8	KIT ANSTÈSIA EPIDURAL OBESITAT	290,68 €	872,04 €
LOT 9	AGULLA PARACENTESIS	839,97 €	2.519,91 €
LOT 10	AGULLA CÀRREGA	12.973,67 €	38.921,01 €
LOT 11	AGULLA QUIMIO	2.168,10 €	6.504,30 €
LOT 12	AGULLA BIÒPSIA	398,09 €	1.194,27 €
LOT 13	AGULLA CHIBA	1.814,40 €	5.443,20 €
LOT 14	AGULLA ACUPUNTURA	565,75 €	1.697,25 €
LOT 15	PUNCH BIÒPSIA	656,85 €	1.970,55 €
LOT 16	LLANCETA AMNIORREXI	86,11 €	258,33 €
LOT 17	LLANCETA DE SEGURETAT PER MOSTRA DE SANG	6.181,92 €	18.545,76 €
LOT 18	LLANCETA PROVA TALÓ	462,13 €	1.386,39 €
LOT 19	PALOMETA AMB SEGURETAT	26.870,62 €	80.611,86 €
LOT 20	CATÈTER DE SEGURETAT	66.533,17 €	199.599,51 €
LOT 21	COMPTADOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	2.130,89 €	6.392,67 €
LOT 22	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	2.750,00 €	8.250,00 €

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 34 i s.)**.

Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	531.359,76 €
Import total amb IVA:	642.945,31 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 531.359,76 € (SENSE IVA) (21% IVA) 3 ANYS.

Pròrrogues: SI. 177.119,92 € + 177.119,92 € = 354.239,84 €

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = 106.271,95 €

Import total VEC = 991.871,55 € (SENSE IVA) (21% IVA).

2.3 DURADA DEL CONCURS

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS

1. En fase d'execució del contracte, l'incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.

2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
4. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
5. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
6. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
7. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària oferirà una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.
8. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

3.1.1 MOSTRES

Serà **OBLIGATORI** que la licitadora envii les mostres requerides a **l'ANNEX 2 – MOSTRES REQUERIDES (pàg. 38 i s.)**.

Les mostres han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica i s'hauran d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data de l'entrega. En el cas que alguna licitadora no envii les mostres, quedarà **EXCLOSA del procés de licitació.**

Les mostres hauran de portar identificat el número de lot i el codi de l'IAS.

3.1.2 NORMATIVA APLICABLE OBLIGATÒRIA

Tots els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Caldrà aportar al Sobre B:

- Certificat del **Marcatge CE** en la classe i modalitat pertinents d'aquells articles als quals els resulti exigible, d'acord amb la Directiva 93/42/EEC o Reglament EU 2017/745.
- Acreditació del compliment de les següents normatives mitjançant normativa o declaració signada del compliment:
 - **UNE-EN ISO 13485** - Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits per a fins reglamentaris. **Per a tots els lots.**
 - **UNE-EN ISO 23908:2013** - Protecció contra ferides punxants. Requisits i mètodes d'assaig. Dispositius de protecció d'agulles hipodèrmiques, introductors decatèters i agulles usades per a l'ús de sang, no reutilitzables. **Per als lots: 1, 19, 20.**
 - **UNE-EN ISO 7864** - Relativa a agulles hipodèrmiques estèrils d'un sol ús. Requisits i mètodes d'assaig. **Per als lots: 1, 10, 19, 20.**

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS


Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. **L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.**

Les característiques i mides dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

Les fotos són una mostra del producte que es licita, en cap cas són vinculants. El producte ofert podrà ser igual o equivalent al de la foto, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si s'ajusten a les necessitats del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 AGULLA HIPODÈRMICA

50859	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM AMB SEGURETAT
50864	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM AMB SEGURETAT
50866	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX40MM AMB SEGURETAT
50867	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX25MM AMB SEGURETAT

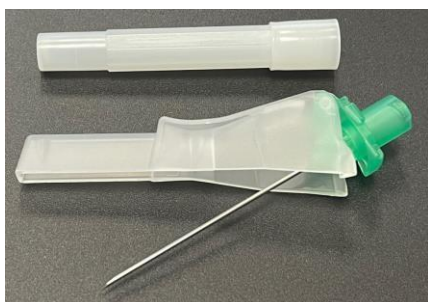

REQUISITS MÍNIMS:

Agulla hipodèrmica amb sistema de seguretat integrat i irreversible amb escut protector que cobreix la totalitat de l'agulla per evitar risc de punxada. Sistema de seguretat activable amb una sola mà o automàticament (sistema actiu o passiu). L'activació del mecanisme de seguretat es manifestarà a l'usuari mitjançant senyal auditiu/visual. Agulla apirògena i atòxica. Bisell atraumàtic triple facetat, amb funda protectora, translúcida o transparent, amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Parets primes, lubricant grau mèdic. Connexió Luer/Luer Lock compatible amb xeringues amb cono Luer així com tubs d'extracció al buit. Acer inoxidable d'ús mèdic bisellat. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

51933	AGULLA HIPODÈRMICA 30G 0,30X12MM SENSE SEGURETAT
53824	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM SENSE SEGURETAT
53655	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM SENSE SEGURETAT
52089	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X50MM SENSE SEGURETAT



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla hipodèrmica. Apirògena i atòxica. Bisell atraumàtic triple facetat, amb funda protectora, translúcida o transparent, amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Parets primes, lubricant grau mèdic. Connexió Luer/Luer Lock compatible amb xeringues amb cono Luer així com tubs d'extracció al buit. Acer inoxidable d'ús mèdic bisellat. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 2 AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA

50863	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM AMB SEGURETAT
-------	--



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla hipodèrmica per insulina. Amb sistema de bioseguretat integrat, irreversible amb escut protector que cobreix la totalitat de l'agulla per evitar risc de punxada. Sistema de seguretat activable una sola mà o automàticament (sistema actiu o passiu). L'activació del mecanisme de seguretat es manifestarà a l'usuari mitjançant senyal auditiu/visual. Agulla Apirògena i atòxica. Bisell atraumàtic triple facetat, amb funda protectora translúcida o transparent, amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Lubricada grau mèdic. Connexió Luer/Luer Lock. amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Acer inoxidable d'ús mèdic bisellat. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 25G 0,5mmX16mm.

53713	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM SENSE SEGURETAT
-------	--



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla hipodèrmica per insulina. Apirògena i atòxica. Bisell atraumàtic triple facetat, amb funda protectora translúcida o transparent, amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Lubricada grau mèdic. Connexió Luer/Luer Lock. amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Acer inoxidable d'ús mèdic bisellat. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 25G 0,5mmX16mm.

LOT 3 AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA PLOMA

50860	AGULLA INSULINA 31G 0,25X5MM PLOMA
50861	AGULLA INSULINA 31G 0,25X8MM PLOMA



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla hipodèrmica per ploma d'insulina. Apirògena i atòxica. Bisell atraumàtic triple facetat de paret fina, amb una o dues fundes protectores translúcides o transparents i precinte de paper. amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Lubricada grau mèdic. Connexió Luer Lock 100% compatible amb totes les plomes d'insulina. Acer inoxidable d'ús mèdic. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

53303	AGULLA INSULINA 30G 0,30X5MM PLOMA DOBLE SEGURETAT
53304	AGULLA INSULINA 30G 0,30X8MM PLOMA DOBLE SEGURETAT



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla hipodèrmica per ploma d'insulina amb doble sistema de seguretat, amb protecció en tots dos extrems. Agulla oculta a la vista. Apirògena i atòxica. Bisell atraumàtic triple facetat de paret fina, amb una o dues fundes protectores translúcides o transparents i precinte de paper. amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Lubricada grau mèdic. Connexió Luer Lock 100% compatible amb totes les plomes d'insulina. Acer inoxidable d'ús mèdic. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 4 AGULLA ESPINAL

50872	AGULLA ESPINAL 18GX3.5 - 1.2X90MM
50873	AGULLA ESPINAL 19GX3.5 - 1.1X90MM
50874	AGULLA ESPINAL 20GX1.5 - 0.9X38MM
50875	AGULLA ESPINAL 20GX3.5 - 0.9X90MM
52189	AGULLA ESPINAL 22GX1.5 - 0.7X38MM
50876	AGULLA ESPINAL 22GX3.5 - 0.7X90MM
50879	AGULLA ESPINAL 25GX1.0 - 0.5X25MM
50877	AGULLA ESPINAL 25GX3.5 - 0.5X90MM




REQUISITS MÍNIMS:

Agulla espinal amb punta bisellada tipus Quincke per punció lumbar. Apirògena i atòxica. Cànula d'acer inoxidable. Mandril obturador amb marca de seguretat al pavelló de l'agulla, per permetre la correcta alineació dels bisells. Pavelló transparent. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 5 AGULLA ESPINAL WHITACRE

50882	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX90MM
50884	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX90MM
50885	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX115MM
50887	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX115MM
51595	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX90MM
51596	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX120MM

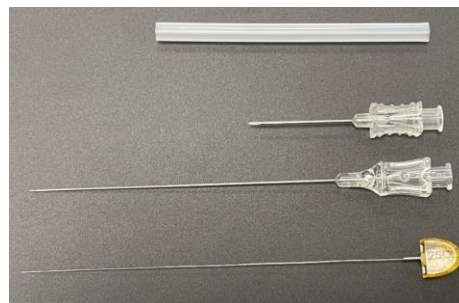

REQUISITS MÍNIMS:

Agulla espinal per punció lumbar. Amb introductor tipus whitacre amb agulla guia per a la introducció de l'agulla de punció lumbar. Apirògena i atòxica. Pavelló transparent. Amb marca per la correcta alineació dels bisells. Protector per l'agulla de polipropilè o similar, amb connexió a xeringa Luer Lock. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 6 AGULLA/KIT EPIDURAL

53608	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 20GX50MM
52308	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 22GX50MM
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX80MM
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX120MM



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla per punció epidural tipus Touhy. Acer inoxidable. Agulla apirògena i atòxica. Graduada en cm per l'agulla de 18G i en 0,5 cm per les pediàtriques 20G i 22G. Pavelló transparent i aletes integrades. Amb connexió Luer-lock. Mandril amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

51415	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18GX80MM
-------	---------------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Kit d'anestèsia epidural format per: Agulla tipus Tuohy. Amb marques de profunditat cm i mandril codificat segons color normatiu. Pavelló i aletes integrades transparents. Xeringa de baixa fricció tipus LOR de 10ml. Catèter transparent de 3 forats, punta tancada i línia radiopaca. Guia de catèter per facilitar la introducció del catèter. Connector de catèter pla tipus cocodril, de color groc, amb activació per una sola mà. Filtre pla de color groc de 0.2 µm per 0,45ml aprox. Amb etiqueta identificativa de color groc per identificació del catèter epidural. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 18Gx80mm.

52303	KIT ANESTESIA EPIDURAL COMBINADA 18GX88MM
-------	---



REQUISITS MÍNIMS:

Kit d'anestèsia epidural format per: Agulla tipus Tuohy. Amb orifici a la curvatura. Amb marques de profunditat cm i mandril codificat segons color normatiu. Aletes fixes i pavelló transparents. Agulla espinal tipus punta llapis de 27G i llargària aprox. de 138mm amb recobriment. Sistema de fixació que permeti rotació de l'agulla espinal. Xeringa de baixa fricció tipus LOR de 10ml. Catèter transparent de 3 forats i punta atraumàtica tancada, de 100 cm de longitud. Connector de catèter pla tipus cocodril, tunelitzat, sense rosques, de color groc, amb activació per una sola mà. Amb filtre pla de color groc de 0.2 µm per 0,45ml aprox. Amb sistema de fixació del filtre rotatori amb adhesiu hipoal·lèrgic. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 18Gx88mm.

LOT 7 AGULLA EPIDURAL AMB XERINGA

50918	AGULLA EPIDURAL TUOHY AMB XERINGA 18GX80mm
-------	--



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla per punció epidural tipus Touhy. Acer inoxidable. Agulla apirògena i atòxica. Graduada en cm per l'agulla de 18G. Pavelló transparent i aletes integrades. Amb connexió Luer-lock. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Amb xeringa de baixa fricció tipus LOR de 6 ml i tap de seguretat. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 18Gx80mm.

LOT 8 KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT

51416	KIT ANÈSTESIA EPIDURAL OBESITAT 18GX110MM
-------	---



REQUISITS MÍNIMS:

Kit d'anestèsia epidural format per: Agulla tipus Tuohy de 18G, bisell corbat de 110mm de longitud amb marques de profunditat i mandril. Aletes de plàstic. Xeringa de baixa fricció tipus LOR de 10ml. Catèter transparent de 3 forats i punta tancada. Guia de catèter per facilitar la introducció del catèter. Amb filtre pla de color groc de 0.2 µm per 0,45ml aprox. Connector de catèter pla, de color groc, amb activació per una sola mà. Amb etiqueta identificativa de color groc per identificació del catèter epidural. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 18GX110 mm.

LOT 9 AGULLA PARACENTESIS

50909	AGULLA PARACENTESIS 17G 70MM
-------	------------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla per punció abdominal. Tribisellada. Amb connexió Luer Lock, orifici distal i dos orificis laterals per facilitar el drenatge de líquid ascític. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 17GX70mm.

LOT 10 AGULLA CÀRREGA

52748	AGULLA CÀRREGA 18G 1,20X40MM PUNTA ROMA 40º
-------	---



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla de càrrega amb punta roma per la preparació de medicació. Amb lubricant de grau mèdic. Acer inoxidable. Amb funda protectora de color. Connexió Luer/Luer Lock. Acer inoxidable d'ús mèdic bisellat. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 18G 1,20X40mm Punta Roma 40º.

LOT 11 AGULLA QUIMIO

50895	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX15MM
53705	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX16MM
53687	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX20MM
50891	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX32MM
50892	AGULLA QUIMIO S/Y 22GX25MM



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla amb punta de bisell per a punció de reservoris implantables. Angulada 90° amb plataforma encoixinada i aletes per facilitar subjecció. Línia d'extensió per a infundir a llarg termini. Compatible amb la injecció d'alta pressió (fins a 325 psi aprox.). No siliconada. Amb sistema de seguretat amb mecanismes de confirmació visual i auditiva d'activació. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

50890	AGULLA QUIMIO A/Y 20GX19MM
-------	----------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla amb punta de bisell tipus Huber per a punció de reservoris implantables amb sistema de bioseguretat. Agulla acer inoxidable amb plataforma encoixinada i aletes per facilitar subjecció. Amb connector en Y. Línia d'extensió per a infundir a llarg termini. Compatible amb la injecció d'alta pressió (fins a 325 psi aprox.). No siliconada. Amb sistema de seguretat amb mecanismes de confirmació visual i auditiva d'activació. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 20Gx19mm.

LOT 12 AGULLA BIOPSIA

51410	AGULLA BIÒPSIA M.ÒSSIA 8GX10CM
-------	--------------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla per la biòpsia de medul·la òssia en estèrnum o cresta ilíaca. Agulla i cànula amb puntes esmolades. Amb mànec, recollidor de mostra i estilet. Connexió Luer Lock. Acer inoxidable d'ús mèdic. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 8Gx100mm.

51430	AGULLA BIÒPSIA ASPIRACIÓ M. ÒSSIA 15GX75CM
-------	--




REQUISITS MÍNIMS:

Agulla per aspiració de medul·la òssia en estèrnum o cresta ilíaca. Amb mànec. Connexió Luer Lock. Acer inoxidable d'ús mèdic. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 15Gx75mm.

LOT 13 AGULLA CHIBA

50915	AGULLA CHIBA 22GX120MM
-------	------------------------

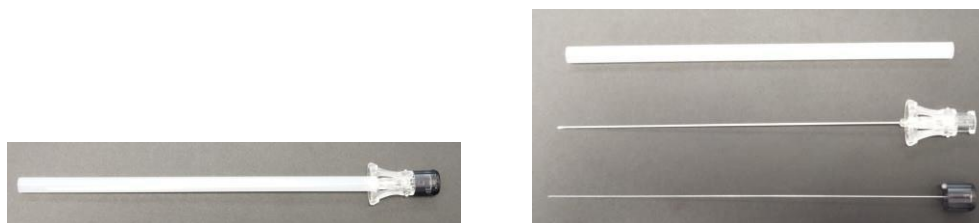

REQUISITS MÍNIMS:

Agulla de biòpsia tipus Chiba. Amb mandril metàl·lic amb bisell curt adequat per l'obtenció de mostres de teixits tous per a aspiració, permet també l'administració de líquids de contrast o fàrmacs. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: 22GX120MM.

LOT 14 AGULLA ACUPUNTURA

53200	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X13MM
52333	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X25MM
52334	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X50MM
52335	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X75MM



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla acupuntura per punció seca. Agulla sense cap, amb guia, afilat en forma cònica i triple capa d'oli. Amb mànec reforçat i rígid. Acer inoxidable quirúrgic i mínim 2% de molibdè. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

52336	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X25MM
52337	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X40MM



REQUISITS MÍNIMS:

Agulla acupuntura. Mànec de plata amb dos capes oli i dos processos de polit. Cap rodó. Amb tub guia. Acer inoxidable quirúrgic. Envàs individual estèril de paper. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 15 PUNCH BIÒPSIA

50904	PUNCH BIÒPSIA 2MM
50905	PUNCH BIÒPSIA 3MM
50906	PUNCH BIÒPSIA 4MM
50907	PUNCH BIÒPSIA 5MM
53932	PUNCH BIÒPSIA 6MM
53968	PUNCH BIÒPSIA 8MM



REQUISITS MÍNIMS:

Punch circular per biòpsia. Amb mànec de plàstic rígid. Amb extrem distal d'acer inoxidable amb vores tallant sense soldadures. Diàmetre indicat a cada punch. Envàs individual estèril. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 16 LLANCETA AMNIOREXI

51134	LLANCETA AMNIOREXI 26,5CM
-------	---------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Llanceta amniorrexis estèril d'alta visibilitat, amb punt de ruptura arrodonit. Envàs individual estèril. Lliure de làtex, PVC i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Mida: Longitud 26,5 cm.

LOT 17 LLANCETA DE SEGURETAT PER MOSTRA DE SANG

50917	LLANCETA DE SEGURETAT 23GX1,8MM
-------	---------------------------------



Llanceta estèril amb dispositiu de seguretat integrat per punció capil·lar per extracció de sang. Sistema de retracció irreversible d'un sol ús. Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau mèdic de triple bisellat. Agulla totalment protegida. Lliure de làtex. Mida: 23Gx1,8mm.

LOT 18 LLANCETA PROVA TALÓ

53179	LLANCETA 1.75X1.0MM
-------	---------------------



Dispositiu de plàstic amb agulla d'acer inoxidable protegida a la punta i sistema de retracció automàtica per punció neonatal. Per nadons d'entre 2,5 kg a 9 kg. Envàs individual estèril. Presentació individual. Profunditat incisió: 1 mm. Longitud incisió: 3mm. Un sol ús.

LOT 19 PALOMETA AMB SEGURETAT

50958	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 21G X3/4" 19 CM
50956	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 23G X 3/4"
50957	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 25 G X 3/4"



REQUISITS MÍNIMS:

Palometa d'infusió amb dispositiu de seguretat integrat. Agulla d'acer inoxidable siliconada d'extrem triplement bisellat, muntada sobre suport amb dues aletes laterals. Amb connector Luer. Amb tub transparent o translúcid i pinça lliscant per pressionar el tub. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

52288	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT 21G X 3/4"
-------	---



REQUISITS MÍNIMS:

Palometa d'extracció per buit amb dispositiu de seguretat. Palometa amb agulla d'acer inoxidable siliconada d'extrem triplement bisellat, amb protector, muntada sobre suport amb dues aletes laterals. Amb agulla protegida per una vàlvula. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

51566	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 21G X 3/4"
52168	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 23G 1 CM



REQUISITS MÍNIMS:

Palometa d'extracció per buit amb dispositiu de seguretat i porta tubs premontat. Palometa amb agulla d'acer inoxidable siliconada d'extrem triplement bisellat, amb protector, muntada sobre suport amb dues aletes laterals. Porta tubs amb cos transparent o translúcid compatible amb tots els tubs d'extracció de sang i amb agulla protegida per una vàlvula. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 20 CATÈTER DE SEGURETAT

00000	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 14GX32MM
54154	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 16GX32MM
54151	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 18GX32MM

54152	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 20GX32MM
54153	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 22GX25MM
54155	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 24GX19MM



REQUISITS MÍNIMS:

Catèter intravascular perifèric de seguretat passiva, de poliuretà (PUR), 4 línies radioopaques i agulla siliconada. Amb escut protector a bisell automàtic. Amb cos transparent. Connexió Luer Lock amb vàlvula /membrana anti reflux i plataforma d'estabilització. Amb codi de colors normalitzats per la identificació de les agulles. Envàs individual estèril. Lliure de làtex i DEHP. Un sol ús. Presentació individual. Diferents mides.

LOT 21 COMPTADOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC

00000	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 15 AGULLES
-------	--------------------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Sistema de comptatge i eliminació d'agulles i bisturís. Caixa de plàstic rígid. Amb mecanisme de bloqueig de la caixa per tancar-la després del comptatge. S'ha de poder tornar a obrir si és necessari un recompte. Amb combinació de superfície magnètica i d'escuma amb o sense llevafolles. Per recompte de 15 agulles. Desmuntable en 2 parts per a usar per separat, si és necessari. Amb revers adhesiu per espai de treball.

00000	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 40 AGULLES
-------	--------------------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Sistema de comptatge i eliminació d'agulles i bisturís. Caixa de plàstic rígid. Amb mecanisme de bloqueig de la caixa per tancar-la després del comptatge. S'ha de poder tornar a obrir si és necessari un recompte. Amb combinació de superfície magnètica i d'escuma amb o sense lleva fulles. Per recompte de 40 agulles. Desmuntable en 2 parts per a usar per separat, si és necessari. Amb revers adhesiu per espai de treball.

LOT 22 CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC

00000	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC
-------	-------------------------------------



REQUISITS MÍNIMS:

Contenidor d'un sol ús per eliminació d'agulles i objectes punxants durant el procés quirúrgica. Caixa de plàstic transparent. Tap amb tancament giratori sense retorn. Biodegradable. Estèril. Mides: 95 mm alt i base quadrada de 125x125 mm de base quadrada.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb les característiques tècniques definides en el punt 3 Requeriments Tècnics de l'Objecte d'aquest plec. En el cas que alguna de les característiques tècniques sol·licitades no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 41 i s.)**.

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (VALORABLE)

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE - MÀXIM 50 PUNTS

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti al Sobre B, els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

1. **CERTIFICATS I ACREDITACIONS** de la normativa requerida al punt 3.1.2 de la pàg. 6. Caldrà indicar a quina pàgina es troba cada certificat o acreditació presentat a la documentació.
2. **FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques de cada article ofert i els requeriments tècnics específics remarcats amb color.
3. Caldrà aportar el **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades.

Tota la documentació tècnica presentada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 50 PUNTS.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 41 i s.)**, degudament signada.

- **Proposta econòmica. (màxim 40 punts).** Omplir document "DADES OFERTA ECONÒMICA" i "OFERTA ECONÒMICA"
- **Ràpel. (màxim 5 punts).** Omplir document "DADES OFERTA ECONÒMICA".
- **Transport amb temperatura controlada. (màxim 5 punts).** Adjuntar el certificat del transport ofert amb les característiques.

5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS

La valoració tècnica es farà en base les mostres requerides al punt **3.1.1 – Mostres**. La valoració dels 50 punts es farà per cada lot en funció de les mostres rebudes i segons els següents criteris:

LOTS 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Per les referències dels lots que disposin de mecanisme de seguretat, es valorarà la funcionalitat i fiabilitat del mecanisme de seguretat, que s'adapti millor a la metodologia d'ús de la part assistencial, així com, que eviti possibles exposicions a la sang o punxades accidentals, que no presenti fragilitat i que no es pugui inactivar. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà la facilitat d'ús del material per la part assistencial, especialment que el sistema faciliti la tècnica de punció i ofereixi una òptima visualització durant el procediment. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà la qualitat i el comportament de material en el seu conjunt durant l'ús i envers el pacient, especialment el lliscament en la inserció de l'agulla, el bisell de l'agulla, el sistema de subjecció, l'activació dins el cos del pacient i la resistència. Màxim 10 punts.

LOTS 4, 5, 9, 13

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Es valorarà que l'agulla s'adapti correctament a les xeringues o altres connexions que disposa l'hospital. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà la facilitat d'ús del material per la part assistencial, especialment que el sistema faciliti la tècnica de punció i ofereixi una òptima visualització durant el procediment. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà la qualitat i el comportament de material en el seu conjunt durant l'ús i envers el pacient, especialment el lliscament en la inserció de l'agulla, el bisell de l'agulla, el sistema de subjecció, l'activació dins el cos del pacient i la resistència. Màxim 10 punts.

LOTS 6, 8

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Es valorarà l'agulla en relació la mida útil, les marques de profunditat i el bisell. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà la consistència de l'agulla i del catèter, que no es colzi o doblegui. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà la sensació a l'entrar l'agulla a l'espai intradural. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà la fiabilitat del connector del catèter. Màxim 10 punts.

LOT 7

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Es valorarà l'agulla en relació la mida útil, les marques de profunditat i el bisell. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà la consistència de l'agulla. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà la sensació a l'entrar l'agulla a l'espai intradural. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà la xeringa de pèrdua de resistència. Màxim 10 punts.

LOT 10

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Es valorarà que l'agulla s'adapti correctament a les xeringues que disposa l'hospital. Màxim 10 punts.

4. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà la facilitat d'ús del material especialment que el bisell de l'agulla permeti la inserció i extracció i no perdi el seu estat físic en l'ús. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà que l'agulla es tregui perfectament i que no costi la desconnexió en el contenidor al rebutjar-la. Màxim 10 punts.

LOT 11

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Es valorarà la funcionalitat i fiabilitat del mecanisme de seguretat, que s'adapti millor a la metodologia d'ús de la part assistencial, així com, que eviti possibles exposicions a la sang opunxades accidentals, que no presenti fragilitat i que no es pugui inactivar. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà la facilitat d'ús del material per la part assistencial, especialment que el sistema faciliti la tècnica de punció, la mida útil de l'agulla i que ofereixi una òptima visualització durant el procediment. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà la qualitat i el comportament de material en el seu conjunt durant l'ús i envers el pacient, especialment el lliscament en la inserció de l'agulla, el bisell de l'agulla, el sistema de subjecció, l'activació dins el cos del pacient i la resistència. Màxim 10 punts.

LOT 12

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.

3. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà el tipus de punta de l'agulla i de la cànula. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà l'ergonomia del mànec. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà el sistema d'extracció i aspiració que ofereix l'agulla. Màxim 10 punts.

LOT 14

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts.
3. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 10 punts.
4. Es valorarà el disseny i l'ergonomia de l'agulla en relació al cap de l'agulla, el mànec o el tub guia. Màxim 10 punts.
5. Es valorarà l'afilat de l'agulla. Màxim 10 punts.
6. Es valorarà la flexibilitat i la resistència de l'agulla. Màxim 10 punts.

LOT 15

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 7 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 7 punts.
3. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 12 punts.
4. Es valorarà el disseny i l'ergonomia del mànec. Màxim 12 punts.
5. Es valorarà la qualitat del tall. Màxim 12 punts.

LOT 16

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 7 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 7 punts.
3. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 12 punts.
4. Es valorarà el disseny i l'ergonomia del mànec. Màxim 12 punts.
5. Es valorarà la funcionalitat del material durant el procediment, especialment el lliscament i l'efectivitat del ganxo, per tal que s'ajusti a la seva funció, essent el menys traumàtic pel pacient. Màxim 12 punts.

LOTS 21, 22

1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 7 punts.
2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 7 punts.
3. Es valorarà l'ergonomia del material en el seu conjunt per tal que s'adapti a les diferents característiques individuals de la part assistencial, com ara les característiques antropomètriques, lateralitat, mida de les mans etc. Màxim 12 punts.
4. Es valorarà el disseny i l'ergonomia del material per tal que s'ajusti a la seva funció. Màxim 12 punts.
5. Es valorarà la resistència del material especialment a les punxades. Màxim 12 punts.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri**, de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si capde les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2):

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica i ràpel (ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 41 i s.)).

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1.PREU DE L'OBJECTE (FINS A 40 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **40 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,40**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu).

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe) * 5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

3. TRANSPORT AMB TEMPERATURA CONTROLADA (FINS A 5 PUNTS)

Es valorarà amb 5 punts la certificació del servei d'entrega de totes les comandes durant tota la vigència de l'expedient per transport amb temperatura controlada, per tal d'evitar deformacions del plàstic durant l'estada al camió degut a la calor.

IMPREScindible adjuntar el certificat del transport ofert amb les característiques. La no aportació d'aquest document implicarà una valoració de 0 punts d'aquest criteri.

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

1. GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre i a assegurar el termini de lliurament que s'indica en aquest plec. Qualsevol aspecte relacionat amb el subministrament s'haurà de comunicar als Serveis Logístics de l'IAS.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir a disposició de l'IAS un estoc prou ampli, com per satisfer el més aviat possible les necessitats que puguin sorgir.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un telèfon i un correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que sorgeixi.

L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en el disponibilitat comercial dels articles que poguessin suposar un risc de trencament d'estoc i proposar la substitució del producte afectat sempre que el motiu sigui aliè a l'empresa adjudicatària.

En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat i tornar-ho a comunicar quan torni a disposar d'existències. Davant aquesta situació l'empresa adjudicatària assumirà les despeses que es puguin produir com ara enviaments urgents.

L'IAS es reserva el dret a realitzar comandes a un altre proveïdor en cas de trencament d'estoc. Si el producte tingués un import superior, es podria sol·licitar l'abonament de la diferència.

2. TRAÇABILITAT DELS PRODUCTES:

Per assegurar la correcta traçabilitat dels productes, l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta i idèntica identificació en cadascun dels productes als envasos i a l'albarà.

Les caixes estaran etiquetades amb codi de barres o codi QR a on s'informarà almenys del número de lot i la referència del producte.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - logistica@ias.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet@ias.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa@ias.cat

VICENS LLORET
ALBA - DNI
40429761Q
(AUT)

Signat digitalment
per VICENS LLORET
ALBA - DNI
40429761Q (AUT)
Data: 2023.03.23
14:33:23 +01'00'

Signat. Vicens Lloret Alba

Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 23 de març de 2023

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITAT

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1	AGULLA HIPODÈRMICA					
50859	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM AMB SEGURETAT	5.877	0,0840 €	493,69 €	21%	597,37 €
50864	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM AMB SEGURETAT	24.556	0,0840 €	2.062,74 €	21%	2.495,91 €
50866	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX40MM AMB SEGURETAT	86	0,0840 €	7,21 €	21%	8,72 €
50867	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX25MM AMB SEGURETAT	814	0,0840 €	68,38 €	21%	82,73 €
51933	AGULLA HIPODÈRMICA 30G 0,30X12MM SENSE SEGURETAT	3.498	0,0315 €	110,19 €	21%	133,33 €
53824	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM SENSE SEGURETAT	3.300	0,0315 €	103,95 €	21%	125,78 €
53655	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM SENSE SEGURETAT	2.760	0,0315 €	86,94 €	21%	105,19 €
52089	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X50MM SENSE SEGURETAT	969	0,0315 €	30,53 €	21%	36,94 €
			TOTAL LOT 1	2.963,61 €	21%	3.585,97 €
LOT 2	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA					
50863	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM AMB SEGURETAT	6.061	0,0840 €	509,12 €	21%	616,04 €
53713	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM SENSE SEGURETAT	3.355	0,0315 €	105,68 €	21%	127,88 €
			TOTAL LOT 2	614,81 €	21%	743,92 €
LOT 3	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA PLOMA					
50860	AGULLA INSULINA 31G 0,25X5MM PLOMA	10.362	0,0959 €	993,76 €	21%	1.202,45 €
50861	AGULLA INSULINA 31G 0,25X8MM PLOMA	51.311	0,0959 €	4.920,89 €	21%	5.954,28 €
53303	AGULLA INSULINA 30G 0,30X5MM PLOMA DOBLE SEGURETAT	4.440	0,4914 €	2.181,62 €	21%	2.639,76 €
53304	AGULLA INSULINA 30G 0,30X8MM PLOMA DOBLE SEGURETAT	11.653	0,3510 €	4.090,34 €	21%	4.949,32 €
			TOTAL LOT 3	12.186,61 €	21%	14.745,80 €
LOT 4	AGULLA ESPINAL					
50872	AGULLA ESPINAL 18GX3.5 - 1.2X90MM	50	1,1000 €	55,00 €	21%	66,55 €
50873	AGULLA ESPINAL 19GX3.5 - 1.1X90MM	13	1,1000 €	14,52 €	21%	17,57 €
50874	AGULLA ESPINAL 20GX1.5 - 0.9X38MM	24	1,1000 €	26,62 €	21%	32,21 €
50875	AGULLA ESPINAL 20GX3.5 - 0.9X90MM	138	1,1000 €	151,25 €	21%	183,01 €
52189	AGULLA ESPINAL 22GX1.5 - 0.7X38MM	78	1,1000 €	85,91 €	21%	103,95 €
50876	AGULLA ESPINAL 22GX3.5 - 0.7X90MM	1.177	1,1000 €	1.294,70 €	21%	1.566,59 €
50879	AGULLA ESPINAL 25GX1.0 - 0.5X25MM	33	1,1000 €	36,30 €	21%	43,92 €

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
50877	AGULLA ESPINAL 25GX3.5 - 0.5X90MM	4	1,1000 €	4,84 €	21%	5,86 €
			TOTAL LOT 4	1.669,14 €	21%	2.019,66 €
LOT 5	AGULLA ESPINAL WHITACRE					
50882	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX90MM	23	5,0000 €	115,50 €	21%	139,76 €
50884	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX90MM	1.769	5,0000 €	8.844,00 €	21%	10.701,24 €
50885	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX115MM	130	5,0000 €	649,00 €	21%	785,29 €
50887	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX115MM	18	5,0000 €	88,00 €	21%	106,48 €
51595	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX90MM	215	5,0000 €	1.072,50 €	21%	1.297,73 €
51596	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX120MM	48	5,0000 €	242,00 €	21%	292,82 €
			TOTAL LOT 5	11.011,00 €	21%	13.323,31 €
LOT 6	AGULLA/KIT EPIDURAL					
53608	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 20GX50MM	120	11,8800 €	1.425,60 €	21%	1.724,98 €
52308	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 22GX50MM	60	11,8800 €	712,80 €	21%	862,49 €
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX80MM	180	5,3700 €	966,60 €	21%	1.169,59 €
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX120MM	100	7,0000 €	700,00 €	121%	847,00 €
51415	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18GX80MM	1.190	14,0400 €	16.707,60 €	21%	20.216,20 €
52303	KIT ANESTESIA EPIDURAL COMBINADA 18GX88MM	25	38,8800 €	972,00 €	21%	1.176,12 €
			TOTAL LOT 6	21.484,60 €	21%	25.996,37 €
LOT 7	AGULLA EPIDURAL AMB XERINGA					
50918	AGULLA EPIDURAL TUOHY AMB XERINGA 18GX80mm	457	5,4000 €	2.467,80 €	21%	2.986,04 €
			TOTAL LOT 7	2.467,80 €	21%	2.986,04 €
LOT 8	KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT					
51416	KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT 18GX110	35	8,3052 €	290,68 €	21%	351,73 €
			TOTAL LOT 8	290,68 €	21%	351,73 €
LOT 9	AGULLA PARACENTESIS					
50909	AGULLA PARACENTESIS 17G 70MM	85	9,8820 €	839,97 €	21%	1.016,36 €
			TOTAL LOT 9	839,97 €	21%	1.016,36 €
LOT 10	AGULLA CÀRREGA					
52748	AGULLA CÀRREGA 18G 1,20X40MM PUNTA ROMA 40º	333.685	0,0389 €	12.973,67 €	21%	15.698,14 €
			TOTAL LOT 10	12.973,67 €	21%	15.698,14 €
LOT 11	AGULLA QUIMIO					
50895	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX15MM	384	3,0000 €	1.151,70 €	21%	1.393,56 €
53705	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX16MM	53	3,0000 €	158,40 €	21%	191,66 €
53687	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX20MM	123	3,0000 €	369,60 €	21%	447,22 €
50891	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX32MM	15	3,0000 €	46,20 €	21%	55,90 €
50892	AGULLA QUIMIO S/Y 22GX25MM	128	3,0000 €	382,80 €	21%	463,19 €
50890	AGULLA QUIMIO A/Y 20GX19MM	20	3,0000 €	59,40 €	21%	71,87 €
			TOTAL LOT 11	2.168,10 €	21%	2.623,40 €
LOT 12	AGULLA BIÒPSIA					
51410	AGULLA BIÒPSIA M.OSEA 8GX10CM	10	26,4600 €	264,60 €	21%	320,17 €

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
51430	AGULLA BIÒPSIA ASPIRACIÓ M. ÒSSIA. 15GX75CM	10	13,3488 €	133,49 €	21%	161,52 €
			TOTAL LOT 12	398,09 €	21%	481,69 €
LOT 13	AGULLA CHIBA					
50915	AGULLA CHIBA 22GX120MM	240	7,5600 €	1.814,40 €	21%	2.195,42 €
			TOTAL LOT 13	1.814,40 €	21%	2.195,42 €
LOT 14	AGULLA ACUPUNTURA					
53200	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X13MM	110	0,1021 €	11,23 €	21%	13,58 €
52333	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X25MM	2.310	0,1021 €	235,76 €	21%	285,27 €
52334	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X50MM	770	0,1021 €	78,59 €	21%	95,09 €
52335	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X75MM	110	0,1021 €	11,23 €	21%	13,58 €
52336	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X25MM	2.200	0,0946 €	208,14 €	21%	251,85 €
52337	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X40MM	220	0,0946 €	20,81 €	21%	25,18 €
			TOTAL LOT 14	565,75 €	21%	684,56 €
LOT 15	PUNCH BIÒPSIA					
50904	PUNCH BIÒPSIA 2MM	36	1,3543 €	48,76 €	21%	58,99 €
50905	PUNCH BIÒPSIA 3MM	250	1,3543 €	338,58 €	21%	409,68 €
50906	PUNCH BIÒPSIA 4MM	74	1,3543 €	100,22 €	21%	121,27 €
50907	PUNCH BIÒPSIA 5MM	77	1,3543 €	104,28 €	21%	126,18 €
53932	PUNCH BIÒPSIA 6MM	28	1,3543 €	37,92 €	21%	45,88 €
53968	PUNCH BIÒPSIA 8MM	20	1,3543 €	27,09 €	21%	32,77 €
			TOTAL LOT 15	656,85 €	21%	794,78 €
LOT 16	LLANCETA AMNIORREXI					
51134	LLANCETA AMNIORREXI 26,5CM	431	0,1998 €	86,11 €	21%	104,20 €
			TOTAL LOT 16	86,11 €	21%	104,20 €
LOT 17	LLANCETA DE SEGURETAT PER MOSTRA DE SANG					
50917	LLANCETA DE SEGURETAT 23GX1,8MM	135.000	0,0458 €	6.181,92 €	21%	7.480,12 €
			TOTAL LOT 17	6.181,92 €	21%	7.480,12 €
LOT 18	LLANCETA PROVA TALÓ					
53179	LLANCETA 1.75X1.0MM	550	0,8402 €	462,13 €	21%	559,18 €
			TOTAL LOT 18	462,13 €	21%	559,18 €
LOT 19	PALOMETA AMB SEGURETAT					
50958	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 21G X3/4" 19CM	212	0,6221 €	132,07 €	21%	159,80 €
50957	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 25 G X 3/4"	381	0,6221 €	236,76 €	21%	286,48 €
50956	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 23G X 3/4"	1.557	0,6221 €	968,27 €	21%	1.171,60 €
52288	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT 21G X 3/4"	1.425	0,6221 €	886,15 €	21%	1.072,25 €
51566	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 21G X 3/4"	38.110	0,6221 €	23.707,16 €	21%	28.685,66 €
52168	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 23G 1 CM	1.511	0,6221 €	940,21 €	21%	1.137,66 €
			TOTAL LOT 19	26.870,62 €	21%	32.513,45 €
LOT 20	CATÈTER DE SEGURETAT					

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
00000	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 14G	100	0,9396 €	93,96 €	21%	113,69 €
54154	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 16G	100	0,9396 €	93,96 €	21%	113,69 €
54151	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 18G	8.396	0,9396 €	7.889,16 €	21%	9.545,89 €
54152	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 20G	31.931	0,9396 €	30.002,18 €	21%	36.302,64 €
54153	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 22G	23.757	0,9396 €	22.321,80 €	21%	27.009,37 €
54155	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 24G	6.526	0,9396 €	6.132,11 €	21%	7.419,85 €
			TOTAL LOT 20	66.533,17 €	21%	80.505,14 €
LOT 21	COMPTADOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC					
00000	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 15 AGULLES	570	1,2461 €	710,28 €	21%	859,44 €
54154	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 40 AGULLES	570	2,4923 €	1.420,61 €	21%	1.718,94 €
			TOTAL LOT 21	2.130,89 €	21%	2.578,37 €
LOT 22	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC					
00000	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	1.100	2,5000 €	2.750,00 €	21%	3.327,50 €
			TOTAL LOT 22	2.750,00 €	21%	3.327,50 €
			TOTAL EXPEDIENT	177.119,93 €	21%	214.315,11 €

9.2 ANNEX 2. MOSTRES REQUERIDES

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE MOSTRES REQUERIDES
LOT 1	AGULLA HIPODÈRMICA	
50859	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM AMB SEGURETAT	6
50864	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM AMB SEGURETAT	6
50866	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX40MM AMB SEGURETAT	
50867	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX25MM AMB SEGURETAT	
51933	AGULLA HIPODÈRMICA 30G 0,30X12MM SENSE SEGURETAT	6
53824	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM SENSE SEGURETAT	6
53655	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM SENSE SEGURETAT	
52089	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X50MM SENSE SEGURETAT	
LOT 2	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA	
50863	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM AMB SEGURETAT	6
53713	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM SENSE SEGURETAT	6
LOT 3	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA PLOMA	
50860	AGULLA INSULINA 31G 0,25X5MM PLOMA	6
50861	AGULLA INSULINA 31G 0,25X8MM PLOMA	6
53303	AGULLA INSULINA 30G 0,30X5MM PLOMA DOBLE SEGURETAT	6
53304	AGULLA INSULINA 30G 0,30X8MM PLOMA DOBLE SEGURETAT	6
LOT 4	AGULLA ESPINAL	
50872	AGULLA ESPINAL 18GX3.5 - 1.2X90MM	6
50873	AGULLA ESPINAL 19GX3.5 - 1.1X90MM	
50874	AGULLA ESPINAL 20GX1.5 - 0.9X38MM	
50875	AGULLA ESPINAL 20GX3.5 - 0.9X90MM	6
52189	AGULLA ESPINAL 22GX1.5 - 0.7X38MM	
50876	AGULLA ESPINAL 22GX3.5 - 0.7X90MM	6
50879	AGULLA ESPINAL 25GX1.0 - 0.5X25MM	
50877	AGULLA ESPINAL 25GX3.5 - 0.5X90MM	
LOT 5	AGULLA ESPINAL WHITACRE	
50882	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX90MM	
50884	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX90MM	6
50885	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX115MM	6
50887	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX115MM	
51595	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX90MM	6
51596	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX120MM	

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE MOSTRES REQUERIDES
LOT 6	AGULLA/KIT EPIDURAL	
53608	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 20GX50MM	6
52308	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 22GX50MM	6
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX80MM	6
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX120MM	6
51415	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18GX80MM	6
52303	KIT ANESTESIA EPIDURAL COMBINADA 18GX88MM	6
LOT 7	AGULLA EPIDURAL AMB XERINGA	
50918	AGULLA EPIDURAL TUOHY AMB XERINGA 18GX80mm	6
LOT 8	KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT	
51416	KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT 18GX110	6
LOT 9	AGULLA PARACENTESIS	
50909	AGULLA PARACENTESIS 17G 70MM	6
LOT 10	AGULLA CÀRREGA	
52748	AGULLA CÀRREGA 18G 1,20X40MM PUNTA ROMA 40º	6
LOT 11	AGULLA QUIMIO	
50895	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX15MM	6
53705	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX16MM	
53687	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX20MM	
50891	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX32MM	
50892	AGULLA QUIMIO S/Y 22GX25MM	6
50890	AGULLA QUIMIO A/Y 20GX19MM	
LOT 12	AGULLA BIÒPSIA	
51410	AGULLA BIÒPSIA M.OSEA 8GX10CM	2
51430	AGULLA BIÒPSIA ASPIRACIÓ M. ÒSSIA. 15GX75CM	2
LOT 13	AGULLA CHIBA	
50915	AGULLA CHIBA 22GX120MM	6
LOT 14	AGULLA ACUPUNTURA	
53200	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X13MM	
52333	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X25MM	6
52334	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X50MM	6
52335	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X75MM	
52336	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X25MM	6
52337	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X40MM	
LOT 15	PUNCH BIÒPSIA	
50904	PUNCH BIÒPSIA 2MM	
50905	PUNCH BIÒPSIA 3MM	6

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE MOSTRES REQUERIDES
50906	PUNCH BIÒPSIA 4MM	
50907	PUNCH BIÒPSIA 5MM	6
53932	PUNCH BIÒPSIA 6MM	
53968	PUNCH BIÒPSIA 8MM	
LOT 16	LLANCETA AMNIORREXI	
51134	LLANCETA AMNIORREXI 26,5CM	6
LOT 17	LLANCETA DE SEGURETAT PER MOSTRA DE SANG	
50917	LLANCETA DE SEGURETAT 23GX1,8MM	6
LOT 18	LLANCETA PROVA TALÓ	
53179	LLANCETA 1.75X1.0MM	6
LOT 19	PALOMETA AMB SEGURETAT	
50958	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 21G X3/4" 19 CM	
50957	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 25 G X 3/4"	
50956	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 23G X 3/4"	6
52288	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT 21G X 3/4"	6
51566	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 21G X 3/4"	6
52168	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 23G 1 CM	6
LOT 20	CATÈTER DE SEGURETAT	
00000	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 14G	
54154	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 16G	
54151	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 18G	6
54152	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 20G	6
54153	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 22G	6
54155	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 24G	6
LOT 21	COMPTADOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	
00000	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 15 AGULLES	3
54154	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 40 AGULLES	3
LOT 22	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	
00000	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	3
	LES MOSTRES HAURAN DE PORTAR IDENTIFICAT EL LOT I EL CODI DE L'IAS	

9.3 ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL

DADES OFERTA ECONÒMICA

NOM LICITADORA:

El/la Sr./Sra..... amb residència
a.....al carrer.....número..... i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte, amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de € (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel al final de cada any natural del%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

OFERTA ECONÒMICA

Nom de la licitadora:	
Lot/lots licitats:	

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1	AGULLA HIPODÈRMICA					
50859	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM AMB SEGURETAT	5.877				
50864	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM AMB SEGURETAT	24.556				
50866	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX40MM AMB SEGURETAT	86				
50867	AGULLA HIPODÈRMICA 20G 0,90MMX25MM AMB SEGURETAT	814				
51933	AGULLA HIPODÈRMICA 30G 0,30X12MM SENSE SEGURETAT	3.498				
53824	AGULLA HIPODÈRMICA 23G 0,60X25MM SENSE SEGURETAT	3.300				
53655	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X40MM SENSE SEGURETAT	2.760				
52089	AGULLA HIPODÈRMICA 21G 0,80X50MM SENSE SEGURETAT	969				
			TOTAL LOT 1	0,00 €		0,00 €
LOT 2	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA					
50863	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM AMB SEGURETAT	6.061				
53713	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA 25G 0,5MMX16MM SENSE SEGURETAT	3.355				
			TOTAL LOT 2	0,00 €		0,00 €
LOT 3	AGULLA HIPODÈRMICA INSULINA PLOMA					
50860	AGULLA INSULINA 31G 0,25X5MM PLOMA	10.362				
50861	AGULLA INSULINA 31G 0,25X8MM PLOMA	51.311				
53303	AGULLA INSULINA 30G 0,30X5MM PLOMA DOBLE SEGURETAT	4.440				
53304	AGULLA INSULINA 30G 0,30X8MM PLOMA DOBLE SEGURETAT	11.653				
			TOTAL LOT 3	0,00 €		0,00 €
LOT 4	AGULLA ESPINAL					
50872	AGULLA ESPINAL 18GX3.5 - 1.2X90MM	50				
50873	AGULLA ESPINAL 19GX3.5 - 1.1X90MM	13				
50874	AGULLA ESPINAL 20GX1.5 - 0.9X38MM	24				
50875	AGULLA ESPINAL 20GX3.5 - 0.9X90MM	138				
52189	AGULLA ESPINAL 22GX1.5 - 0.7X38MM	78				
50876	AGULLA ESPINAL 22GX3.5 - 0.7X90MM	1.177				
50879	AGULLA ESPINAL 25GX1.0 - 0.5X25MM	33				
50877	AGULLA ESPINAL 25GX3.5 - 0.5X90MM	4				
			TOTAL LOT 4	0,00 €		0,00 €
LOT 5	AGULLA ESPINAL WHITACRE					
50882	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX90MM	23				
50884	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX90MM	1.769				
50885	AGULLA ESPINAL WHITACRE 25GX115MM	130				

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
50887	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX115MM	18				
51595	AGULLA ESPINAL WHITACRE 27GX90MM	215				
51596	AGULLA ESPINAL WHITACRE 22GX120MM	48				
			TOTAL LOT 5	0,00 €		0,00 €
LOT 6	AGULLA/KIT EPIDURAL					
53608	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 20GX50MM	120				
52308	AGULLA EPIDURAL TUOHY PEDIÀTRICA 22GX50MM	60				
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX80MM	180				
00000	AGULLA EPIDURAL TUOHY 18GX120MM	100				
51415	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18GX80MM	1.190				
52303	KIT ANESTESIA EPIDURAL COMBINADA 18GX88MM	25				
			TOTAL LOT 6	0,00 €		0,00 €
LOT 7	AGULLA EPIDURAL AMB XERINGA					
50918	AGULLA EPIDURAL TUOHY AMB XERINGA 18GX80mm	457				
			TOTAL LOT 7	0,00 €		0,00 €
LOT 8	KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT					
51416	KIT ANESTÈSIA EPIDURAL OBESITAT 18GX110	35				
			TOTAL LOT 8	0,00 €		0,00 €
LOT 9	AGULLA PARACENTESIS					
50909	AGULLA PARACENTESIS 17G 70MM	85				
			TOTAL LOT 9	0,00 €		0,00 €
LOT 10	AGULLA CÀRREGA					
52748	AGULLA CÀRREGA 18G 1,20X40MM PUNTA ROMA 40º	333.685				
			TOTAL LOT 10	0,00 €		0,00 €
LOT 11	AGULLA QUIMIO					
50895	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX15MM	384				
53705	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX16MM	53				
53687	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX20MM	123				
50891	AGULLA QUIMIO S/Y 20GX32MM	15				
50892	AGULLA QUIMIO S/Y 22GX25MM	128				
50890	AGULLA QUIMIO A/Y 20GX19MM	20				
			TOTAL LOT 11	0,00 €		0,00 €
LOT 12	AGULLA BIÒPSIA					
51410	AGULLA BIÒPSIA M.OSEA 8GX10CM	10				
51430	AGULLA BIÒPSIA ASPIRACIÓ M. ÒSSIA. 15GX75CM	10				
			TOTAL LOT 12	0,00 €		0,00 €
LOT 13	AGULLA CHIBA					
50915	AGULLA CHIBA 22GX120MM	240				
			TOTAL LOT 13	0,00 €		0,00 €
LOT 14	AGULLA ACUPUNTURA					
53200	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X13MM	110				

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
52333	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,25X25MM	2.310				
52334	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X50MM	770				
52335	AGULLA ACUPUNTURA PUNCIÓ SECA 0,30X75MM	110				
52336	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X25MM	2.200				
52337	AGULLA ACUPUNTURA 0,25X40MM	220				
			TOTAL LOT 14	0,00 €		0,00 €
LOT 15	PUNCH BIÒPSIA					
50904	PUNCH BIÒPSIA 2MM	36				
50905	PUNCH BIÒPSIA 3MM	250				
50906	PUNCH BIÒPSIA 4MM	74				
50907	PUNCH BIÒPSIA 5MM	77				
53932	PUNCH BIÒPSIA 6MM	28				
53968	PUNCH BIÒPSIA 8MM	20				
			TOTAL LOT 15	0,00 €		0,00 €
LOT 16	LLANCETA AMNIOREXII					
51134	LLANCETA AMNIOREXII 26,5CM	431				
			TOTAL LOT 16	0,00 €		0,00 €
LOT 17	LLANCETA DE SEGURETAT PER MOSTRA DE SANG					
50917	LLANCETA DE SEGURETAT 23GX1,8MM	135.000				
			TOTAL LOT 17	0,00 €		0,00 €
LOT 18	LLANCETA PROVA TALÓ					
53179	LLANCETA 1.75X1.0MM	550				
			TOTAL LOT 18	0,00 €		0,00 €
LOT 19	PALOMETA AMB SEGURETAT					
50958	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 21G X3/4" 19 CM	212				
50957	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 25 G X 3/4"	381				
50956	PALOMETA INFUSIÓ AMB SEGURETAT 23G X 3/4"	1.557				
52288	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT 21G X 3/4"	1.425				
51566	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 21G X 3/4"	38.110				
52168	PALOMETA EXTRACCIÓ AMB SEGURETAT I HOLDER 23G 1 CM	1.511				
			TOTAL LOT 19	0,00 €		0,00 €
LOT 20	CATÈTER DE SEGURETAT					
00000	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 14G	100				
54154	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 16G	100				
54151	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 18G	8.396				
54152	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 20G	31.931				
54153	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 22G	23.757				
54155	CATÈTER SEGURETAT PROTECCIÓ AUTOMÀTICA 24G	6.526				
			TOTAL LOT 20	0,00 €		0,00 €
LOT 21	COMPTADOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC					
00000	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 15 AGULLES	570				

LOT / CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
54154	COMPTADOR AGULLES NUMERAT 40 AGULLES	570				
			TOTAL LOT 21	0,00 €		0,00 €
LOT 22	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC					
00000	CONTENIDOR AGULLES PROCÉS QUIRÚRGIC	1.100				
			TOTAL LOT 22	0,00 €		0,00 €

PREUS UNITARIS AMB 4 DECIMALS