

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101343135/23/AMUP

Material sanitari de diagnòstic i exploracions diverses

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Atributs logístics	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.5.1. Condicions de subministrament.....	10
4.5.2. Garantia de subministrament	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.5.2.3. Termini de lliurament	12
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	13
4.5.3. Sistema EDI.....	13
4.6. Condicions de l'operador logístic	15
4.6.1. Embalatges.....	15
4.6.2. L'albarà.....	16

4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.6.4.	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia.....	17
4.6.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	17
4.7.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Material sanitari de diagnòstic i exploracions diverses** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc. que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa Criteris Addicionals, ANNEX D3.

Aquest model no permet fer cap modificació al fitxer, només caldrà emplenar les dades següents:

- Nom
- NIF
- Lot
- Codi SAP
- Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca)

- Característiques addicionals a especificar (cal tenir en compte que per omplir les cel·les, és necessari seleccionar una de les opcions del desplegable de cada criteri). La puntuació total és una cel·la protegida que no es pot modificar.
- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**. Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101343135/AMUP/23]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **Gerència de Compres**, a l'atenció de **Jordi Morera**, a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'ANNEX E, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenició de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenició de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)

- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos

- Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
------------------	------------

Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN)
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- Configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- Visualitzar els documents rebuts
- Generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb l'estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

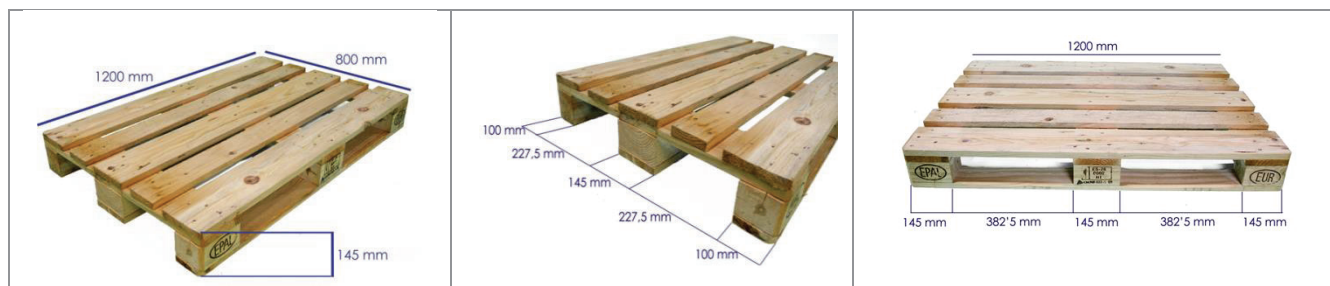

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega. e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme. Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

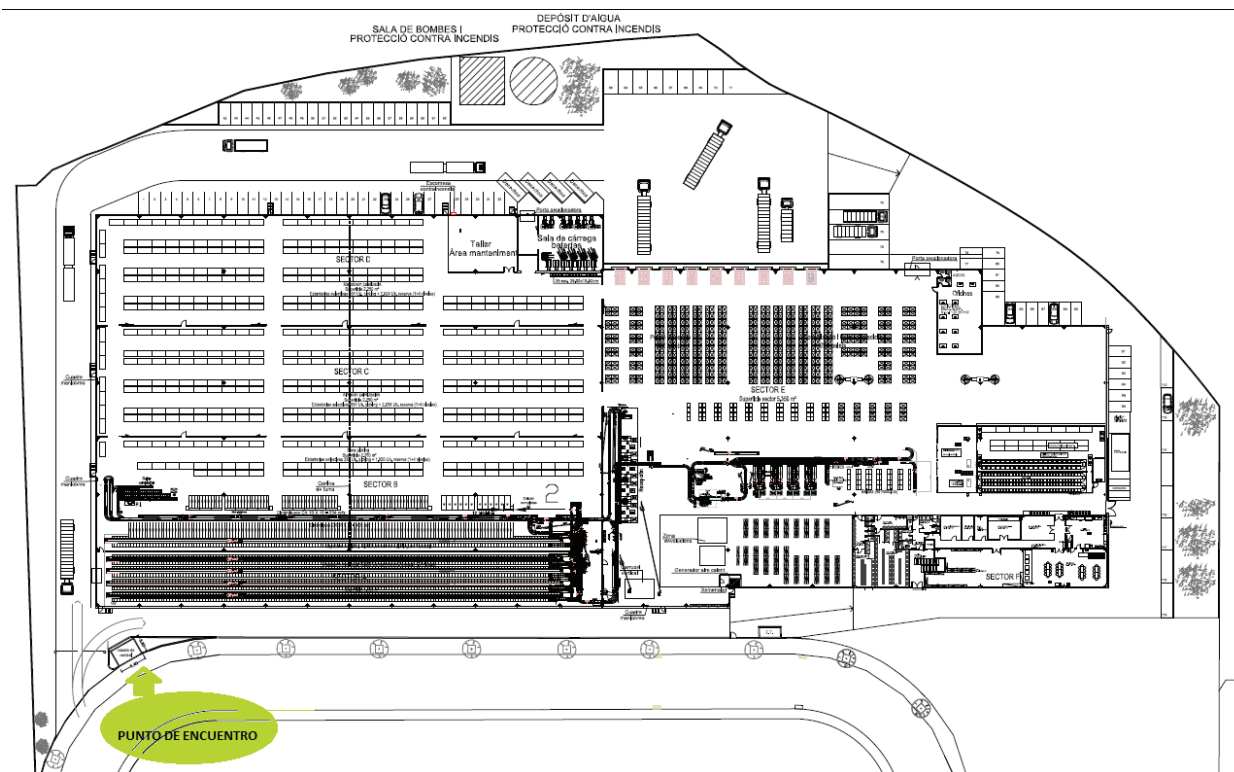

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343135/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Accessoris test d'alè	No Obligatori
002	Braçals 1 sortida twist lock 1 sol pacient	Obligatori
003	Braçals 2 sortides neo-snap 1 sol pacient	Obligatori
004	Braçals flexiport 1 sol ús/1 sol pacient	Obligatori
005	Braçals flexiport reutilitzables	Obligatori
006	Braçals 1 sortida baioneta reutilitzable	Obligatori
007	Braçals 1 sortida rosca reutilitzable	Obligatori
008	Braçals 2 sortides Dinaclick	Obligatori
009	Braçals sense connexió	No Obligatori
010	Braçals 1 sortida compatible OMRON o equivalent	No Obligatori
011	Altres braçals	No Obligatori
012	Braçal 1 sortida compatible monitor EDAN o equivalent	Obligatori
013	Braçal compatible monitor Tango+ M2 o equivalent	Obligatori
014	Braçals holter compatibles monitors Spacelabs o equivalent	Obligatori
015	Braçals holter compatibles amb equips WatchBP 03 o equivalent	Obligatori
016	Braçals holter compatibles amb equips Oscar2 Suntech o equivalent	Obligatori
017	Altres braçals holter	No Obligatori
018	Accessoris aparells pressió arterial	No Obligatori
019	Termòmetres clínics	No Obligatori
020	Fundes termòmetres	No Obligatori
021	Espèculs òtics	No Obligatori
022	Depressors	No Obligatori
023	Altres material d'exploracions	No Obligatori
024	Equips de mesura de pressió	No Obligatori
025	Equips manegots ITB	Obligatori
026	Manegots d'isquemia	No Obligatori
027	Fonendoscòpis	No Obligatori
028	Recanvis fonendoscòpis	No Obligatori
029	Altres material de diagnòstic	No Obligatori
030	Oto-oftalmoscòpis	No Obligatori
031	Capçals oftalmoscòpis	No Obligatori
032	Lents esfèriques dobles	No Obligatori
033	Lents làser	No Obligatori
034	Lents vitrioretinals	No Obligatori
035	Altres lents	No Obligatori
036	Otoscòpis	No Obligatori
037	Capçals otoscòpi	No Obligatori
038	Tallímetres	No Obligatori
039	Bàscules digitals	No Obligatori
040	Accessoris holter	No Obligatori
041	Material divers	No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001411

Descripció llarga:

Depressor de llengua de fusta, mides: amplada 2 cm +/-0,5cm, llargària 15 cm +/-1cm i gruix 1,6 mm +/-0,2mm, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001412

Descripció llarga:

Depressor de llengua de plàstic, mides: amplada 2 cm +/-0,2cm, llargària 15 cm +/-1cm,gruix 2mm, estèril.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001572

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø2,5 mm x Ø14,25mm x35mm longitud, compatible amb capçal otoscopi HEINE ALLSPEC, models BETA 200, K180, alpha+, mini 2000 i mini 3000 F.O, MINILUX o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001573

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø 4 mm x 14,25mm x 29mm, compatible amb capçal otoscopi HEINE ALLSPEC, models BETA 200, K180, alpha+, mini 2000 i mini 3000 F.O, MINILUX o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001600

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø 4 mm x 15,6mm x 26mm de longitud, compatible amb capçal otoscopi RIESTER, models Ri-Fo rmer, Ri-Star, Ri-Scope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001601

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø 2,5 mm x15,6mm x 34,5mm de longitud, compatible amb capçal otoscopi RIESTER, models Ri -Former, Ri-Star, Ri-Scope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001602

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø 4 mm x 14,25mm, compatible capçal otoscopi WELCH ALLYN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001603

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús , de Ø 2,5 mm x14,25 mm, compatible amb capçal otoscopi WELCH ALLYN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002774

Descripció llarga:

Vàlvula metàl·lica reguladora de pressió adaptable a pera de manegot de pressió arterial.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002787

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides connexió tipus neo-snap o equivalent, neonatal, mides (8-15cm) +/-0,3cm. Comp atible amb monitors Critikon Dinamap, GE Medical, Systems, Datex-Ohmeda o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30002791

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió baioneta, mida adult (23-33cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Critica re, Philips Medical, HP, Spacelabs, Draeger, Datascope, Zoll, Ivac 4200, Critic 508 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30002793

Descripció llarga:

Pera de goma per a manegot de pressió arterial.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30002794

Descripció llarga:

Tub de goma en espiral amb connexió amb braços OMRON i compatible amb monitors OMRON M3, M6 i M7

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30003066

Descripció llarga:

Espècul per a otoscòpi ORL,d'un sol ús, de Ø 4mm x 18,6mm x35mm de longitud, compatible amb capçal otoscopi, Riester, MINI RIESTER o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30003246

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial (PANI), 2 sortides, sense connexió, mida adult estàndart (26-35cm)+/-2cm. Material niló. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30003247

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida adult (25-35cm)+/-2cm. Compatible amb monitors hemodiàlisi Integra o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30003248

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial (PANI), 2 sortides, sense connexió, mida adult estàndart (35-44cm)+/-2cm. Material niló. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004295

Descripció llarga:

Termòmetre clínic digital axil·lar i rectal. Graduació de 32 a 42 graus. Fiabilitat +/-0,2. Mida aprox 13cm+/-2cm. Lectura en 60-90 segons. Absència mercuri. Resistent a solucions desinfect, s/carregador. Funcionament a piles tipus botó 1,55V. No estèril

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004610

Descripció llarga:

Feltre adhesiu hipoal·lèrgic semi-dur compost de: 50% llana i 50% acrílic gruix 6mm. Mides 20x30cm

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30004770

Descripció llarga:

Funda per a sonda de termòmetre electrònic, plàstic rígid suau, un sol ús. Compatible amb FILAC 3000 AD o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30005312

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida adult (22-32 cm)+/-2cm. Compatible amb monitors OMRON HEM-907 i HBP-1300/ 1320 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30005314

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), neonatal, 1 sortida, material vinil tou, connexió tipus twist lock, mides (4-8cm) +/-0,3c m. Compatible amb monitors Philips i cable extensió 3metres +/-20cm o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30007121

Descripció llarga:

Cureta de plàstic per ORL per extracció de cerumen amb punta flexible finestrada. No estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30008352

Descripció llarga:

Funda per a sonda de termòmetre, material plàstic traslúcid, longitud aproximada 10cm, no estèril, un sol ús, compatible amb Monitor Projecte Vida, CSM

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30008454

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), neonatal, 1 sortida, material vinil tou, connexió tipus twist lock, mides (6-11cm) +/-0,3 cm. Compatible amb monitors Philips i cable extensió 3metres +/-20cm o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30008459

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), neonatal, 1 sortida, material vinil tou, connexió tipus twist lock, mides (7-13cm) +/-0,3 cm. Compatible amb monitors Philips i cable extensió 3metres +/-20cm o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30009509

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió rosca, mida pediàtric (12-20cm) +/-2cm. Compatible amb equips Welch A llyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30009510

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió rosca, mida infantil (8-14cm)+/-2cm. Compatible amb equips Welch Ally n o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30009516

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió rosca, mida adult (25-35cm) +/-2cm. Compatible amb equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30009517

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida pediàtrica (17-22 cm)+/-2cm. Compatible amb monitors OMRON HEM-907 i HBP- 1300/1320 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30009887

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida adult (22-42 cm)+/-2cm. Compatible amb monitors OMRON M2, M3, M6 AC i mul tiparamètrics no confort (57/HEM-RML31) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30009890

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió baioneta, mida adult Gran (31-41cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Cr iticare, Philips Medical, HP, Spacelabs, Draeger, Datascope, Zoll, Ivac 4200, Critic 508 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30010922

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida adult (25-35cm)+/-2cm, reutilitzable. Compatible amb monitor desfibril·la dor Lifepack o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30011080

Descripció llarga:

Tub doble amb connexió neo-snap per a manegots neonatals. Mida: 3,6m (+/-10cm). Compatible amb monitors CARESCAPE, Data, Dash o equi valent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30011914

Descripció llarga:

Braçal per a holter, reutilitzable, connector luer, mida adult (24-32cm)+/-2cm. Tancament de seguretat amb velcro. Compatible amb monitors Spacelabs o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30011915

Descripció llarga:

Braçal per a holter, reutilitzable, connector luer de plàstic, mida (32-42cm)+/-2cm, amb arnés de fixació a l'espatlla. Compatible a mb monitors Spacelabs o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30012582

Descripció llarga:

Catalitzador líquid ràpid per endurir silicones fluïdes o sòlides , envàs de 20ml amb tap de goteig.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30012601

Descripció llarga:

Feltre adhesiu hipoal·lèrgic semi-dur compost de: 50% llana i 50% acrílic gruix 8mm. Mides 20x30cm

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30012602

Descripció llarga:

Feltre adhesiu hipoal·lèrgic semi-dur compost de: 50% llana i 50% acrílic gruix 10mm. Mides 20x30cm

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30012603

Descripció llarga:

Silicona moldejable duresa tova per a ortesi, vulcanitza a temperatura ambient utilitzen catalizador. Envàs de 500g

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30012604

Descripció llarga:

Silicona moldejable duresa semi-rígida per a ortesi, vulcanitza a temperatura ambient utilitzen catalizador.Envàs de 500g

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30012696

Descripció llarga:

Tap de goma per impedianciometria de colors. Caixa amb taps de 8 de calibres diferents, 4 unitats per tap (total 32u).

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30013133

Descripció llarga:

Feltre adhesiu hipoal·lèrgic semi-dur compost de: 50% llana i 50% acrílic gruix 2mm. Mides 20x30cm

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30013134

Descripció llarga:

Feltre adhesiu hipoal·lèrgic semi-dur compost de: 50% llana i 50% acrílic gruix 3mm. Mides 20x30cm

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30015263

Descripció llarga:

Cànules de silicona per conduir l'aire d'estimulació calòrica. Mides: diàmetre intern 3mm, diàmetre extern 4,5mm i llargària 25mm. Compatible amb otocalorímetre Homoth o equivalent. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30015470

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø 2,5 mm x 23,8mm x 37,5mm de longitud, compatible amb capçal otoscopi HEINE UNISPEC, mo dels K100 i BETA 100 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30015471

Descripció llarga:

Espècul per a otoscopi ORL, d'un sol ús, de Ø 4mm x 23,8mm x 37,5 mm de longitud, compatible amb capçal otoscopi HEINE UNISPEC, mod els K100 i BETA 100 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30015541

Descripció llarga:

Funda per a sonda de termòmetre timpànic electrònic infraroig, no estèril, un sol ús, compatible amb GENIUS-2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30016720

Descripció llarga:

Dessecant amb indicador de color per a tubs de part frontal per a entrada de mostres d'alè. Composició: Anhídre de sulfat de calci 9 9,2% CaSO₄ , CoCl₂ < 2% , envas 450gr. Compatible amb equips Quintron o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30016724

Descripció llarga:

Ampolla de gas per a calibració d'equips per a mesurament de l'hidrògen espirat, 100ppm H2 - 50ppm CH4 - 5% CO2.1 litre. Models SC P lus Quintron o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30017814

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), neonatal, 1 sortida, material vinil tou, connexió tipus twist lock, mides (3-6cm) +/-0,3c m. Compatible amb monitors Philips i cable extensió 3metres +/-20cm o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30017923

Descripció llarga:

Espècul per a otoscòpi ORL, d'un sol ús, de Ø 2,5mm x 18,6 mm x 35 mm de longitud, compatibles amb capçal otoscopi Riester, MINI RIE STER o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30019551

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida adult extra gran (46-66 cm)+/-2cm. Compatible amb monitors OMRON HEM-907 i HBP-1300/1320 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30030944

Descripció llarga:

Equip recollida mostres per test d'alè, compost: xeringa 30 ml amb connector luer-lock, una clau de pas, una bossa de recollida de mostres ,capacitat 400ml màx, inclòs broquet.Un sol ús.Compatible Quintron Breathtracker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30032129

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), mida adult (27-38 cm)+/-2cm, sense cables amb connexió de punt únic a pressió flexiport, lliure de làtex, PVC, DEHP i BPA. D'un sol pacient fins a 100 usos.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30032130

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), mida adult (33-45 cm)+/-2cm, sense cables amb connexió de punt únic a pressió, flexiport, lliure de làtex, PVC, DEHP i BPA. D'un sol pacient fins a 100 usos.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30032857

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió baioneta, mida pediàtric petit (14-20cm)+/-2cm. Compatible amb monito rs Criticare, Philips Medical, HP, Spacelabs, Draeger, Datascope, Zoll, Ivac 4200, Critic 508 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30033828

Descripció llarga:

Funda per a sonda de termòmetre timpànic electrònic infraroig, no estèril, un sol ús, compatible amb amb Monitor Projecte Vida, CSM

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30033837

Descripció llarga:

Tap oïda 14 mm interacústic, tipus bolet, material TPE (cautxú termoplàstic), d'un sol ús. Per timpanometria.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30033838

Descripció llarga:

Tap oïda 12 mm interacústic, tipus bolet, material TPE (cautxú termoplàstic), d'un sol ús. Per timpanometria.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30033839

Descripció llarga:

Tap oïda 10 mm interacústic, tipus bolet, material TPE (cautxú termoplàstic), d'un sol ús. Per timpanometria.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30034052

Descripció llarga:

Termòmetre digital, sense contacte ,temperatura corporal, líquids o d'objectes, apagat automàtic, memòries, senyal acústic, pantalla amb il·luminació, ergonòmic a/pila. Registre temperatura Celsius/Fahrenheit.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30035288

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, petit S, mides (17-22cm)+/-2cm. Compatible amb equips WatchBP 03 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30035289

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, mitjà M, mides (22-32cm)+/-2cm. Compatible amb equips WatchBP 03 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30035300

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, gran L, mides (32-42cm)+/-2cm. Compatible amb equips WatchBP 03 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30035301

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, gran XL, mides (32-52cm)+/-2cm. Compatible amb equips WatchBP 03 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30037815

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), neonatal, 1 sortida, material vinil tou, connexió tipus twist lock, mides (10-15cm) +/-0, 3cm. Compatible amb monitors Philips i cable extensió 3metres +/-20cm o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30039129

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió baioneta, mida neonatal (8-14cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Criti care, Philips Medical, HP, Spacelabs, Draeger, Datascope, Zoll, Ivac 4200, Critic 508 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30039130

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió baioneta, mida pediàtric (20-28cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Cri ticare, Philips Medical, HP, Spacelabs, Draeger, Datascope, Zoll, Ivac 4200, Critic 508 o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30040634

Descripció llarga:

Tap oïda 8 mm interacústic, tipus bolet, material TPE (cautxú termoplàstic), d'un sol ús. Per timpanometria.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30040665

Descripció llarga:

Equip per a irrigació d'oïda.compost: protector,connector i broquets,de plàstic.Compatible sistema irrigació Otoscillo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30041459

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides connexió tipus neo-snap o equivalent, neonatal, mides (3-6cm) +/-0,3cm. Compa tible amb monitors Critikon Dinamap, GE Medical, Systems, Datex-Ohmeda o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30041460

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides connexió tipus neo-snap o equivalent, neonatal, mides (4-8cm) +/-0,3cm. Compa tible amb monitors Critikon Dinamap, GE Medical, Systems, Datex-Ohmeda o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30041461

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides connexió tipus neo-snap o equivalent, neonatal, mides (6-11cm) +/-0,3cm. Comp atible amb monitors Critikon Dinamap, GE Medical, Systems, Datex-Ohmeda o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30041462

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides connexió tipus neo-snap o equivalent, neonatal, mides (7-13cm) +/-0,3cm. Comp atible amb monitors Critikon Dinamap, GE Medical, Systems, Datex-Ohmeda o equivalent. D'un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30041684

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides, connexió Dinaclick, mida nadó (8-14cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Datex-O hmeda, General Electric (GE) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30041685

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides, connexió Dinaclick, mida pediàtrica (13-20cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Datex-Ohmeda, General Electric (GE) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30041686

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides, connexió Dinaclick, mida adult petit (18-26cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Datex-Ohmeda, General Electric (GE) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30041687

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides, connexió Dinaclick, mida adult (23-33cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Datex -Ohmeda, Genera Electric (GE) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30043341

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, mitjà M, mida (25-32cm)+/-2cm. Longitud cable 110cm +/-10cm. Compatible amb equips Blue BP -05 Meditech o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30043342

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, mitjà M, mides (25-35cm)+/-2cm. Compatible amb equips Oscar2 Suntech o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30043370

Descripció llarga:

Braçal per a holter, reutilitzable, connector luer, mida adult petit (17-26cm)+/-2cm. Tancament de seguretat amb velcro. Compatible amb monitors Spacelabs o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30043379

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida adult estàndar (25-34cm)+/-2cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30043380

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida adult gran (32-43cm)+/-2cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30043730

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), mida adult petit (20-28cm)+/-2cm, sense cables amb connexió de punt únic a pressió flexiport, lliure de làtex, PVC, DEHP i BPA. D'un sol pacient fins a 100 usos.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30043731

Descripció llarga:

Connector adaptador flexiport per braçalet PANI 1 sortida, material plàstic, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30043732

Descripció llarga:

Tub adaptador, mida 20cm, per manegots connexió flexiport o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30043733

Descripció llarga:

Connector baioneta per braçalet PANI 1 sortida, compatible amb monitorsHewlett-Packard, Philips, Criticare o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30047344

Descripció llarga:

Làmina adhesiva de cotó hipoal·lèrgic per descàrregues i encoixinats. Mides: 22,5cm x 45cm +/-2cm, gruix 2,6mm +/-0,2mm. Retallable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30047604

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió metall a pressió, mida pediàtrica (16-21cm)+/-2cm, reutilitzable. Compatible amb monitors EDAN o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30047605

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió metall a pressió, mida adult (27-35cm)+/-2cm, reutilitzable. Compatible amb monitors EDAN o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30047606

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió metall a pressió, mida obés (34-43cm)+/-2cm, reutilitzable. Compatible amb monitors EDAN o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30048720

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida nounat (7-10cm)+/-1cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30048721

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida lactant (9-13cm)+/-1cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30048722

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida nen petit (12-16cm)+/-1cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30048723

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida nen (15-21cm)+/-2cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30048724

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), sense tub, connexió flexiport, mida adult petit (20-26cm)+/-2cm. Compatible amb una o dues sortides per equips Welch Allyn o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30051727

Descripció llarga:

Connector adaptador flexiport per braçalet PANI 2 sortides, material plàstic, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30052288

Descripció llarga:

Braçal per a holter, MAPA, reutilitzable, talla L, mides (32-42cm)+/-2cm. Compatible amb equips Oscar2 Suntech o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30052344

Descripció llarga:

Braçal PANI per a proves de esforç, reutilitzable, mides aproximades (24-32cm)+/-2cm. Connector ergoselect. Tancament de seguretat amb velcro. Compatible amb monitors Ergoline o equivalent. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30052505

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides, connexió Dinaclick, mida adult obès (31-40cm)+/-2cm. Compatible amb monitors Datex-Ohmeda, General Electric (GE) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30052506

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 2 sortides connexió tipus Dinaclick o equivalent, adult, mides (23-33cm) +/-3cm. Compatible amb monitors Critikon Dura-Cuf, GE Medical o equivalent. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30053627

Descripció llarga:

Braçal per a holter, reutilitzable, connector luer, mida (13-20cm)+/-2cm. Tancament de seguretat amb velcro. Compatible amb monitors Spacelabs o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30053836

Descripció llarga:

Banda distribuïdora de càrregues amb almohadillat i tancament velcro compatible amb l'equip Autopulse . Lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30053855

Descripció llarga:

Braçal PANI sense micròfon per a proves de esforç, mida adult petit (18-27cm)+/-2cm de circumferència. Tancament de seguretat amb velcro. Compatible amb monitors Tango+ M2 o equivalent. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30053856

Descripció llarga:

Braçal PANI sense micròfon per a proves de esforç, mida adult (25-35cm)+/-2cm de circumferència. Tancament de seguretat amb velcro. Compatible amb monitors Tango+ M2 o equivalent. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30053857

Descripció llarga:

Braçal PANI sense micròfon per a proves de esforç, mida adult gran (27-40cm)+/-2cm de circumferencia. Tancament de seguretat amb ve lcro.
Compatible amb monitors Tango+ M2 o equivalent. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30054015

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), mida pedia (15-21cm)+/-2cm, sense cables amb connexió de punt únic a pressió flexiport, 1 liure de làtex, PVC, DEHP i BPA. D'un sol pacient fins a 100 usos.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30054164

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió luer, mida adult (25-35cm)+/-2cm. Compatible amb monitors MD2000C o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30054165

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, connexió luer, mida pediàtrica (18-26cm)+/-2cm. Compatible amb monitors MD200 0C o equivalent Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30061220

Descripció llarga:

Braçal de pressió arterial monitor (PANI), 1 sortida, mida pediàtrica (17-22 cm)+/-2cm. Compatible amb monitors OMRON M2, M3, M6, mu ltiparamètrics no confort, (CS2) o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 81000034

Descripció llarga:

Optotip pediàtric multidistancia, compost per: una lamina tipus pòster (65 x 50 cm)+/-5cm per a visió llunyana (5m), 1 lamina (21x1 5cm)+/-3cm per visió propera (40cm), 6 targetes de cada un dels dibuixos (10x10cm)+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 81000035

Descripció llarga:

Conjunt Otoscopi i oftalmoscopi de butxaca, fibra òptica, il.luminació led 3,5V, llum blanca 5.500k, otoscopi amb lent de 3 augments i oftalmoscopi amb 18 lents correctores. Alimentació a piles. Funda protectora.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 81000037

Descripció llarga:

Otoscopi de butxaca amb il.luminació halògena de 2,5 V, mànec de metall amb piles/re carregables, tancament roscat, amb lent de 3 aug ments. Complert.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 81000038

Descripció llarga:

Esfigmomanòmetre aneroides portàtil estàndard d'un tub, complet amb braçalet adult, manual. Riester o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 81000039

Descripció llarga:

Esfigmomanòmetre aneroides portàtil estàndard dos tubs, complet amb braçalet adult, manual. Riester o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 81000040

Descripció llarga:

Esfigmomanòmetre aneroides mural, a paret, complet. Riester o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 81000041

Descripció llarga:

Fonendoscopi estàndart, adult, amb campana de doble cara i membrana de doble freqüència amb anells antifred, diàmetres (45 / 33mm)+/-2mm i llargària del tub 70cm+/-20cm, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 81000051

Descripció llarga:

Manòmetre de pressió per a baló del tub endotraqueal i cànula traqueostomia. Amb vàlvula d'inflat i desinflat per ajustar la pressió , indicador de pressió Hi-lo. Connexió luer . Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 81000052

Descripció llarga:

Fonendoscopi estàndart, pediàtric, amb campana de doble cara i membrana de doble freqüència amb anells antifred, diàmetres (3,0 x 2, 5 cm)+/-0,5cm i llargària del tub 70cm+/-20cm, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 81000053

Descripció llarga:

Fonendoscopi estàndart, neonatal, amb campana de doble cara i membrana de doble freqüència amb anells antifred, diàmetres (2,5 x 1, 5 cm)+/-0,5cm i llargària del tub 70cm +/-20cm, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 81000056

Descripció llarga:

Tallímetre adult i pediàtric fixació a paret , rang de medició de 3,5cm a 230cm +/-2cm, divisió 1mm. Homologat.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 81000057

Descripció llarga:

Tallímetre infantil rígid, rang de medició de 0 a 99cm. Divisió 1mm. Alumini per muntar en paret o portàtil. Topalls plegables de ca p i peus. Homologat.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 81000058

Descripció llarga:

Tallímetre infantil flexible, amb protector encoixinat, plegable, rang de medició de 10cm a 99cm +/-2cm, divisió 5mm. Homologat.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 81000059

Descripció llarga:

Cinta mètrica de material sintètic, graduació amb centímetres per les dues cares, retràctil, mesura fins a 1,5m .

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 81000060

Descripció llarga:

Llanterna de diagnòstic tipus llapis, carcasa d'alumini desinfectable, clip de butxaca, llum led, botó encès/apagat, funcionament a piles.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 81000148

Descripció llarga:

Oliva silicona compatible amb fonendoscopi Riester o equivalent. Parell.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 81000149

Descripció llarga:

Capçal otoscopi fibra òptica 3,5 V, lampara Led, optica amb lent de vidre de 3 augments, opció lupa quirúrgica de 4 augments, a/con nexió per a insuflador, compatible amb Riester ri-scope L3 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 81000172

Descripció llarga:

Capçal oftalmoscopi de 3,5V, il.luminació halògena, sense dispositiu antirroboratori, amb 29 lents correctores de -35D a +40D, compati ble amb Riester ri-scope L o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 81000179

Descripció llarga:

Oftalmoscopi de butxaca amb il·luminació halògena de 2,5 V, complet. Optica hermètica, selector de 6 obertures, lent condensadora de vidre, màneç amb alimentació a piles.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 81000180

Descripció llarga:

Capçal otoscopi fibra òptica 3,5 V, lampara Led, optica amb lent de vidre de 3 augments, opció lupa quirúrgica de 4 augments, a/con nexió per a insuflador, compatible amb Riester ri-scope L2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 81000186

Descripció llarga:

Cinturó ajustable per a monitorització compatible amb holter H12+ o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 81000196

Descripció llarga:

Alcoholímetre per lectura orientativa de 75° a 100°, amb rang de mesura de 0,00 a 2,00 g/L

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 81000205

Descripció llarga:

Esfigmomanòmetre electrònic amb lectura digital, portàtil automàtic, pantalla de visualització, medició tensió arterial (PANI) i pol s.Detecció arritmias. Memòries. Inclou braçal de pressió arterial adult (aprox 22-42cm +/-2cm). Homologat.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 81000216

Descripció llarga:

Bàscula per pacients digital (LCD), plataforma ampla de 45cm x 40cm ± 5cm ,fàcil accés: 47 mm d'alçada, superfície antilliscant, pes fins a 200 kg ± 5kg. Sistema d'encesa trepitjant (Step Off) amb permanència del pes a pantalla. Amb piles. Homologada.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 81000645

Descripció llarga:

Sonda monofilament de 10g per a exploració sensorial amb empunyadura i peça articulada de polietilè.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 81000691

Descripció llarga:

Lent plana 58D baix perfil, 200mm² superfície contacte,vermella per a vitrectomia macular, de vidre, amb index de refracció alt i an ell plàstic, per observar la macula en procediments vitroretinians. reutilitzable (esterilitzable en autoclau)

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 81000892

Descripció llarga:

Fonendoscopi estàndart amb campana d'una sola cara i membrana de doble freqüència, anell antifred, diàmetre 45mm+/-5mm i llargària del tub 70cm +/-2cm, lliure làtex, color: no negre, no gris.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 81001050

Descripció llarga:

Manòmetre de precisió, insuflador per a balons d'aire i de control de baixa pressió. Mesura de 0-120cm H2O. Zona de baixa pressió 1 4-25CM H2O.
Tub de pressió prolongador de 100cm connexió Luer mascle/Luer-lock femella. Exent de làlex. No estèril

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 81001060

Descripció llarga:

Lent esfèrica doble pel diagnòstic i tractament de làser. Lent 90D. Camp visió 81°/97°, magnificació 0,93x, punt làser 1,08x, anell: alumini anoditzat, contacte: PMMA, lent: cristal per a làmpada d'hendidura.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 81001061

Descripció llarga:

Lent esfèrica doble sense contacte per l'observació de la retina, amplicamp de visió. Lent 90D. Camp visió 95°/116°, magnificació 0, 76x, punt làser 1,3x, dist treball 7mm, anell: alumini anoditzat, contacte: PMMA, lent: cristal per làmpada d'hendidura.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 81001062

Descripció llarga:

Lent esfèrica doble sense contacte. Lent 20D. Camp visió 46°/60°, magnificació 3,13x, punt làser 0,32x, dist treball 50mm, revestime nts AR/DI, anell: alumini anoditzat, contacte: PMMA, lent: cristal per làmpada d'hendidura.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 81001070

Descripció llarga:

Lent de contacte de Goldman amb 3 miralls, amb tractament per a làser

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 81001071

Descripció llarga:

Lent de camp ampli per al tractament de làser indirecte d'alta qualitat. Camp de visió: 160°/ 165°, magnificació 0,50X, punt làser: 2,00X, revestiments: AR/DI, anell: alumini anoditzat, contacte : PMMA, lent: cristal

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 81001200

Descripció llarga:

Capçal per a otoscopi fibra òptica lampara de Xenon 3,5 V, amb lent de vidre de 3 augments , lupa quirúrgica de 4 augments, amb dis positiu antirobatori, connexió per a insuflador, compatible amb Riester ri-scope L3 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 81001210

Descripció llarga:

Capçal oftalmoscopi de 3,5v, il.luminació xenon halògena (XHL), 27 lents de -35D a +40D, policarbonat, protec antipols, 5 diafragmes , mànec estàndar a piles, compatible amb HEINE K180 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 81001262

Descripció llarga:

Cinturó per a funda protectora del Holter de pressió Diasys Integra II i ACCESS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 81001280

Descripció llarga:

Lent vitriorretinal de visió indirecta d'alta resolució. Camp de visió: 112°/ 134°, magnificació 0,39X, punt làser: 2,60X, anell: al umini anoditzat, contacte : PMMA, lent: cristall

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 81001300

Descripció llarga:

Esfigmomanòmetre anerode complet amb braçalet PANI mida adult, 5 rodes, cistell per deixar braçal, homologat, per ús hospitalari.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 81001430

Descripció llarga:

Lent vitriorretinal de visió indirecta d'alta resolució. Camp de visió: 106°/ 127°, magnificació 0,39X, punt làser: 2,60X, anell alu mini anoditzat, contacte : PMMA, lent: cristall

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 81001460

Descripció llarga:

Capçal otoscopi 3,5v, il.luminació halògena xènon altament presuritzat (HPX), 2,2 augments, 8,8 dioptries, longitud focal 114mm, amb 4 espèculs de 2,5, 3, 4 i 5mm, compatible amb WELCH ALLYN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 81001511

Descripció llarga:

Capçal oftalmoscopi de 3,5V, il.luminació halògena, 28 lents de -25D a +40D, selector de 6 obertures, compatible amb unitat de pared WELCH ALLYN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 81001552

Descripció llarga:

Monitor per enregistra ambulatori freqüència cardíaca, activitat física i despesa energètica, 2 línies a/2 foams adhesius d'ECG, mostres acceleròmetre a 32Hz, resistent H2O, pes <240g, càrrega i transferència dades d'USB a PC. Memòria 300 medi. Precisió ±3mmHg

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 81001602

Descripció llarga:

Capçal per a otoscopi 3,5 V, il.luminació directa Xenon, òptica amb lent de vidre de 3 augments, opció lupa quirúrgica de 4 augments, a/connexió per a insuflador, compatible amb Riester ri-scope L1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 81001663

Descripció llarga:

Funda amb cinturó compatible amb gravadora Holter H12+ i X12+ Mortara o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 81001690

Descripció llarga:

Ulleres pediatria de prova, per la col.locació de lents i filtres compatible amb caixa estàdard, diàmetre 38mm, indicador de graus m
itjançant sistema TA, amb cinta elàstica de fixació. Reutilitzables.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 81001692

Descripció llarga:

Casc font (fotòfor portàtil) de llum led amb bateria de liti recargable 75.000lux, pes 200g, (autonomia mínima 9h) per a ús quirúrgic amb lupes
mínim 2,5 de magnificació, graduables, titani.Compatible ulleres magnificació lupes SAP 81001690

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 81001730

Descripció llarga:

Fonendoscopi estàdard, neonatal, amb campana de doble cara i membrana de doble freqüència amb anells antifred, diàmetres (2,5 x 1, 5 cm)+/-0,5cm i
llargària del tub 70cm +/-20cm, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 81001840

Descripció llarga:

Funda/bossa protectora de roba, per a MAPA (monitorització ambulatoria pressió arterial). No estèril. Compatible amb cinturó i corre tja del
Holter Spacelab model 90207 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 81001930

Descripció llarga:

Màneg amb cable per otoscopi o oftalmoscopi HEINE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 81001943

Descripció llarga:

Bàscula per pacients digital (LCD) plataforma de 30cm x 30cm +/-3cm,fàcil accés: 32 mm d'alçada superfície cautxú, pes fins a 150kg ± 5kg. Sistema
de desconexió automàtica, funcionament amb piles. Homologada.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 81001944

Descripció llarga:

Bàscula per pesar òrgans, bolquers i altra material sanitari, digital (LCD) de sobre taula, plataforma segellada d'acer inoxidable, capacitat
fins a 5 kg ± 1 kg, registre de pre tara, divisió 1 g < 3 kg , funcionament amb bateria. Homologada.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 81001951

Descripció llarga:

Lent vitriorretinal de visió indirecta d'alta resolució. Camp de visió: 106°/ 127°, magnificació 0,48X, sense punt làser amb anell d'alumini anoditzat, lent cristall,esterilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 81002011

Descripció llarga:

Manòmetre pressió pleural rang de pressió -500 +500cm H2O i precisió ± 2cm H2O <50cm H2O, connexió luer lock a cada extrem, dispositiu d'autocalibració (bateria 3V). Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 81002034

Descripció llarga:

Lent vitriorretinal de visió indirecta d'alta resolució. Camp de visió: 130°/150°, magnificació 0,43X, anell de perfil petit.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 81002045

Descripció llarga:

Manegot d'isquèmia simple per a cuixa per a torniquet pneumàtic, mida de 86x14cm +/- 2 cm. Tancament de veta adherent i corretja. Lliure de làtex, autoclavable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 81002087

Descripció llarga:

Otoscopi de butxaca amb il·luminació led de 3,5 V, material de plàstic amb lent de 3 augments. Alimentació al mànec amb piles. Compl et. Compatible amb espèculs Riester, ri-scope o equivalents.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 81002107

Descripció llarga:

Funda protectora plàstic per a protecció Holter Supplies AFT1000-B o equivalent. Compatible amb pinça tancament.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 81002108

Descripció llarga:

Pinça tancament funda Holter Supplies AFT1000-B o equivalent. Compatible amb funda protectora.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 81002149

Descripció llarga:

Lent làser de camp ampli per a suturolisis, tipus Hoskins amb mànec 79mm. Camp de visió: magnificació 1,2x, punt làser: 0,83x, diàmetre tre contacte: 3mm. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 81002213

Descripció llarga:

Funda protectora per a holter amb una cara transparent i cinta per a penjar, tancament adhesiu, mida 9x8cm +1cm, un sol ús, compatible amb Spiderflash o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 81002231

Descripció llarga:

Barra tèrmica per exploracions peu diabètic. Ø15mm x 100mm de longitud, un extrem material plàstic i l'altre metàl·lic.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 81002237

Descripció llarga:

Esfigmomanòmetre electrònic digital automat, portàtil, sobretaula, pantalla de visualització, medicació tensió arterial(PANI) i pols.Detecció d'aritmies.Memòries. Inclou braçal adult (aprox 22-42cm). Ús professional sanitari.Homologat. OMRON M6 AC o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 81002285

Descripció llarga:

Optotip E SNELLEN tipus pòster PVC semirígid, mida 60x50cm +/-5cm, calibrat per a visió a 3m de distància, amb 15 línies i 5 símbols per línia, rang de 0,1 a 2,5.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 81002310

Descripció llarga:

Funda protectora per Holter amb cinta per penjar a la cintura compatible amb holter WATCH BP 03 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 81002315

Descripció llarga:

Funda amb cinturó de cotó, mida 300 x 230 x80 mm, compatible amb aparell ECG Vyntus ECG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 81002363

Descripció llarga:

Monitor per a registre domiciliari de la PAP en control de malats amb IC (insuficiència cardíaca) amb sistema de dades (GSM, Wi-Fi, telefonia fixa) i transferència a lloc Web. Compatible amb CardioMEMS HF o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 81002371

Descripció llarga:

Bàscula digital (LCD) per pacients, plataforma ampla de 40cm x 40cm x78mm ± 3cm, superfície antilliscant, pes fins a 250 kg ± 5kg. Tallimetre de 70 -204 cm. Funció IMC, permanència del pes a pantalla. Amb piles. Apagat automàtic. Homologada.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 81002374

Descripció llarga:

Manegot isquèmia complet, 2 tubs (llarg tub 15cm +/-2cm), canell. Mida braçal aprox 30cm x 7.5 cm. Rang pressió 100-475mmHg (+/-2% precisió).Tires tancament a/velcro de seguretat.Connexió ràpida,compatible sistema SmartPUMP o equival. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 81002375

Descripció llarga:

Manegot isquèmia complet, 2 tubs (llarg tub 15cm +/-2cm), braç. Mida braçal aprox 46cm x 7.5 cm. Rang pressió 100-475mmHg (+/-2% precisió).Tires tancament a/velcro de seguretat.Connexió ràpida,compatible sistema SmartPUMP o equival. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 81002376

Descripció llarga:

Manegot isquèmia complet, 2 tubs (llarg tub 15cm +/-2cm), cama. Mida braçal aprox 86cm x 10 cm. Rang pressió 100-475mmHg (+/-2% precisió).Tires tancament a/velcro de seguretat.Connexió ràpida,compatible sistema SmartPUMP o equival. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 81002377

Descripció llarga:

Manegot isquèmia complet, 2 tubs (llarg tub 15cm +/-2cm), cama XXL. Mida braçal aprox 112cm x 11,5 cm. Rang pressió 100-475mmHg (+/-2% precisió).Tires tancament a/velcro de seguretat.Connexió ràpida,compatible sistema SmartPUMP o equival. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 81002378

Descripció llarga:

Funda p/holter nyló amb finestra per visualitzar pantalla i accés a polsadors.tancament amb cremallera. Reutilitzable, compatible amb b HOLTER Suntech OSCAR 2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 81002390

Descripció llarga:

Equip manegots per a la medició index-turmell braç ITB format per manegots de diferents colors (vermell, groc i verd), Talla M, mida 22-32cm +/-2cm compatible amb el sistema de medició MESSI o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 81002405

Descripció llarga:

Bàscula electrònica pesabebés de fina graduació de 10g, amb plataforma per nen petit fins a 20Kgr.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 81002415

Descripció llarga:

Manegot isquèmia complet per a torniquet pneumàtic digital, 1 tub, midacambra 52cm x 7cm, contorn braçal >30cm <45cm. Rang de pressió 100-400mmHg (+/-2% precisió). Connexió luer o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 81002416

Descripció llarga:

Lent gonio de 1,2 augments per procediment de glaucoma minimament invasius (MIGS). Diàmetre de contacte 9mm, diàmetre de l'anell 10mm, longitud màne 75mm +/-5mm.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 81002417

Descripció llarga:

Inclinòmetre/goniòmetre clínic per a lectura de flexió, extensió, abducció i adducció. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 81002451

Descripció llarga:

Funda protectora amb cinta per a penjar i finestra transparent per visualització, compatible amb grabadora suor Spiderflash o equiva lent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 81002466

Descripció llarga:

Lent oftalmoscopia indirecta 28D dioptries, augment de la imatge 2,13x, punt làser 0,47x, distància de treball des de la còrnea 29mm, apertura 38,2mm, pes 22gr

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 81002467

Descripció llarga:

Oclusor ocular translúcid amb mànec. Alçada total: 22,5 cm. Diàmetre del disc oclusor 5,9cm per a l'exploració de la funció visual.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 81002472

Descripció llarga:

Capçal oftalmoscopi de 3,5V, il.luminació halògena, amb dispositiu antirroboratori, amb 29 lents correctores de -35D a +40D, compatible amb Riester ri-scope XL o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 81002478

Descripció llarga:

Lent vitriorretinal de visió directa d'alta resolució. Camp de visió: 30°, augment de la imatge 0,92x, sense necessitat d'anell estabilitzador, lent cristall, esterilitzable a vapor.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 81002485

Descripció llarga:

Fonendoscopi adult i pediàtric amb campana de doble cara específic cardiologia, anells antifred, diàmetres (3,0 x 2,5 cm)+/-0,5cm i llargària del tub 70cm+/-20cm, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 81002524

Descripció llarga:

Braçal isquèmia complet, 1 tub (llarg del tub 15cm +/-2cm), Mida braçal mida 85cm x 10cm +/-2cm. Rang de pressió 100-475mmHg (+/-2% precissió). Connexió QuickConnect o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 81002533

Descripció llarga:

Recanvi de fonendoscopi Littmann. Equip compost de: anella anti-fred, olives petites, anella i diafragma de doble membrana. Mida ad ult.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 81002534

Descripció llarga:

Recanvi de fonendoscopi Littmann. Equip compost de: anella negra, diafragma de doble membrana, anella gris. Mida infantil.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 81002535

Descripció llarga:

Recanvi de fonendoscopi Littmann. Equip compost de: anella negra, diafragma de doble membrana, anella gris. Mida neonatal

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 81002540

Descripció llarga:

Tarjeta SD 24-48 hores, alta fidelitat, compatible amb Holter H12+ o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 81002558

Descripció llarga:

Lent vitreoretinal d'alta resolució amb autoestabilitzador, camp de visió 73°/88° i magnificació de la imatge 0,71x.

SOL.COMANDA: 1101343135 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 81002656

Descripció llarga:

Equip exploració neurològica peu diabètic :diapasó Rydel-Siffer 64/128 amb sordines i peu; monofilament de 10g tipus Semmes Weintein ; barra tèrmica fred/calor (plàstic/metall), martell tipus Buck i pinzell. Amb bossa emmatzematge

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2., en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

[illegible]

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	

	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
		Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D3

Fitxa Criteris Addicionals

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	

DESGLOSSAMENT - 1

LOTS: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 i 25

[illegible]

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

DESGLOSSAMENT - 3

LOTS: 1, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, i 41

[illegible]

Identificació de l'empresa

Nom

--

NIF

--

DESGLOSSAMENT - 5

LOT: 27

[illegible]

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra obligatòria

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
20	30004770	Funda per a sonda de termòmetre electrònic, plàstic rígid suau, un sol ús. Compatible amb FILAC 3000 AD o equivalent.	1 unitat	
20	30015541	Funda per a sonda de termòmetre timpànic electrònic infraroig, no estèril, un sol ús, compatible amb GENIUS-2 o equivalent.	1 unitat	

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNumber	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradelItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradelItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradelItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradelItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradelItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradelItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato a aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno