


DOCUMENT CCB_PLECS: PlecprescripcionsTècnic2023_1149	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9XSXZ-3TQ3B-S496C Data d'emissió: 5 de Maig de 2023 a les 8:37:54 Pàgina 1 de 4	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 05/05/2023 08:37



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 557569 9XSXZ-3TQ3B-S496C-1BEE2235015E1CF968D19BE5A5FA9F7759391F9E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciutadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=1




CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Incl. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 4 PRESAMOSTRES PER LES EDARS DE GUALBA, GRANOLLERS Y MONTSENY Exp.: 2023/1149


DOCUMENT CCB_PLECS: PlecprescripcionsTècnic2023_1149	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9XSXZ-3TQ3B-S496C Data d'emissió: 5 de Maig de 2023 a les 8:37:54 Pàgina 2 de 4	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 05/05/2023 08:37



Índex

1. OBJECTE2
2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR.....2
3. LLOC DE SUBMINISTRAMENT.....3

DOCUMENT CCB_PLECS: PlecprescripcionsTècnic2023_1149	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9XSXZ-3TQ3B-S496C Data d'emissió: 5 de Maig de 2023 a les 8:37:54 Pàgina 3 de 4	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 05/05/2023 08:37



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 55769 9XSXZ-3TQ3B-S496C -1BEE2235015E1CF968D19B5A5FA9F775931F9E) generada amb l'aplicació informática Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.calportalCiudadportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=1

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament de 4 (cuatre) presamostres automàtics, per a l'EDAR de Gualba, Granollers i Montseny.

2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR



Les proposicions econòmiques i tècniques han de complir amb les següents característiques tècniques i funcionals:

Presamostres automàtic BÜHLER 3011 o equivalent:

<i>Utilitat:</i>	aigua residual
<i>Dimensions amb la tapa posada:</i>	Amb la tapa ficada 1100 mm x 760 mm x 775 mm Amb la tapa oberta 1640 mm x 760 mm x 775 mm
<i>Principi de mostreig:</i>	Bomba peristàltica
<i>Configuració de botelles:</i>	24 botelles de PE de 1 litre
<i>Altura d'aspiració de mostreig:</i>	Màx. 8 m (a 1013 hPa)
<i>Velocitat d'aspiració de mostra:</i>	> 0,5 m/s per a altura màx. d'aspiració de 7 m (a 1013 hPa); regulació de bomba ajustable electrònicament.
<i>Longitud tub:</i>	Tub PVC de 7,5 m (9 mm)
<i>Volum de mostra:</i>	20 a 350 ml lliurement ajustable
<i>Temps d'ompliment d'ampolles:</i>	1 min a 999 h 59 min
<i>Manera pausa:</i>	1 min a 99 h 59 min
<i>Modes d'interval de mostreig:</i>	Mostreig basat en temps, volum i esdeveniments. Seleccionable començament retardat del programa Possible en qualsevol moment, sense interferir en la seqüència programada
<i>Mostreig manual:</i>	
<i>Precisió del volum de mostra:</i>	1,5% (interval de confiança 95%)
<i>Tipus de distribuïdor:</i>	Distribuïdor robust circular
<i>Sistema de dispensació:</i>	Sistema standard de buit. Volum de mostra seleccionable: 20 a 350 ml
<i>Entrades de senyal:</i>	1 analògica: 4 a 20 mA
<i>Sortides de senyal:</i>	Depenent del model, fins a 8 digitals (lliurement programables)
<i>Nombre de programes d'usuari:</i>	6 programes de mostreig definits per l'usuari (lliurement programables)
<i>Missatges d'estat:</i>	1 relé de sortida per a missatge d'avís d'avaría general
<i>Control de temperatura</i>	Refrigeració i escalfament regulats independentment amb 2 ajustos. Temperatura de la secció de mostres: 4 °C (ajustable de 0,0 a 9,9 °C)
<i>Requisits d'alimentació:</i>	230 V / 115 V, 350 VA (amb refrigeració), sistema de fusibles 10 A mín.
<i>Temperatura d'operació:</i>	De -20 a +43 °C
<i>Temperatura de la mostra:</i>	De 0,1 a 40 °C
<i>Detalls de la carcassa:</i>	- Plàstic PE de doble paret amb aïllament de 50 mm - Material sostre i coberta: Styrosun (GFK) - Coberta amb subjecció per amortidor, protegida enfront de vent - Manteniment senzill - Entrada d'aspiració des del costat dret de la carcassa

DOCUMENT CCB_PLECS: PlecprescripcionsTècnic2023_1149	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9XSXZ-3TQ3B-S496C Data d'emissió: 5 de Maig de 2023 a les 8:37:54 Pàgina 4 de 4	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 05/05/2023 08:37

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 557569 9XSXZ-3TQ3B-S496C-1BEE2235015E1CF968D19BE5A5FA9F7759391F9E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciutadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=1

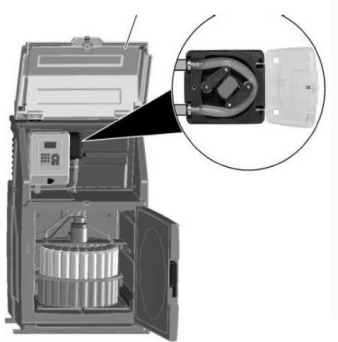

3. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

Els equips se subministraran a l'EDAR Montornès del Vallès.
Carrer Besòs, s/n - Zona Industrial "Can Buscarons de Baix" - 08170 Montornès del Vallès