

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101352897/23/AMUP

Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a
administració de fluids

INDEX

1. Condicions generals.....	3
1.1. Objecte de la contractació.....	3
1.2. Característiques de la contractació.....	3
1.3. Tècnics	3
2. Requeriments obligatoris	3
2.1. Normativa aplicable	3
2.2. Especificacions tècniques generals	3
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	4
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	4
3. Com presentar la oferta.....	13
3.1. Oferta tècnica	13
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	15
3.4. Documentació confidencial	16
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	16
4.1. Prevenció de riscos laborals.....	16
4.2. Formació	16
4.3. Manual d'usuari	17
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	917
4.4.2. Garantia de subministrament.....	17
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	17
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	191
4.4.2.3. Termini de lliurament	19
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda.....	19
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	20
4.4.3. Sistema EDI.....	20
4.5. Condicions de l'operador logístic	22
4.5.1. Embalatges	22
4.5.2. L'albarà	23
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	23
4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia	24
4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE..	17
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)....	19

Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de **Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requeriments obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

En el cas que sigui necessari la cessió d'un equip, les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic els aparells necessaris per la utilització d'aquest material en els nostres centres.

Com a orientació es detallen els aparells actualment cedits que pot variar, en el cas de necessitat dels centres.

Licitació "Fungible compatible amb equip Renalguard".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Renalguard, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 1, aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Medimix".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Medimix, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 1, aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip ExactaMix 2400".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips ExactaMix 2400, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 3, aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Repeater Pump".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Repeater Pump, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 4, aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris CC".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Alaris CC, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 2391, aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris GP".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Alaris GP, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 2155 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris GH".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Alaris GH, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 560 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris PK".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Alaris PK, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual. El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 15 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris GW".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Alaris GW, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 1850 prox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació “Fungible compatible equip CADD/Legacy/Solis”.

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips CADD/Legacy/Solis, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 479 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació “Fungible compatible equip Perfusor Space”.

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Perfusor Space, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 158 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació “Fungible compatible equip Ulrich”.

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Ulrich, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 4 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip Sapphire EPI".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Sapphire EPI, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 22 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip Alaris VP".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Alaris VP, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 930 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip Infosumat Space".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Infosumat Space, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 1.082 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip Plum 360".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Plum 360, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 1427 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip A+ / A+ Mednet".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips A+ / A+ Mednet, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 11 aprox. A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip H100".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips H100, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 126 aprox. A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació “Fungible compatible equip Signature Edition”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Signature Edition, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 408 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitació “Fungible compatible equip Body Guard”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Body Guard, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 80 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

CONECTIVITAT. Les empreses s'hauran de fer càrrec de la connectivitat de les bombes adjudicades, amb els sistemes dels diferents centres que ho requereixin, especialment serveis especials/crítics UCI, Coronària, REA, UCIES i d'altres unitats.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 11012xxxxx_2bis

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a

“Documentació complementària a la Product Data”. La no presentació d’aquest certificat podrà ser motiu d’exclusió.

Dins d’aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d’anomenar-se d’aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d’Obligat compliment, ANNEX D3**
NO HI HA
- **Llista-resum, Criteris addicionals d’adjudicació, ANNEX D4**
NO HI HA

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d’incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data, només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Per el Lot 13, es demanarà mostres via Mail una vegada es faci la valoració tècnica del Sobre 2 per fer la valoració de criteris objectius d’aquest lot.

L’òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d’avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s’indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s’indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l’Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l’ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- No requereix document obligatori

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

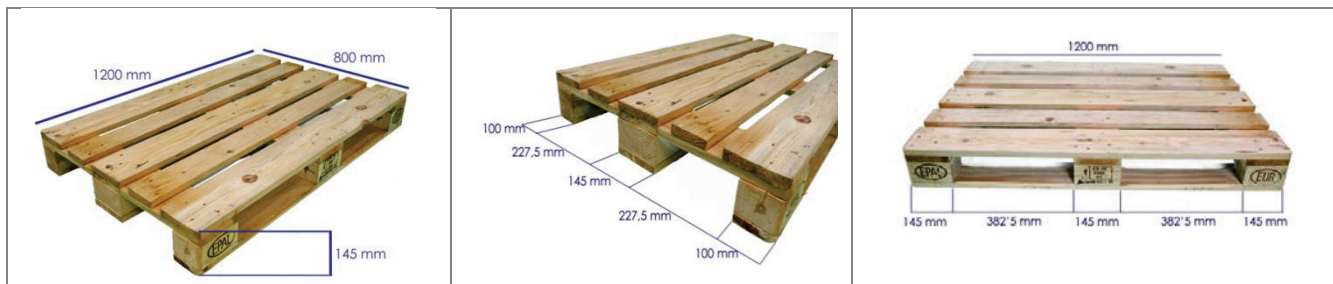

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas què l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiquen-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE

	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (NO HI HA)

ANNEX E – Presentació de mostres (només lot 13)

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30000032	Xeringa 3 cossos de 50mL capacitat amb agulla 14Gx1"(2x30mm) p/bombes perfusió,cos opac amb connexió Luer Lock concèntric,escala impresa inesborrable graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30000033	Xeringa 3 cossos de 50/60mL de capacitat per a bombes de perfusió, cos opac (ambre) amb connexió Luer Lock concèntric, escala impresa inesborrable de graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30005234	Xeringa 3cossos 50mL a/agulla càrrega connectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30008483	Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en procediments de microdiàlisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa inesborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30015802	Xeringa de 3 cossos de 50 mL per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent lubricat amb escala impresa inesborrable de graduació 1 mL, èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làt,1ús,env ind. Compatible a/bomba infusió xeringa.	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30030316	Xeringa de 3 cossos de 50/60mL de capacitat per a bombes de perfusió, cos transparent amb connexió Luer Lock concèntric, escala impresa imborrable de graduació 1mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtex,1ús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30034205	Xeringa de 3 cossos de 50/60 mL connexió connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 1 mL,èmbol a/anella segur.Est,s/làt/DEHP/BFA,1ús,env ind.Compatible a/robot reconstituïció fàrmac Kiro o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30034936	Xeringa de 3 cossos 3 mL, connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,1 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làt/DEHP/BFA,1ús, env ind.Compatible a/robot reconstituïció fàrmac Kiro o eq	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30034937	Xeringa de 3 cossos 30 mL, connexió Luer Lock excèntrica, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 1 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtx/DEHP/BFA,1ús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30035007	Xeringa de 3 cossos 10 mL, connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent i lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,2 mL, èmbol amb anella seguretat.Est,s/làtx/DEHP/BFA,1ús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30035015	Xeringa de 3 cossos 5mL connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,2 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtx/DEHP/BFA,1ús,env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30038041	Xeringa de 3 cossos de 50 mL a/ag 15G x 1 1/2"(1,8x40mm) p/bomba perfusió. Cos de polipropilè (PP) transparent amb escala impresa inesborrable,anell seguretat.Estèril,s/làtx,làtex,DEHP,1ús,env ind.Compatible amb bomba de xeringa Orchestra Mòdul DPS o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30040292	Xeringa 3cossos 20mL a/agulla càrrega conectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30040293	Xeringa bomba infusió 3cossos 50mL,agulla càrrega+filtre 15µm,LL central,taronja-ambre fotoprotector,doble graduació inesborrable,topall segur,junta estanqueïtat.Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	Lot No Obligatori
1	Xeringues per a bombes infusió/preparacions endovenoses	30058498	Xeringa 3cossos 50mL p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	Lot No Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30004453	Eq EV bomba TPE transparent, 275(+/-10)cm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre de 15µ, purga 25+/-1mL, port distal en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, s/làtx/DEHP, estèril, envàs ind,un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30004457	Línia prolongadora EV sensor de pressió bomba xeringa, opaca ambre, 200 (+/-10)cm, purga 1,5 mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible bomba Alaris CC o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30005233	Línia prolongadora EV amb sensor pressió bomba xeringa, PVC, transparent, 200 (+/-10) cm, purga 1,5mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible bomba xeringa Alaris CC/P7000 o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30015297	Eq EV bomba PVC, 230 (+/-5) cm, i 3mm calibre, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22(+/-1)mL, conn distal L-L, tancament amb pinça de cargol, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un ús. Compatible Alaris GW o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30015298	Eq EV bomba volumètrica, PVC opac, 250 (+/-10) cm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça cargol, s/làtex,sense DEHP,estèril,ind,1ús.Compatible bomba Alaris GW o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30015307	Eq EV bomba, baixa absorció, TPE, 270 (+/-10) cm i 3mm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig, tròcar x flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24 (+/-1)mL, conn distal L-L,tancament pinça cargol,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Alaris GW o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018161	Eq EV bomba,baixa absorció, TPE, 275 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig+ trocar x flascó/bossa, filtre15µ, purga 25(+/-1)mL, connexió distal L-L, pinça segur, pinça cargol+pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Alaris GP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018162	Eq EV bomba, PVC, 255 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24(+/-1)mL, 2 ports en "Y"+vàlvula segur, connexió distal L-L, tancament pinça seguretat i pinça rodet,s/làtex/DEHP, estèril,ind,1ús. Compatible Alaris GP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018163	Eq EV bomba PVC, 265 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça seguretat i amb pinça rodet, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30018164	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 250 (+/-10) cm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 23(+/-1)mL, connexió distal L-L, pinça seguretat, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Alaris GP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30028305	Eq EV sang/hemoderivats PVC 275 (+/-10) cm, 2 ports "Y" (proximal i distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 31(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Alaris GP o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30029969	Eq EV sang/hemoderivats PVC 285 (+/-10) cm x 3mm, port "Y" per injecció (abans cambra), cambra degoteig+filtre200µ, purga 32(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i amb pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Alaris GW o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30029990	Eq EV bomba PVC, 220 (+/-10) cm x 3mm, cambra de degoteig+trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 21(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un ús. Compatible amb bomba Alaris GW o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30040199	Eq EV bomba,PVC opac, 300 (+/-10) cm, disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+tròcar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27 (+/-1)mL, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Alaris VP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30040200	Eq EV bomba,PVC transparent, 300 (+/-10) cm, disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+tròcar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27(+/-1)mL,tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compat Alaris VP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30054032	Eq EV infusió PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, 2 ports "Y" (proximali distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 25(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Alaris GP o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30054403	Eq EV sang/hemoderivats PVC 300 (+/-10) cm x 3mm, disc sensor pressió, segment bomba silicona, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 29(+/-1)mL, connexió distal L-L mascle, tancament pinça,sense DEHP,estèril,envàs individual,1ús.Compatible bomba Alaris o eq	Lot Obligatori
2	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i de xeringa_1	30059524	Eq EV bomba,baixa absorció,elastòmer termoplàstic (TPE),300(+/-10)cm,sensor pressió,cambra degoteig filtre15µ+trocar x flascó/bossa,purga27(+/-1)mL, conn distal L-L,pinça segur,pinça cargol+pinça rodet,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Alaris VP o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30003217	Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, casset+port secundari, clamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APlus+ o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30004143	Eq bomba infusió, PVC, 198(+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador línia blava,extrem distal a/connexió LL M, volum purgat 2,3 mL,pinça,tap,s/làtex/DEHP,est,env ind,1ús.Compatible bombes inf ambulatòries CADD Legacy/Solis/Prizm o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30004445	Eq EV bomba PVC transparent, 272 (+/-10) cm, punxó amb presa aire, cambra de degoteig 20 gotes/mL i filtre 15µ, clamp, cassat, punt d'injecció en "Y", s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Life Care/Plum o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30004454	Eq EV sang en bomba, PVC, dos punxons en "Y" amb regulador de flux de rodet, cambra de degoteig amb filtre de 200 µ, cassat amb port secundari de seguretat, connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, estèril, ind, un sol ús. Compatible LifeCare/plum o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30004456	Eq bomba infusió,PVC,290(+/-10)cm,dispositiu arrossegat,vàlv antireflux, perforador+filtre,port injecc s/agulla,extrem distal a/connexió LL M,purgat 14mL,pinça,tap,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús.Compatible bombes inf ambulatories CADD Legacy/Solis/Prizm o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30034028	Eq inf EV bomba volumè,PVC,opac,285(+/-10)cm,punxó a/presa aire, cambra de degoteig a/vàlvula entrada aire+filtre 15 µ,casset,pinça rodet,port "Y "injec segur, connexió LL M, tap,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús.Compatible bombes inf ambulatories Medima o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30034030	Eq inf EV bomba volumè,PVC,transparent,285(+/-10)cm,punxó a/presa aire, cambra de degoteig a/vàlvula entrada aire+filtre 15 µ,casset,pinça rodet,port "Y "injec segur, connexió LL M, tap,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús.Compatible bombes inf ambulatories Medi	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30048549	Eq infusió EV bomba, tub resistent llum amb revestiment PE, 272(+/-10)cm, a/punxó amb presa aire+clamp, cambra degoteig amb filtre de 15 µ i port, filtre 0,2 µ + clamp, punt injecc "Y", conn segur. S/làtex i DEHP, est, 1 ús. Compatible Life Care/Plum o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30052495	Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, clamp, cassat, punt d'injecció en "Y", connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús.Compatible LifeCare/Plumset	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30052832	Equip infusió endovenós per a bomba PVC,272 (+/-10) cm,amb filtre de 15µl en càmara transparent,port secundari,clamp,punt d'injecció en "Y" i clamp amb tancament segur,s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatibleamb bomba LifeShield o equivalent	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30053957	Eq infusió EV bomba,PVC, tub ambre PE per a fàrmacs fotosensibles,216(+/-10)cm,4 ports segur tipus Clave, connector Y tipus Clave, cambra de degoteig filtre de 15 µ. punxó flascó, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba Plum 360 o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30053958	Línia 43 (+/-3)cm a/punxo+filtre venteig, connector en Y tipus Clave, 2clamps, filtre 0,2µ baixa afinitat a proteïnes hidrofòbic, vàlvula antiretorn,connector Luer Lock a/tap a/filtre 1,2µ,s/làtex/DEHP,estèril,env indi,1ús.Compatible bomba Plum 360 o eq	Lot Obligatori
3	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_2	30053959	Línia de 41 (+/-3)cm opaca, per a fàrmacs fotosensibles, punxo amb filtre de venteig, connector en Y tipus Clave, clamp, vàlvula antiretorn, connector Luer Lock amb tap amb filtre 1,2 µ, s/làtex/DEHP, estèril, env ind, 1ús.Compatible bomba Plum 360 o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30004450	Eq EV bomba PVC, 300 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, bureta 150mL,cambra degoteig transparent+tròcar, purga 17(+/-1)mL, connexió distal Y"segur i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30004451	Eq EV bomba PVC, 255 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig+trocar, filtre 15µ, purga 22(+/-1)mL, connexió distal en "Y"de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30007426	Eq EV sang a/bomba volumètrica,PVC, 275(+/-10)cm,punxó a/cambra degoteig transparent a/filtre 200µ aleta compatible a/sensor,sist anti-reflux,rodet,purga 26mL,conn distal LL mascle rotatori,s/làt/DEHP,est,1ús.Compatibl bomba Signature Edition I/II o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30007502	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 280 (+/-10) cm, sensor pressió i resistència, cambra degoteig, filtre 15µ, purga 25(+/-1)mL, port injecció en "Y"+vàlvula segur,connexió distal L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,1sol ús.Compatible bomba Signature Edition o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30018775	Equip EV bomba volumètrica, TPU/EVA (baixa absorció), opac,265 (+/-10) cm longitud, 5 ports: vàlvula seguretat (4 en "Y"), cambra degoteig+filtre venteig 15µ,purga 24ml, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30042627	Eq EV bomba volumètrica PE transparent, 285 (+/-10) cm, filtre incorporat de 0,2 µm, cambra de degoteig, volum de purga de 25 mL, connexió distal L-L, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenòs per a bombes volumètriques i xeringa_3	30052494	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica, PVC,opac,240(+/-10) cm longitud,cambra degoteig, segment de bomba, filtre de 15 µ, volum de purga de 5(+/-1) mL, punt injecció s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,1ús. Compatible bomba Body Guard o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
4	Equip i línies d'infusió endovenós per a bombes volumètriques i xeringa_3	30052512	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica, PVC,transparent,240(+/-10) cm longitud,cambra degoteig, segment de bomba, filtre de 15 µ, volum de purga de 5(+/-1) mL, punt injecció s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,1ús. Compatible bomba Body Guard o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenós per a bombes volumètriques i xeringa_3	30054405	Eq infusió endovenós baixa absorció bomba volumètrica, PVC,transparent,240(+/-10)cm longitud,cambra degoteig, segment de bomba, filtre 15 µ, volum de purga de 5(+/-1)mL, punt injecció s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,1ús. Compatible bomba Body Guard o eq	Lot Obligatori
4	Equip i línies d'infusió endovenós per a bombes volumètriques i xeringa_3	30059439	Eq inf EV bomba sang, clorur polivinil (PVC) transparent, 240(+/-10)cm long, cambra degoteig, segment de bomba, filtre sang 18µ, volum purga 6(+/-1)mL,punt injecció Y sense agulla, LL, s/làtex/DEHP,est,1ús.Compatible bomba BodyGuard Color Vision o eq	Lot Obligatori
5	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30002555	Eq exsanguini-transfusió a nounats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40 (+/-2)cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa graduada recollida sang de 2000 (+/-100)mL, xeringues 10/20 mL. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
5	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30002622	Eq infusió EV sang gravetat pediatria, PVC, consta de: punxó, bureta cilíndrica graduada de 100 (+/-10) mL amb filtre de 200 µ i punt d'injecció L-L,punt "Y" injecció,Luer Lock mascle terminal a/tap filtre purga, s/làtex/DEHP,estèril,env ind,1ús	Lot No Obligatori
5	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30002687	Eq infusió EV administració sang, plàstic transparent, 203 (+/-10) cm. Punxó, cambra degoteig amb filtre 200µ, cilindre de purgat, manegot a pressió, regulador flux de rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
5	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30030728	Eq infusió endovenós administració sang, per gravetat, de clorur polivinil (PVC) transparent, de 200(+/-10)cm llarg, punxó, doble cambra tancada amb filtre de sang 200µ, regulador flux rodet, connexió terminal L-L mascle,s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
5	Equip d'infusió endovenós per a administració de sang	30030729	Equip infusió admin sang gravetat tub PVC transparent de 165 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL+filtre sang partícules, connexió terminal L-L mascle giratori amb tap+filtre purga membrana antibact, sense làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús	Lot No Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis o equivalent.	Lot Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30001594	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 50 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies o equivalent.	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30002617	Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+ connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatories CADD Legacy/Solis o eq	Lot Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30003215	Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm,dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq	Lot Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservoris i bombes CADD Legacy/Solis) o eq	Lot Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30007467	Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexió L-L mascle, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq	Lot Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30018084	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o equivalent.	Lot Obligatori
6	Equips i línies per a bombes d'infusió ambulatoria	30034238	Línia bomba infusió PVC 152 (+/-10) cm, filtre, volum purgat 1,8 mL, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible reservori i bomba CADD Legacy/Solis) o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030741	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind,1ús . Compatible amb bomba Infosumat Space o equivalent.	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030742	Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús . Compatible Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30030743	Equip infusió EV bomba volumètrica,PUR,fàrmacs baixa absorció,punxó,cambra degoteig a/presa aire i filtre 15µm,regulador,clamp,tub 3mm DI i 4,1mm DE,long 250(+/-10)cm,connexió LL.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infosumat Space o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30034250	Eq infusió EV sang bomba volum,PVC,250(+/-10)cm llarg,punxó,pressa aire+filtre antibact,cistella filtrat 200µm,cambra gota a/filtre 15µm,pinça antireflux,connexió LL rotatori a/tap a/membrana.Est,s/làt/DEHP,env ind,1ús.Comp a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30037817	Eq infusió EV bomba volumètrica,PUR,fàrmacs baixa absorció,filtre 0,2µm,punxó,cambra degoteig a/presa aire+filtre 15µm,regulador rodet,clamp,tub 3mmDlx4,1mmDE,250(+/-10)cm,conn LL.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30038882	Eq EV bomba transparent,300(+/-10)cm.Punxó, membrana segur+cambra gota+segur+presa aire+filtre 15µ,punt entrada medicació s/agulla, regulador rodet,tap antidegoteig,pinça, conn L-L.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039708	Línia Prolongadora per a administració de fàrmacs citostàtics, PUR, 35 (+/-2)cm llarg. Consta de: punxó, vàlvula antirreflux, connexió LL audible amb filtre hidròfob,clamp tancament.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039709	Eq inf EV bomba volum,PUR,sist tancat,citos,punxó,cambra gota a/presa aire+filtre 15µm,rodet,clamp,conn LL,tub 230(+/-10)cm llarg,2 vàlv antireflux fins 3,1 bars,1 vàlv bidirecció.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039710	Eq inf EV bomba volum,PUR,sist tancat,citos,punxó,cambra gota a/presa aire+filtre 15µm,rodet,clamp,conn LL,tub 230(+/-10)cm llarg,4 vàlv antireflux fins 3,1 bars,1 vàlv bidirecció.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/ bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039711	Línia Prolongadora administració/preparació i reconstitució citostàtics,PUR, 35(+/-5)cm llarg,filtre 0,2µm línia, vàlvula fins 3,1 bars,connexió LL audible a/filtre hidròfob,clamp.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039712	Línia Prolongadora administració/preparació i reconstitució fàrmacs citostàtics,PUR,35(+/-5)cm llarg,vàlvula bidireccional fins 3,1bars,connexió LL filtre hidròfob,clamp, antireflux.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compatible a/bomba Infusomat Space o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039713	Eq inf EV bomba volum,PUR opac,sist tancat p/citos,punxó,cambra gota+presa aire+filtre 15µm,rodet,clamp,connexió LL,tub 230(+/-1)cm llarg,4 vàlv antireflux fins 3,1bars,1 vàlv bidireccional.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compat Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039714	Eq inf EV bomba volum,PUR opac,sist tancat p/citos,punxó,cambra gota+presa aire+filtre 15µm,rodet,clamp,connexió LL,tub 230(+/-1)cm llarg,2 vàlv antireflux fins 3,1bars,1 vàlv bidireccional.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compat Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30039715	Línia prolongadora administració/preparació i reconstituïció cistostàtics, PUR opac,35(+/-5)cm llarg,vàlvula resistent fins 3,1bars,connexió Luer Lock a/filtre hidròfob, clamp de tancament..Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compat Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30040503	Eq inf EV bomba volum,sistema tancat,PVC translúcid,230(+/-10)cm llarg,p/citos,punxó,cambra gota+filtre 15µm,5 vàlvules seg(4 unidireccional i 1 bidireccional,conn LL audible+filtre hidròfob,clamp.Est,s/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compat Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30040504	Línia Prolongadora per a fàrmacs cistostàtics, PVC, 35(+/-5)cm llarg,punxó, vàlvula bidireccional de seguretat, filtre en línia de 0,2 µm, connexió LL audible amb filtre hidròfob,clamp tancament.Est,s/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compat Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30041375	Eq EV bomba, PVC, 300(+/-10)cm,punxó, membrana seguretat evitar despurgat eq, cambra degoteig segur+presa aire+filtre15µ, punt entrada s/agulla, regulador rodet, pinça,conn L-L,tap antidegoteig.Est,s/làtex/DEHP,env ind,1ús.Compat Infosumat Space o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30043603	Línia transparent bomba xeringa multicanal. Connexió simultània 2 flascons/bosses. 2 línies conn L-L femella, vàlvules antireflux, 1 línia 50(+/-5)cm amb connexió contenidor final L-L mascle,s/làtex/DEHP,estèril,envind,1ús. Compatible bomba Medimix o eq	Lot Obligatori
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30043605	Eq línia+xeringa bomba multicanal. 1 línia PUR transparent 25(+/-5)cm, punxó, cambra degoteig, filtre 15µ, presa aire amb filtre antibacterià amb connexió "T" Luer Lock M/F i 1 xeringa 50mL. S/làtex/DEHP, est,env ind,un ús.Compatible bomba Medimix o eq.	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
7	Equips i línies prolongadores per a administració de cistostàtics, fàrmacs i/o hemoderivats compatible amb bomba d'infusió volumètrica	30043607	Equip línia+xeringa bomba multicanal. 1 línia PUR transparent, 25(+/-5)cm amb punxó unida a 1 connexió "T" Luer Lock mascle/femella i 1 xeringade 50 mL. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible bomba Medimix o eq.	Lot Obligatori
8	Equips i línies d'infusió endovenós per a NPT	30008468	Línia transferir líquids microvolum, de PVC i silicona, transparent, transferència de medicaments amb volum encebament inferior a 10 mL, entrada i sortida amb connexió Luer Lock mascle, s/làtex, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible Repeater Pump o eq	Lot No Obligatori
8	Equips i línies d'infusió endovenós per a NPT	30009685	Línia NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó+filtre antibacterià, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, doble punt additivació, connexió Luer Lock femella, 210(+/-10)cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Equips i línies d'infusió endovenós per a NPT	30030533	Eq NPT domiciliària per a bomba, PVC, anticolzament, Ø1x2,2mm i 27(+/-3)cm llarg, punxó, guia, sensor pressió, clamp, filtre pla 1,2µ i membrana aire 0,22µ, vàlvula antireflux amb conn L-L mascle, s/làtex/DEHP, est, idv, 1ús. Compatible Mini Rythmic PN o eq	Lot No Obligatori
9	Equips i línies per a barrejador de nutrició parenteral	30008465	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, alt volum, PVC transparent, amb punxó amb purga d'aire per utilitzar amb ampolles sense purga d'aire, connector amb entrada a pressió. Est, s/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot Obligatori
9	Equips i línies per a barrejador de nutrició parenteral	30028047	Vàlvula selectora primària per a nutrició parenteral, transparent, amb 24 fonts d'entrada, un connector de sortida de gran diàmetre per a l'ompliment de bosses. Est, s/làtex/DEHP, envàs individual, 1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot Obligatori
9	Equips i línies per a barrejador de nutrició parenteral	30028048	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, PVC transparent, punxó sense purga d'aire per utilitzar amb bosses o ampolles amb purga d'aire, connector d'entrada a pressió. Est, s/làtex/DEHP, envàs individual, 1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot Obligatori
9	Equips i línies per a barrejador de nutrició parenteral	30028050	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de microvolum, PVC transparent, a punxó amb purga d'aire per utilitzar amb vials de mida petita, connector amb entrada a pressió. Est, s/làtex/DEHP, envàs individual, 1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot Obligatori
9	Equips i línies per a barrejador de nutrició parenteral	30028051	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de clorur de polivinil (PVC) transparent, amb connexió Luer Lock femella (utilitzar per a xeringues), connector d'entrada a pressió. Est, s/làtex/DEHP, env ind, 1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
10	Sistema de preparació automatitzada de solucions intravenoses estèrils	30040877	Bossa infusió 1000 mL, amb Luer mascle, un port d'espiga i un port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	Lot Obligatori
10	Sistema de preparació automatitzada de solucions intravenoses estèrils	30040878	Bossa infusió 100 mL, amb Luer mascle, 1 port de punta i 1 port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	Lot Obligatori
10	Sistema de preparació automatitzada de solucions intravenoses estèrils	30040879	Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	Lot Obligatori
10	Sistema de preparació automatitzada de solucions intravenoses estèrils	30040880	Vial d'injecció de 100 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	Lot Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30001691	Bossa NPT pediatria EVA 250mL. Connector compliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració). Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30001692	Bossa NPT ped,EVA multicapa fotoprot,baixa permeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,500mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L femella+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additivació+tap,conn sortida a/membrana.S/làtx/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30001693	Bossa sol parenteral,PVC,1000mL,dos ports: un d'ompliment amb filtre de 0,2 µ i l'altre d'addició per a connectar l'equip d'infusió o medicació, amb etiqueta indicativa, estèril, envàs individual. Compatible amb dosificadora GRI-FILL 3.0 o equivalent.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30001694	Bossa NPT, EVA, 3000mL. Connector compliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30001706	Bossa NPT,EVA multicapa,3500mL escala,nansa ergo,3 lin entrada a/punxó+pressa aire+filtre bact+clamps,72(+/-5)cm+cambra+filtre partícules 270(+/-20)µ,LL F tub+LL M bossa,clamp segur via ompli,punt additiv+tap,sortida membrana.S/làtx/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30002606	Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE), opaca, mida de 550 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, amb filtre per a radiació UV i transmitància UV <10%, tancada, amb forat, d'un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30004838	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O, 2000mL,escala,nansa,3 línies d'entrada de 65 (+/-7) cm+filtre, clamps, punxó+filtre aire,connexió Luer femella, punt d'addició amb tap de seguretat.S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30004862	Bossa NPT ped,EVA multicapa fotoprot,baixa permeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,250mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L femella+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additivació+tap,conn sortida a/membrana.S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30004865	Bossa NPT ped,EVA multicapa fotoprot,baixa permeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,500mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L mascle+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additivació+tap,conn sortida a/membrana.S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30007672	Bossa NPT ped,EVA multicapa fotoprot,baixa permeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,150mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L femella+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additivació+tap,conn sortida a/membrana.S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008403	Bossa NPT,EVA multicapa col·lapsab,flex, transp,fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vitA/C,3000mL escala,nansa ergonòmica,LL M a bossa+tap i clamp segur segellar via omplir,punt additivació+tap,sortida membrana,S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008703	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008705	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles (protecció UV), de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30008850	Bossa fotoprotectora PE xeringa, tractada pintura metal·litzada alumini d'alta protecció UV, capa interior PES, transmitància òptica molt propera al "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) mm x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30009922	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10), oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30009923	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca, de color, amb filtre per a radiació UV, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30010137	Bossa fotoprotectora oberta per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca, de color, amb filtre per a radiació UV, mida de 460 (+/-10) mm x 295 (+/-10) mm, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30010138	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,3500mL,nansa,3 línies 72(+/-5)cm+presa aire,filtr bact 3µ,clamps,conn LLM,clamp segur p/segell via omplir,punt additiv+tap,conn sortid a/membran.S/làtx/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30011742	Bossa NPT, EVA, 125mL. Connector ompliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtx/DEHP,estèril,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30020182	Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), codificació de color, amb filtre per a radiació UV i transmissió UV <10%, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30029547	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O i reduc% degradació vitA/C,flexible,250mL escala,nansa,LL F gran+tap+clamp segur p/segellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/làtx/DEHP,est/env ind,1ús.Compat maquina omplir	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30029548	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O i reduc% degradació vitA/C,flexible,500mL escala,nansa,LL F gran+tap+clamp segur p/segellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/làtx/DEHP,est/env ind,1ús.Compat maquina omplir	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30029657	Bossa NPT pediatria, EVA, 500mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment i administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtx/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30029658	Bossa NPT, EVA, 2000mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtx7DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30029659	Bossa NPT pediatria, EVA, 1000 mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment, administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30030103	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,1000mL,nansa,3 línies 72(+/-5)cm+presa aire,filtr bact 3µ,clamps,conn LLM,clamp segur p/segell via omplir,punt additiv+tap,conn sortid a/membran.S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30030104	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,2000mL,nansa,3 línies 72(+/-5)cm+presa aire,filtr bact 3µ,clamps,conn LLM,clamp segur p/segell via omplir,punt additiv+tap,conn sortid a/membran.S/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30030883	Bossa NPT, EVA multicapa, 2000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30030884	Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30030975	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reduc% degradació vitA/C,flexible,1000mL escala,nansa,LL F gran+tap+clamp segur p/segellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/làt/DEHP,est/env ind,1ús.Compat maquina omplir	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30030976	Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reduc% degradació vitA/C,flexible,2000mL escala,nansa,LL F gran+tap+clamp segur p/segellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/làt/DEHP,est/env ind,1ús.Compat maquina omplir	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30031133	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30031660	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, de color, transmitància 200-600nm <10%, mida de 175 (+/-10) mm x 350 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30033432	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica propera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent, estèril, env ind,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30033827	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, transmissió 200-600nm <10%, mida de 120 (+/-10) x 230 (+/-10) mm, vials 100 mL, orifici per a penjar pal sèrum i sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu,1ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30035763	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada pintura metal·litzada alumini protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica propera "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent, estèril, envàs individual, un sol ús	Lot No Obligatori
11	Bossa per a nutrició parenteral, solucions parenterals i accessoris	30040255	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 1000mL escala, part sup nansa i part inf connexió L-L femella petita+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1sol ús. Compatible Exactamix o eq	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001314	Eq EV gravetat, PVC 150 (+/-10) cm, punxó s/presa d'aire i s/filtre+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús.	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001315	Eq EV gravetat, PVC opac, 150 (+/-10) cm, punxó presa aire+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001316	Eq EV gravetat, PVC, 45 (+/-5) cm, punxó presa aire+tap+filtre, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet petit, connexió Luer+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30001318	Eq inf EV gravetat,150(+/-5)cm de llarg, PVC transparent, microgoter 150(+/-10)mL, 60 microgotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15 µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador flux per rodet, connexió L-L, s/làtex/ftalats,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30003211	Eq EV, PVC transparent, 200 (+/-10) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flux per rodet, conn L-L mascle, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30028654	Equip infusió EV gravetat PVC transparent, 175 (+/-10) cm, punxó+presa aire, 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, "Y" amb bioconnector bidirrecional, regulador rodet 5-250 mL/h, connexió L-L giratòria+filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30034889	Eq infusió EV de PVC transparent, 210 (+/-10) cm, punxó a/presa aire, cambra amb degoteig 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, clamp, regulador 5-250 mL/h, "Y" amb bioconnector bidirrecional, L-L mascle giratori, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	Lot No Obligatori
12	Equips d'infusió endovenòs per gravetat	30052301	Eq infusió endovenosa gravetat,PVC transparent, 175(+/-10)cm long,punxópresa aire, degoteig 20 gotes/mL,filtrre seguretat 15µ,tap,regulador deflux de rodet de 5 a 250 mL/h, connexió LL mascle amb tap estanc, s/làtex, s/DEHP,estèril,envàs individual,1ús	Lot No Obligatori
13	Equips d'infusió endovenòs per gravetat_2	30008205	Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup rígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/-0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
14	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal Luer Lock femella amb protecció, connexió distal Luer Lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, env ind, un sol ús	Lot No Obligatori
14	Reguladors de flux	30029656	Vàlvula anti-sifó per evitar la caiguda de fluid lliure, de clorur de polivinil (PVC), unidireccional, volum de purga 0,2 ml, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
14	Reguladors de flux	30030324	Dispositiu regulació flux infusió 0-250 mL/h doble escala permet treballar en funció l'espessor (10% o 40%), línia prolongadora PVC 3mmØ i 54(+/-4)cm, volum purga 3,8(+/-0,2)mL, connexió "Y",L-L giratori, posició ON/OFF,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	Lot No Obligatori
14	Reguladors de flux	30053865	Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 3,5 (+/-0,5)mL, consta de: cilindre, torniquet, xeringues,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cintaadhesiva. Estèril, s/làtex, 1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
15	Línies per a barrejador semiautomatitzat de preparació de productes estèrils	30030492	Línia 2vies p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir 2 solucions,100(+/-5)cm,a/6extrems:2 en punxó i LL a tub,1 con Luer Lock i a bomba,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer-60mL.Est,s/làtx/DEHP,1ús.Compatibl a/dosificad GRI-FILL 3.0 o eq	Lot Obligatori
15	Línies per a barrejador semiautomatitzat de preparació de productes estèrils	30034195	Línia 1via p/omplir bossa sol parenteral a/dosificadora a partir d'1 solució,100(+/-5)cm long,a/5extrems:1 en punxó i LL a tub i a solució dosifiquem,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer 50-60mL.Est,s/làtx/DEHP,1ús.Compatib a/dosificad GRI-FILL 3.0 o eq	Lot Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30005131	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 7 mL/h, volum d'ompliment màxim de 300 (+/-10) mL i nomina 272 mL, durada teràpia 39 hores, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex/DEHP, estèril,envàs individual,un sol ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30006506	Eq lastomèric amb flux variable de 2 mL/hora, reservori de 120 (+/-10) mL, durada del tractament 60h, per a l'administració d'analgèsia, amb filtre, clamp, connexió Luer Lock mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30006508	Equip d'infusió elastomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum ompliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30006916	Eq infusió elastomèric amb+H93:R93 flux variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 mL/hora, graduat, volum reservori de 250 mL, durada del tractament segons el flux programat, admanalgèsia, línia amb filtre, clamp, connexió Luer Lock, s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30007049	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 5, 7, 12 mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 20 a 48h, codi color, administració analgèsia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30007492	Eq elastomèric transparent, flux 1mL/h, volum ompliment 110(+/-10)mL, filtre antipartícules+doble de venteig hidròfug, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 105(+/-5)cm, contenidor,reservori,clamp línia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind,un sol ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30007999	Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 5 mL/h, volum d'ompliment 120 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30008000	Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 10 mL/h, graduat, volum d'ompliment 240 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30009600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 1,5 mL/h,volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 252mL,durada teràpia 7 dies, codi de color, administració analgèsia, quelació i quimioteràpia,sense làtex/DEHP,estèril,env ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30011412	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 2,5ml/h,volum d'ompliment màxim de 130 (+/-5) mL i nominal 120mL,durada de la teràpia de 48hores, codi de color,administració quimioteràpia, sense làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30011606	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 2, 4, 6 mL/h, volum ompliment màxim 300(10+/-)mL i nominal 240mL, durada teràpia 40h a 5 dies, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30011846	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, amb velocitat flux 5 mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 120 mL, durada teràpia 24 hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30012040	Equip d'infusió elastomèric fotoprotector-transparent per a medicació amb velocitat de flux de 100 mL/h, volum d'ompliment màxim de 105 (+/-5), contenidor, reservori, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30012600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30013205	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux de 1, 2, 3mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 96 mL,durada teràpia 32 a 96h, codi color, administració analgèsia,quimioteràpia, sense làtex/DEHP,estèril,env ind,un sol ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30029603	Equip per a bomba infusió implantable per a l'administració intratecal de fàrmacs. Estèril. Compatible amb bomba TRUCUMED o equivalent.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30031180	Eq infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat flux 130 mL/h, volum de 65 mL amb 30 minuts, volum màxim de 80(+/-5)mL,contenidor, reservori transparent,vàlvula ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30031181	Equip d'infusió elastomèric, velocitat de flux de 200mL/h, volum de 100 mL amb 30 minuts, volum màxim de 100 mL, per administrar medicació, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30031191	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat de flux de 21 mL/h, volum màxim de 300 (+/-25) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30034054	Eq infusió elastomèric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est,ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30041443	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat de flux de 1,4 mL/h, volum màxim de 130 (+/-10) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30041444	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat de flux de 1 mL/h, volum 65 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30041445	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació 24h hores, graduat, velocitat de flux 2,7 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre, s/làtex/DEHP,estèril,1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30043022	Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus de 0,5 mL, clamp, filtre partícules, connexió Luer Lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex/DEHP,estèril,envàs ind, un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30047366	Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus, clamp, filtre partícules, connexió Luer Lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex, sense DEHP,estèril,envàs ind, un sol ús.	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elastomèrics	30052369	Eq elastomèric transparent 2mL/h, 96 mL (48hores), volum màxim 130 (+/-10)mL, filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30052370	Eq elasmòric transparent 5mL/h, 240 mL (48hores), volum màxim 300 (+/-10)ml, filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori, sense làtex/DEHP, estèril, env ind, 1ús	Lot No Obligatori
16	Sistemes d'infusió elasmòrics	30052371	Eq elasmòric transparent 10mL/h, 240 mL (24hores), volum màxim 300 (+/-10)ml, filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori, sense làtex/DEHP, estèril, env ind, 1ús	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30002619	Eq irrigació doble, PVC, 2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect "Y" i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra, línia 5x7,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8,3mm+17 (+/-3)cm. Luer Lock. S/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30002686	Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors rodets i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30003371	Eq EV 2 vies "Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de clamp, línia de diàmetre 6,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTU, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30006533	Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació peristàltica, de 4,2 (+/-0,2) metres (m) de longitud, amb punxó, tram de silicona. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb Chiripro 980 o equivalent.	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30017426	Sist irrigació continua recàrrega ràpida, injecció controlada contrast/altres solucions x coledoscòpia endoscòpica, vàlvula unidireccional omplir xeringa estirant l'èmbol, tub silicona 2,5 (+/-0,1)m punxó i regulador, xeringa de policarbonat. Estèril.	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30018370	Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra irrigació, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30030092	Sistema de tubs amb circuit tancat per a la refrigeració de la peça de mà mitjançant la circulació de líquid, de silicona, sense làtex, d'un sol ús. Compatible amb motor d'oida d'alta velocitat Visao o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30035711	Equip irrigació URS,cambra flexible Ø25mmx12cm llarg a/bombeig manual p/augmentar pressió,2connex bossa sèrum fisiològic a/clamps tancament,extrem distal Luer Lock p/adaptar ureteroscopi i regulador flux cremallera, 260 (+/-10) cm,s/làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
17	Sistemes d'infusió per a irrigació	30048853	Eq inf irrigació 2 vies "Y", s/cambra d'aire tub a/2 punxons de Ø5x6,8mm (int-ext) i 20(+/-5)cm long a/clamps, línia Ø5x6,8 mm (int-ext) i 170(+/-10)cm long a/regulador flux i extrem inferior a/tub 10(+/-2)cm, Ø5x9mm(int-ext),s/làtex/DEHP,est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001322	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, clorur polivinil (PVC) transparent, 60(+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1mm x 2,5mm de diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, 1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001323	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 90 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30009100	Línia prolongadora 2 (+/-1) bars,PVC, resistent a lípids, de 30(+/-2)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle giratori i Luer Lock femella, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001324	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC, transparent, de 35 (+/-5) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001325	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001326	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001327	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 180 (+/-4) cm, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001417	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30001418	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 90(+/-4)cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002117	Línia prolongadora 1(+/-0,1)bar pressió, PVC transparent, 18(+/-2) cm, 3 mm x 4 (+/-0,15) mm de diàmetre, amb derivació lateral en "Y", extrems connexions L-L femella-femella i L-L mascle (part inferior), s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002610	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-masclle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002611	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002615	Línia prolongadora d'1 (+/-0,1)bar, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle i Luer Lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30002616	Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, opaca, resistent lípids, PVC, 150 (+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1 x 2,5mm diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, est, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30004213	Línia prolongadora fins a 20 (+/-1) bars de pressió, per a injector automàtic agents radioopacs intravenosos, de clorur de polivinil (PVC), flex ible, transparent, de 150 (+/-10) cm de longitud. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30004474	Línia prolongadora 5 (+/-1) bars de pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm diàmetre, extrems amb connexions amb connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella i clau 3 vies punt injecció, s/làtx/DEHP, est,env ind, 1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30004475	Línia prolongadora 5 (+/-1) bars,PVC transparent, resistent lípids, 17(+/-3)cm, 2x4,15 (+/-0,15)mm de diàmetre, extrems amb connexions amb connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella i clau de 3 vies, sense làtex, s/DEHP, est, env ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005204	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC transparent,resistent lípids, 150(+/-10)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-mascl,taps, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005206	Línia prolongadora de 20 (+/-1) bars pressió, PVC transparent, resistent a lípids, de 100 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems L-L mascle giratori i L-L femella,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005209	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 25(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre extern consta de: clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1úa	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005229	Línia prolongadora 20 (+/-1) bars de pressió, PVC transparent, resistent a lípids, 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascl,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005230	Línia prolongadora 20 (+/-1) bars pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle giratòria- filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30005231	Línia prolongadora d'infusió de 2(+/-1)bars de pressió, PVC transparent, resistent lípids, 100(+/-4)cm de longitud, de diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascl,taps,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30006681	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 10(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre extern consta de: clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30008947	Línia prolongadora d'1 (+/-0,1)bar de pressió, de 180 (+/-2) cm, de diàmetre interior 3mm i exterior 4,1 (+/-0,15) mm, amb connexió Luer Lock mascle-femella amb tap protector, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30010109	Línia prolongadora d'infusió endovenosa per perfusió de fluids,PVC transparent,2 punts d'injecció agulla,Øextern 4,1mm,Øintern 3mm,longitud 100cm+/-10cm (trams 15+70+15cm),2 clamps,connexió LL femella i LL mascle rotatori,lliure làtex i DEHP,estèril,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30010233	Línia prolongadora baixa absorció, pressió 10(+/-1)bars, PVC, flexible, transparent, capa interna PE, 200(+/-10)cm longitud, diàmetre intern 2,5x4(+/-0,1)mm diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-mascl giratori.S/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30030095	Línia prolongadora, 20+/-1bars de pressió, PVC flexible, transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella. Sense làtex, sense DEHP,est,ind,1ús.	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30052284	Línia prolongadora fins 20(+/-1)bars de pressió, PVC, 30(+/-2)cm de longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 mm de diàmetre extern, punt d'injecció "Y", clamp, connexió Luer Lock mascle, lliure làtex, lliure ftalats,estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
18	Línies de baixa, mitja i alta pressió	30052977	Línia prolongadora fins 21(+/-1)bars pressió, PVC, 15(+/-2)cm llarg, diàmetre intern 3 mm x 4,1 mm de diàmetre extern, punt injecció "Y" amb vàlvula de seguretat, clamp, connexió LL mascle amb tap de purga, lliure làtex/ftalats, estèril, envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30007567	Línia prolongadora d'infusió endovenosa per a bomba de xeringa, PVC/PE), de baixa absorció, calibre de 3 mm, de 200 (+/-10) cm de longitud, purga de 1,7mL, connexió Luer Lock (proximal i distal), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús	Lot No Obligatori
19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30009097	Línia prolongadora d'infusió d'alta pressió 40 bars (+/-1), per a bomba de xeringa, de polietilè (PE), de 200 (+/-10) cm de longitud, connexions a cada extrem Luer Lock mascle i Luer Lock femella, sense PVC,s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús	Lot No Obligatori
19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30038040	Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió proximal Luer Lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP,estèril,ind, 1ús. Compatible Mòdul DPS o eq	Lot No Obligatori
19	Línies perllongadores per a bombes de xeringa	30040295	Línia prolongadora bomba xeringa, pediatria, transparent, pressió màxima de 4 bars, de polietilè (PE), volum de purga de 1,18 mL, de 150cm de longitud, connexions a cada extrem L-L mascle i L-L femella, s/PVC, làtex,est,ind,1ús. Compatible Perfusor o eq	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
19	Línies perllongadores per a bombas de xeringa	30043604	Línia prolongadora transparent baixa absorció lípids per a infusió EV amb bomba xeringa, PUR, 75(+/-5)cm, connexió Luer Lock M/F, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb bomba volumètrica multicanal Medimix o eq.	Lot No Obligatori
19	Línies perllongadores per a bombas de xeringa	30057648	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, transparent, pressió màxima de 4 bars,PVC, 150(+/-10)cm, connexió a cada extrem Luer Lock mascle i femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	Lot No Obligatori
19	Línies perllongadores per a bombas de xeringa	30057649	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, fotoprotectora, pressió màxima de 4 bars,de PVC, de 200(+/-10)cm, connexió Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	Lot No Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30012496	Dispositiu transferència fluids/citostàtics, consta: connector a/vàlvula femella seguretat p/ús s/agulla i segellat bidirec antiaerosol, doble filtre aire hidròfug 0,2µm, punxó, purga 0,11(+/-0,01)mL. Est, s/làt/DEHP, 1ús, env ind. Compatibl sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028260	Dispositiu adm fluids/citostàtics amb bossa infusió, consta:punxó a/filtre aire,connector amb vàlvula femella seguretat (sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional, purga 0,06(+/-0,01)mL.Est, s/làt/DEHP, 1ús, env ind. Compatibl sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028261	Adaptador universal a/bomba infusió i p/gravetat, PVC, tub Ø4,8x6,8mm p/5(+/-1)cm, vàlv a/connexió LL mascle segur(ús s/agulla, giratori, alt flux, no desconnectable a/sist bloqueig), purga 1(+/-0,02)mL.Est, s/làt/DEHP, 1ús, env ind. Compatibl sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028306	Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa, PC, vàlvula amb connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable amb sistema bloqueig), purga 0,1(+/-0,01)mL.Est, s/làt/DEHP, 1ús, env ind. Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30028715	Línia prolongadora infusió fluids EV, PUR, PE, PP, fotoprotectora de color ambre, de 22(+/-2)cm longitud, filtre de 0,2 µ, extrems amb connexions Luer Lock M-F. Estèril, lliure làtex, s/ftalats, 1ús, envàs individual. Compatible sisT ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenòs	30030719	Eq-extensió prep/adm citos, opac, consta: punxó+vàlv, port "Y" a/connector segur s/ag, clamp pinça, filtre 0,2µ, connector proximal segur s/ag, tub Ø2,9(+/-0,1)x4,1(+/-0,15)mm i 36(+/-5)cm, purga 4.6(+/-0,5)mL.Est, s/làt/DEHP, 1ús, env ind. Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30034662	Punxó/adaptador vial/flascó 20 i 28mm,sistema tancat transferència,sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs peril·losos.Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/- 0,1)mL,long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre 0.2 µm amb globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30041403	Dispositiu adm fluids i citostàtics amb bossa infusió, consta:punxó a/filtre aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,34(+/- 0,06)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30048854	Punxó/adaptador vial/flascó 20mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs peril·losos. Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/- 0,1)mL i long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre a/globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compatibl sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30048855	Punxó/adaptador vial/flascó 13(+/-1)mm,sist tancat transferència,sist s/agulla sang,fàrmacs,fàrmacs perill, filtre hidròfug 0,2µ,cos punxó 3(+/-)0,1cm a/braç bloqueig i protector,purga 0,27(+/-)0,02mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051283	Dispositiu per a transferència/connector doble sense agulla, de policarbonat, per a xeringa-xeringa amb Luer lock femella / femella bidireccional, volum de purgat de 0,15 (+/- 0,2)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051304	Punxó/adapt vial/flascó 20mm, sist tancat per a transferència, sistema sense agulla per a fàrmacs peril·losos/químio. Compost per: adaptador punxó, filtre 0,2 µm a/globus volum purga 0,18(+/- 0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051305	Punxó/adaptador bossa a/injector, sist tancat p/transferència, sist s/agulla fàrmacs peril·losos/quimioteràpia. Compost per: connector Luer lockmascle, tub injector 8(+/-1)cm volum purga 1,8(+/-0,1)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051306	Dispositiu adm fluids i citostàtics a/bossa infusió,punxó amb filtre d'aire 1,2µm, connector a/vàlvula femella seguretat(sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,38(+/- 0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051307	Connector per a l'administració de fluids i citostàtics amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segella t bidireccional, volum de purga de 0,104(+/- 0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051308	Connector xeringa o tub endovenós per a l'administració de fluids i citostàtics amb vàlvula mascle de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purgat 0,35 (+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051309	Punxó/adaptador per a vial/flascó de 28 mm airejat, sistema sense agulla per a fàrmacs peril·losos/quimioteràpia. Compost per: adaptador per a vial/flascó, punxó, volum de purga de 0,18 (+/-0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30051398	Punxó/adaptador per a vial/flascó 13mm, sistema tancat per a transfe rència, sistema sense agulla per a fàrmacs/fàrmacs peril·losos . Compost per: adaptador per a vial/flascó, punxó i filtre amb globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30052229	Connector/adaptador sense agulla volum, compatible amb sonda vesical. Lliure de làtex, ftalats, estèril, d'un sol ús. Estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb sistema ChemoClave o equivalent.	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30052683	15 Punxons/adapt vial/flascó 20 i 28mm,sistema tancat transferència,sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs peril·losos.Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/-0,1)mL,long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre 0.2µm a/globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30052827	Punxó/adaptador vial/flascó 28mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs peril·losos. Adaptador vial/flascó,purga 0,14(+/-0,1)mL i long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre amb globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30052828	Punxó/adaptador vial/flascó de 13mm, sistema tancat transferència,sistema sense agulla, connector s/agulla, filtre d'aire hidròfug, punxó amb braç de bloqueig i protector,volum purgat 0,3(+/-0,02)mL.Est,s/làtex/DEHP,1ús,env ind.Compatible ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30052829	Equip de seguretat secundari compatible amb bomba d'infusió Plum 360. Compost per: Cambra de degoteig amb sistema sense agulla, tub de 97 (+/-3)cm, ganxó, i connexió tancada.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30052831	15 Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa,PC,vàlvula a/connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, alt flux, no desconnectable amb sistema bloqueig),purga 0,1(+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30053440	Equip 15 punxons/adaptadors bossa/flascó, sistema tancat p/transferència,sistema s/agulla p/fàrmacs/fàrmacs perillosos.Compost per:punxó i connector.Longitud punxó 8,4(+/-0,2)cm,purga 0,35(+/-1)mL.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	Lot Obligatori
20	Sistema per a transferència de fàrmacs citostàtics: Punxó, connector/adaptador de vial/flascó i equip endovenós	30054086	Punxó/adaptador vial/flascó de 20 i 28mm, sist tancat sense agulla fàrmacs perillosos/quimioteràpia. Adaptador vial/flascó s/bloqueig, punxó, purga 0,18(+/-0,02)mL, filtre 0,2µm a/globus.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics_1	30040078	Adaptador vial 13mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05(+/-0,01)mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics_1	30040080	Adaptador L-L mascle,transferir/adm citostàtics/medicació,volum residual 0,09(+/-0,01)mL,converteix a femella L-L en una entrada segellada per la membrana per injecció segura medicaments amb xeringa,s/làtex/DEHP/BPA, est,1ús. Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics_1	30042369	Adaptador vial 20mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments,filtrre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05(+/-0,01)mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics_1	30042370	Adaptador vial 28mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ,volum purga 0,05(+/-0,01)mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics_1	30043361	Xeringa estanca 1mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril precarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics_1	30043362	Xeringa estanca 3mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril precarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30043363	Xeringa estanca 5mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril precarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30043364	Xeringa estanca 10mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril precarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30043366	Xeringa estanca 35mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril precarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30043367	Adaptador Luer Lock femella, per a transferir i adm citostàtics/medicació. Converteix un Luer Lock estàndard en una sistema tancat per a la injecció segura de medicaments fent servir la xeringa, s/làtex,DEHP,BPA,estèril,1ús. Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
21	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_1	30043368	Línia/perllongador 48(+/-2)cm long.Connexió segura i seca amb membrana hidrofòbica. Consta:punxó, cambra degoteig (20 gotes/mL),connector Luer Lock mascle,pinça/clamp de la línia i tap protector.S/làtex/DEHP/BPA,est,env ind,1ús.Compatible Equashield o eq	Lot Obligatori
22	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_2	30041677	Adaptador xeringa, preparació/adm tancada citostàtics/medicaments, apte tots volums xeringues i connexió L-L, agulla 16G alumini, volum residual 0 mL, amb tap, s/làtex, s/PVC, est,ind,1ús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	Lot Obligatori
22	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_2	30041678	Adaptador vial 13 i 20 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex/DEHP/PVC,est,ind,1ús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	Lot Obligatori
22	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_2	30041679	Adaptador vial 28 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,1ús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	Lot Obligatori
22	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_2	30041680	Adaptador Luer Lock, per a la preparació i administració tancada de citostàtics/medicaments, amb clic auditiu, per connexió correcta, s/làtex, s/PVC, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
22	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics_2	30042791	Adaptador-connector tancat s.vesical,adm citostàtics/medicaments,extrem con adaptador sonda vesical 4,1mm,extrem línia/extensió sist tancat transferència 3(+/-0,1)cm longitud a/connexió adaptador xeringa.S/làt/DEHP/est,1ús.Compatible CHEMFORT ONB o eq	Lot Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30008734	Adaptador universal vials transferència-preparació de fluids com fàrmacs/citostàtics/antibòtics, filtre venteig hidròfob de 0,2 µm i vàlvula seguretat-bioconnector, volum de purgat de 0,10 (+/-0,01)mL, longitud 6,4 (+/-0,1)cm.Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30018112	Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió Luer a xeringa, terminal amb connexió al protector del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, ImmuCyst BCG o eq	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30018445	Punxó plàstic vàlvula bidireccional per a reconstituïció fàrmacs (citostàtics), filtre de 0,2µm d'aire antibacterià i retenció d'aerosols. Filtre 5µm per a retenció de partícules.Base gran. Connexió a xeringa.Tap hermètic.Sense làtex,sense ftalats,est,1ús	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30018776	Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: Luer tancat amb vàlvula de seguretat-bioconnector, volum de purga de 0,12 (+/-0,1)mL. Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30018779	Prolongadora baixa absorció citotòxics PUR, 3mm x 55 (+/-5) cm, punxó+filtre 0,22 µ, port "Y"invertida+vàlvula segur, L-L giratori+filtre+ vàlv unidireccional, vàlvula antirreflux, 2 clamps abans/després filtre,purga 6 (+/-1)mL, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30018780	Prolongadora baixa absorció,lípids,gravetat,opaca fàrmac fotosen/citos,PVC,30 (+/-2) cm,punxó a/filtre venteig hidròfob 0,2µm, port "Y" invertida a/bioconnector,LL a/tap hidròfob,vàlv unidireccional,pinça,purga 1,7(+/-0,2)mL. Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30032172	Adaptador-dispositiu a accés de vials amb vàlvula de seguretat-bioconnector, reconstituïció i preparació de citostàtics, filtre venteig hidròfob de 0,2 µm, de 13 mm de coll de vial, volum purga 0,15 mL, longitud 6 (+/-0,1)cm. Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30032173	Adaptador-dispositiu a accés de vials amb vàlvula de seguretat-bioconnector, reconstituïció i preparació de citostàtics, filtre venteig hidròfob de 0,2 µm, de 28 mm de coll de vial, volum purga de 0,15 mL, longitud 7 (+/-0,1)cm. Est,s/làt/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30032174	Adaptador-dispositiu a accés de vials amb vàlvula de seguretat-bioconnector, reconstituïció i preparació de cistostàtics, filtre venteig hidròfob de 0,2 µm, de 20 mm de coll de vial, volum purga de 0,15 mL, longitud 6 (+/-0,1)cm. Est,s/làtx/DEHP,1ús,env ind	Lot No Obligatori
23	Altres sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30041739	Connector Luer Lock preparació/administració fluids/citostàtics, amb vàlvula seguretat, sistema circuit tancat, canal endoluminal, segell comprimible de silicona tipus Split Sèptum, bidireccional, sense agulles,pressió neutra,s/làtx/DEHP est,env ind,1ús	Lot No Obligatori
24	Sistemes per a transferència	30002618	Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
24	Sistemes per a transferència	30009686	Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió Luer, longitud de 10 (+/-1) cm, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
24	Sistemes per a transferència	30040184	Dispositiu-punxó transferència fluids/citostàtics,5 (+/-1) cm, punxó 2,5 (+/-0,5) cm,per a microvial,connector a/vàlvula femella seguretat ús s/agulla i segellat bidireccional antiaerosol,volum intern 0,16 (+/-0,05) mL. S/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30001319	Eq mesurar PVC, 2 tubs 80+/-5cm i 150+/-10cm long , columna d'aigua amb 3 línies amb clau 3 vies, punxó presa aire-filtre,cambra degoteig, una "Y" per mesurar i altre connexió LL, 3 reguladors flux, sist segur anti-aire i 2 tubs.S/DEHP/làtex,est,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30001321	Equip per a la monitorització invasiva de la pressió hemodinàmica de forma contínua, amb flux constant de 3mL/h, consta de: línia de PVC, filtre de 10 µ, dispositiu-vàlvula i connexió Luer Lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP,estèril,env ind,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30001334	Eq monit altes pres, 3transd a/rentat flux 3mL/h,macrogoter 3línies no soldat transd 150(+/-10)cm,3 conn monitor imperm,3 claus 3P cal, 4 claus 3p,3 línies 180(+/-5) i 30(+/-2)cm(vermell),2x120(+/-10) i 30(+/-2)cm(groc i blau),suport,s/làtx/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30001536	Eq altes pressions doble,transductors adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogoter 2 línies no soldat transductor mesura PIC,conn impermeable,2 claus 3p,mostra+codi color,2x120(+/-10) i 30(+/-2)cm(groc i blau)+2claus 3p,suport,s/làtx/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30001537	Eq monit altes press,transductor adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogoter línia no soldat al transductor de 150(+/-10)cm, connector del cable del monitor impermeable, clau 3p calibració,clau 3p,línia 130(+/-5),suport,s/làtx/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30001538	Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm,conn cable monit imperm,clau 3P cal, 2 claus 3p color a/2 lín 180(+/-5)cm(blau) i 180(+/-10)+20(+/-2)cm(vermell),suport,s/làt/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30004443	Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió Ø1,14mm 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30004444	Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,1ús	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30018160	Equip per a monitorització de pressions de manera automàtica en pediatria, consta de: transductor amb flux de 30mL/h, línia de pressió de 28 (+/-5) cm, 2 claus de 3 passos, amb sistema de rentat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
25	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30026557	Eq monitorització PA, línia 120(+/-10)cm i línia extensió alta pressió 30(+/-5)cm + clau 3p, aixeta rentat amb flux manteniment 2 a 4 mL/h i flux de rentat 60 mL/h, s/làtex,estèril,envàs individual, 1ús.Compatible transductor reutilitzable LogiCal o eq	Lot No Obligatori
26	Sistemes varis per a monitoratge de pressió	30002578	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vies a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
26	Sistemes varis per a monitoratge de pressió	30002701	Flebomanòmetre / regleta amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç telescòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, sense làtex, envàs individual, reutilitzable.	Lot No Obligatori
26	Sistemes varis per a monitoratge de pressió	30007167	Equip per a mesurar la pressió intra-compartimental amb sistema de calibratge i connexió a xeringa. Pantalla digital en mmHg	Lot No Obligatori
26	Sistemes varis per a monitoratge de pressió	30031051	Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàvula automàtica, clau pas, tub infusió per a connexió salina+línia color, drap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari,muntatge suport sèrum,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús	Lot No Obligatori
27	Transductors	30002626	Transductor pressió monitorització altes pressions, consta de: sistema de rentat de flux continu 3mL/h a 300 mmHg, connector de cable a monitor impermeable a líquids, clau de 3 passos L-L mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, 1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
27	Transductors	30004137	Transductor monitoritzar TA i mesurar la línia de cardioplègia, amb vàlvula amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella mòbil, de policarbonat, mida amb cable de 35,5 (+/-3) cm, estèril, envàs ind, un sol ús. Tipus Meritrans o equivalent.	Lot No Obligatori
27	Transductors	30016920	Transductor de pressió de butoral de polivinil (PVB), sense equip de rentat, per a manometries anorectals i esofàgiques, per utilitzar amb bombes de perfusió pneumocapil·lars, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb polígraf Synmed i eq	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30006535	Transductor sonda h20 urodinàmica, dispositiu de rentat, vàlvula sobrepressió, sistema evacuator, clau de posta a "0", connexió L-L, connexió elèctrica, flux 3mL/h, rang -50 a +300 mmHg, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Solar i Nexam o eq	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30008382	Equip d'infusió per irrigar per a l'equip d'urodinàmica, de silicona transparent, de 3,7 (+/-0,1) metres (m) de longitud, consta de: un punxó, dues línies i connexió Luer Lock universal, estèril. Compatible amb l'equip d'urodinàmica Solar o equivalent.	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30014542	Equip d'infusió per l'equip urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 3 (+/-0,1) metres (m) de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip urodinàmica DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent.	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30017428	Vàlvula seguretat unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, lliure làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30017431	Eq infusió líquid bufeta urin, 3 línies unides 500(+/-10)mm PVC + 200(+/-10)mm silicona + 3000(+/-10)mm PVC, i llarg total 3,7 (+/-0,1)m, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làtex/DEHP, est, env ind, 1ús. Compatible Phoenix plus o eq	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30017550	Cúpula pressió per transductor urodinàmica, extrem superior connex L-L mascle integrada a clau 3 vies, extrem inferior L-L femella integrat clau 1 via compliment sèrum, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible transductor i eq Phoenix plus o eq	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30018741	Transductor pressió rentat eq urodinàmica, PVB. Sistema rentat 30 mL/h, sistema purgat ràpid, connec L-L (un per la bomba de perfusió aigua i altre pel polígraf), est, ind, 1ús. Compatible sist urodinàmica DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o eq	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30040656	Equip infusió irrigació, de polímer transparent, de 3 (+/-0,1)m de longitud, consta de: un punxó, una part de la línia per connectar al rodet de l'equip, connexió Luer Lock,s/làtex, estèril, envàs individual,1ús. Compatible eq urodinàmica Nexam o eq	Lot No Obligatori
28	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	30053796	Cúpula de pressió per al transductor urodinàmica de policarbonat (PC), membrana silicona, consta de: clau d'1 i 4 vies amb connector Luer Lock. estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb transductor MEMSCAP o equivalent.	Lot No Obligatori
29	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30004211	Equi complet d'autotransfusió,PVC,a/2 equips: recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia connex-buit,reservori a/filtre 40µ i un a/rentat circuit-màquina,campana 125 (+/-5)mL i bossa rebuig,estèril,individual p/equip,1ús.Comp màquina Electa o equi	Lot No Obligatori
29	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30043749	Equip obtenció/concentració plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta de: cilindre de separació, xeringues, agulla 18, 22 i 25G, flascó ACD-A de 45,7 (+/-2)cm, papallona amb agulla 8G,gases estèrils,cinta adhesiva,apòsit. Estèril,s/làtex,1ús	Lot No Obligatori
29	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30048613	Eq obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta: cilindre extracció 20 mL centrifugació i obtenció diferents fraccions sanguínies al mateix dispositiu, èmbol roscat, xeringues 1,2,5mL, connector,tap. S/làtex, est, 1ús	Lot No Obligatori
30	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 1	30003250	Eq recuper-reinfusió sang post-Q. Bossa PVC graduada 500 (+/-10) mL+filtre 200µm, port mostres+clap+tap port entrada i eq transfusió cambra degoteig+2 filtres 40/80µm i conn L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús.Compato Bellovac o eq	Lot Obligatori
30	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 1	30005358	Eq sang autòloga/drenatge buit,tròcar 14G+catèter CH14, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús.Compatible Bellovac o eq	Lot Obligatori
30	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 1	30011891	Eq sang autòloga/drenatge buit,trocar 10G+catèter CH10, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús.Compatible Bellovac o eq	Lot Obligatori
31	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 2	30002286	Bossa reinfusió autotransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm, PVC, connexió L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb equip de recuperació-reinfusió per a sistema CATS+ o equivalent	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
31	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 2	30012343	Eq sang autotransfusió CIR, PVC,reservori a/filtre 3L, línia i tub conn L-L+clamp, línies i cambra de rentat especial, bossa de rebuig 10L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i tub de doble llum,PVC,est,envàs ind,1ús. Compatible CATS+ o equivalent	Lot Obligatori
32	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 3	30029714	Eq complet autotransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia con-buit,reservori a/filtres i un a/rentat circuit-màquina,campana 125(+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L),estèril,individual,un ús.Comp a Xtra o eq	Lot Obligatori
32	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica 3	30030239	Equip recol·lector sang x eq autotransfusió, PVC, línia asp/anticoagulació, línia connexió buit, reservori rígid+filtre 40µ per a autotransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Xtra o eq	Lot Obligatori
33	autotransfusor Xtra	30040084	Bossa reinfusió autotransfusió 1 (+/-0,1) litre (L), PVC, connexió Luer Lock, set de rentat, 2 ports de sortida 1/4 pre-segellats (amb clamp lliscant), estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible equip recuperació-reinfusió sistema XTRA o eq	Lot Obligatori
33	autotransfusor Xtra	30042741	Eq complet autotransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia con-buit,reservori a/filtres i un a/rentat circuit-màquina,campana 225(+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L),estèril,individual,un ús.Comp a Xtra o eq	Lot Obligatori
33	autotransfusor Xtra	30043790	Línia aspiració amb anticoagulació integrada per a procediments d'autotransfusió, 3,5(+/-0,1)m longitud i línia de 4 (+/-0,1)m amb cambra de degoteig i punxó. Sense làtex, sense DEHP, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb XTRA o equivalent.	Lot Obligatori
34	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia	30013276	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 2,5 x 37,5 (+/-5) cm, agulla+introducció, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq	Lot Obligatori
34	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia	30014705	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 7,5 x 42,5 (+/-5) cm, agulla+introducció, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq	Lot Obligatori
34	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia	30014706	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 15 x 50 (+/-5) cm, agulla+introducció, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
35	Sistemes d'infusió per a contrast injector Ulrich	30008292	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, plàstic flexible, amb: 3 entrades líquids (1-sèrum/2-contrast), filtre, sensor pressió, L-L, tub p/ incorporar a rodets-injector contrast, durada 24h., no làtex, estèril. Com injector Ulrich o eq	Lot Obligatori
35	Sistemes d'infusió per a contrast injector Ulrich	30060144	Línia prolongadora contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, 16bar(230 psi), Ø intern 2,5mm x 250 (+/-10) cm de llarg, 2 vàlvules antiretorn, luer lock, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Comp injectors Ulrich o eq	Lot Obligatori
35	Sistemes d'infusió per a contrast injector Ulrich	30008294	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, Ø intern 2,5mm x 150 (+/-10) cm, amb: 2 vàlvules antiretorn, Luer Lock, apirògen, estèril, individual, un ús. Compatible injectors Ulrich o eq	Lot Obligatori
35	Sistemes d'infusió per a contrast injector Ulrich	30060581	Tubs a/3 punxons (1 de sèrum i 2 de contrast) amb tap protector, administració contrast TC/RM, plàstic flexible, transparent, 114(+/-5)cm llarg, sensor pressions, filtre partícules, connexions LL, est, s/làtex, 1ús. Compatible a/injectors Ulrich CT MOTION o eq	Lot Obligatori
36	Sistemes d'infusió per a contrast	30008306	Eq inj CO2 angiograf. Xerig 100mL/dosis 20mL+sist tancament ajustar dosis, clau gir 90° injecció/càrrega CO2, línia 100 (+/-10) cm gas+conn distal Luer mascle, tub conn pacient 150 (+/-10) cm+conn distal Luer mascle. Treball màx 1,3bars. S/làtex, est, ind, 1ús	Lot No Obligatori
36	Sistemes d'infusió per a contrast	30053864	Eq injecció de CO2 procediments angiogràfics, línia connexió a dispositiu i a catèter amb connector Luer Lock mascle amb vàlvula unidireccional, filtre de 0,2 µm i clau de pas 2 vies. Sense làtex, estèril, un sol ús. Compatible injector Angiodroid o eq	Lot No Obligatori
36	Sistemes d'infusió per a contrast	30054160	Tub de plàstic, de 114 (+/-10)cm, Ø4mm, per a injector de contrast en RMN i TAC. Amb sensor de pressió i filtre de partícules. Connexió Luer Lock. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb bomba XD8003 o equivalent.	Lot No Obligatori
37	Pressuritzadors	30002693	Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió rang 0-300 mmHg, de plàstic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, 1ús.	Lot No Obligatori
37	Pressuritzadors	30003214	Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang pressió rang 0-300 mmHg, plàstic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
37	Pressuritzadors	30007525	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° escala rang 0-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar pèrdua pressió, s/latex,1ús.	Lot No Obligatori
37	Pressuritzadors	30010098	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° escala fins 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/làtex,un sol ús.	Lot No Obligatori
37	Pressuritzadors	30018446	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, fins a 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, lliure latex, reutilitzable.	Lot No Obligatori
37	Pressuritzadors	30030881	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 3000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, rang 0-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, lliure latex, reutilitzable	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30001704	Protector-tap de plàstic per a protegir el punt d'addició de la bossa de nutrició parenteral al sistema automatitzat, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30002692	Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de la línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30004264	Caixa de protecció per a connexió entre prolongadora/prolongadora, de polipropilè (PP), interior amb esponja de poliuretà (PUR), mida: Alt 20 (+/-5) mm, ample 20 (+/-5) mm, longitud 30 (+/-5) mm. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30009185	Equip de reompliment dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 22G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenestrada, xeringa 20cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchromed o equivalent.	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30029500	Eq balanç hídric del pacient amb mesura la del volum d'orina i reposició automàtica del mateix volum, amb sistema infusió endovenós, bossa recollida d'orina, prolongadora per a la bossa d'orina,estèril,s/làtex,1úsCompatible amb equip Renalguard o eq	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors varis	30029750	Equip per a l'obtenció i la concentració cèl·lules mesènquima (mare) de moll d'os per a 7 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consta de: cilindre separació,xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101352897/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors variis	30040275	Connector/adaptador sense agulla volum purgat de 0,08 (+/-0,01) mL, connector Luer Lock mascle, vàlvula bidireccional, protector connector final. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors variis	30042055	Connector per a transvasament de líquids de forma estèril de xeringa a xeringa, sense volum residual, amb connexió Luer i Luer Lock, amb aletes de subjecció, de material plàstic, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors variis	30043750	Equip obtenció/concentració cèl·lules mesènquima(mare) moll os per a 3,5 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consta: cilindre separació,xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,1ús.Compatible BioCUE o eq	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors variis	30048952	Equip per a obtenció de grups cel·lulars de la SVF (Stromal Vascular Fraction) del teixit adipós. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Equip format per 70-75 elements.	Lot No Obligatori
38	Altres equips, sistemes d'infusió i adaptadors variis	30053417	Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 7 (+/-0,5) mL, consta de: cilindre, torniquet, xeringues,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cinta adhesiva. Estèril, sense làtex,1ús	Lot No Obligatori
39	Sistema de recollida per a cartílag	30060233	Sistema tancat per a recollida de teixit autològ(cartílag i os) activat per succió, compatible amb artroscòpia per a recollida de teixit, amb cambra i filtre. Compatible amb sistema Angel cPRP o equivalent.	Lot Obligatori
39	Sistema de recollida per a cartílag	30060234	Sistema per a obtenció de sèrum autòleg de trombina,amb 2 connexions a xeringa,de vidre de borosilicat i plàstic,estèril,individual,un ús.Compatible amb sistema Angel cPRP o equivalent	Lot Obligatori
40	Equip epidural per a neuroplastia percutània	30058623	Equip per alleugeriment del dolor i la inflamació,per a neuroplastia percutània. Compost de: Catèter epidural semirrígid,flexible dirigible de Ø2,1x295mm de llarg,guia,introductor,agulla Ø2,8x91,2mm de llarg i estilet.	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000032
Descripció llarga:		
Xeringa 3 cossos de 50mL capacitat amb agulla 14Gx1" (2x30mm) p/bombes perfusió,cos opac amb connexió Luer Lock concèntric,escala imp resa inesborrable graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làtex,lús ,env ind compatible a/bomba infusió xeringa		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30000033
Descripció llarga:		
Xeringa 3 cossos de 50/60mL de capacitat per a bombes de perfusió, cos opac (ambre) amb connexió Luer Lock concèntric, escala impres a inesborrable de graduació 1mL,èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làtex ,lús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001312
Descripció llarga:		
Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulado r de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001314
Descripció llarga:		
Eq EV gravetat, PVC 150 (+/-10) cm, punxó s/presa d'aire i s/filtre+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+ta p, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001315
Descripció llarga:		
Eq EV gravetat, PVC opac, 150 (+/-10) cm, punxó presa aire+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30001316
Descripció llarga:		
Eq EV gravetat, PVC, 45 (+/-5) cm, punxó presa aire+tap+filtre, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet petit, connexió Luer+tap, tub di àmetre intern de 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30001318
Descripció llarga:		
Eq inf EV gravetat,150(+/-5)cm de llarg, PVC transparent, microgoter 150(+/-10)mL, 60 microgotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15 µ , cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador flux per rodet, connexió L-L, s/làtex/ftalats,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30001319
Descripció llarga:		
Eq mesurar PVC, 2 tubs 80+/-5cm i 150+/-10cm long , columna d'aigua amb 3 línies amb clau 3 vies, punxó presa aire-filtre,cambra deg oteig, una "Y" per mesurar i altre connexió LL, 3 reguladors flux, sist segur anti-aire i 2 tubs.s/DEHP/làtex,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30001320
Descripció llarga: Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y" amb punt d'injecció, connexió proximal Luer Lock feme lla amb protecció, connexió distal Luer Lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, env ind, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30001321
Descripció llarga: Equip per a la monitorització invasiva de la pressió hemodinàmica de forma contínua, amb flux constant de 3mL/h, consta de: línia de PVC, filtre de 10 µ, dispositiu-vàlvula i connexió Luer Lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP, estèril, env ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30001322
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, clorur polivinil (PVC) transparent, 60(+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1mm x 2,5mm de diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle-mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30001323
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 90 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm d e diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30001324
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC, transparent, de 35 (+/-5) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30001325
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30001326
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30001327
Descripció llarga: Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 180 (+/-4) cm, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, lús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30001334
Descripció llarga:		
Eq monit altes pres, 3transd a/rentat flux 3mL/h,macrogoter 3línies no soldat transd 150(+/-10)cm,3 conn monitor imperm,3 claus 3P c al, 4 claus 3P, 3 línies 180(+/-5) i 30(+/-2)cm(vermell),2x120(+/-10) i 30(+/-2)cm(groc i blau), suport, s/làt/DEHP, est, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30001339
Descripció llarga:		
Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL, connector distal L-L femella, pinça, tap, s /làtex/DEHP , estèril, envàs ind, lús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30001417
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm d e diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30001418
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 90(+/-4)cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de dià metre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30001536
Descripció llarga:		
Eq altes pressions doble, transductors adult+port, rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG, macrogoter 2 línies no soldat transductor mesura PI C, conn impermeable, 2 claus 3P, mostra+codi color, 2x120(+/-10) i 30(+/-2)cm(groc i blau)+2claus 3P, suport, s/làt/DEHP, est, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30001537
Descripció llarga:		
Eq monit altes press, transductor adult+port, rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG, macrogoter línia no soldat al transductor de 150 (+/-10) c m, connector del cable del monitor impermeable, clau 3P calibració, clau 3P , línia 130(+/-5), suport, s/làt/DEHP, est, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30001538
Descripció llarga:		
Eq monit altes press, transd adult+port, rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG , macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, conn cable monit imperm, clau 3P cal, 2 claus 3P color a/2 lín 180(+/-5)cm(blau) i 180 (+/-10)+20(+/-2)cm(vermell), suport, s/làt/DEHP, est, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30001594
Descripció llarga:		
Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 50 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL, connector distal L-L femella, pinça, tap, s/ làtex/DEHP , estèril, envàs ind, lús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies o equivalent.		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30001691
Descripció llarga: BossaNPTpediatríaEVA250mL. Connector ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració). Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30001692
Descripció llarga: BossaNPTped,EVA multicapafotoprot,baixa permeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,500mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L femella+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additiuació+tap ,conn sortida a/membrana.S/làt/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30001693
Descripció llarga: Bossasol parenteral,PVC.1000mL,dos ports: un d'ompliment amb filtre de 0,2µi l'altre d'addició per a connectar l'equip d'infusió o medicació, amb etiqueta indicativa, estèril, envàs individual. Compatible amb dosificadora GRI-FILL 3.0 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30001694
Descripció llarga: BossaNPT,EVA, 3000mL. Connector ompliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automa titzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30001704
Descripció llarga: Protector-tap de plàstic per a protegir el punt d'addició de la bossa de nutrició parenteral al sistema automatitzat, estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30001706
Descripció llarga: BossaNPT,EVA multicapaa,3500mL escala,nansa ergo,3 lín entrada a/punxó+pressa aire+filtre bact+clamps,72(+/-5)cm+cambra+filtre partí cules 270(+/-20)µ,LL F tub+LL M bossa,clamp segur via ompli,punt additiv+tap,sortida membrana.S/làt/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30002117
Descripció llarga: Línia prolongadora 1(+/-0,1)bar pressió, PVC transparent, 18(+/-2) cm, 3 mm x 4 (+/-0,15) mm de diàmetre, amb derivació lateral en " Y", extrems connexions L-L femella-femella i L-L mascle (part inferior), s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30002286
Descripció llarga: Bossareinfusió autotransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm, PVC, connexió L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, es tèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb equip de recuperació-reinfusió per a sistema CATS+ o equivalent		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30002555
Descripció llarga:		
Eq exsanguini-transfusió a nounats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40 (+/-2)cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa graduada recollida sang de 2000 (+/-100)mL, xeringues 10/20 mL. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30002578
Descripció llarga:		
Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vie s a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30002606
Descripció llarga:		
Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE) , opaca, mida de 550 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, amb filtre per a radiació UV i transmissància UV <10%, tancada, amb forat, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30002610
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-mascle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30002611
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30002615
Descripció llarga:		
Línia prolongadora d'1 (+/-0,1)bar, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern , extrems amb connexions L-L mascle i Luer Lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30002616
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins a 40 (+/-1)bars de pressió, opaca, resistent lípids, PVC, 150 (+/-4)cm de longitud, diàmetre intern 1 x 2,5m m diàmetre extern, extrems connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella, s/làtex, s/DEHP, est, envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30002617
Descripció llarga:		
Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+ connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individ ual, lús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatories CADD Legacy/Solis o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30002618
Descripció llarga:	Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30002619
Descripció llarga:	Eq irrigació doble,PVC,2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect"Y"i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra, línia 5 x7 ,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8,3mm+17 (+/-3)cm.Luer Lock.S/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30002622
Descripció llarga:	Eq infusió EV sang gravetat pediatria, PVC, consta de: punxó, bureta cilíndrica graduada de 100 (+/-10) mL amb filtre de 200 µ i pun t d'injecció L-L,punt "Y" injecció,Luer Lock mascle terminal a/tag filtre purga, s/làtex/DEHP,estèril,env ind,1ús	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30002626
Descripció llarga:	Transductor pressió monitorització altes pressions, consta de: sistema de rentat de flux continu 3mL/h a 300 mmHg, connector de cabl e a monitor impermeable a líquids, clau de 3 passos L-L mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, 1ús	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30002686
Descripció llarga:	Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors r odet i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30002687
Descripció llarga:	Eq infusió EV administració sang, plàstic transparent, 203 (+/-10) cm. Punxó, cambra degoteig amb filtre 200µ, cilindre de purgat, m anegot a pressió, regulador flux de rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30002692
Descripció llarga:	Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de l a línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,d'un sol ús.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30002693
Descripció llarga:	Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió rang 0-300 mmHg, de plàs tic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, lús.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30002701
Descripció llarga: Flebomanòmetre / regleta amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç tel escòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, sense làtex, envàs individual, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30003211
Descripció llarga: Eq EV, PVC transparent, 200 (+/-10) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flux per rodet, conn L-L mascle, s/làtex/DEHP,estèril,ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30003214
Descripció llarga: Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang pressió rang 0-300 mmHg, plàstic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30003215
Descripció llarga: Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm,dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,lús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30003217
Descripció llarga: Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, casset+port secundari, ciamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,lús. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APLUS+ o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30003250
Descripció llarga: Eq recuper-reinfusió sang post-Q. Bossa PVC graduada 500 (+/-10) mL+filtre 200µm, port mostres+clamp+tap port entrada i eq transfusió cambra degoteig+2 filtres 40/80µm i conn L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,lús.Compat Bellovac o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30003371
Descripció llarga: Eq EV 2 vies"Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de ciamp, línia de diàmetre 6 ,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTU, s/làtex/DEHP,est,ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30004137
Descripció llarga: Transductor monitoritzar TA i mesurar la línia de cardioplègia, amb vàlvula amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella mòbil, de policarbonat, mida amb cable de 35,5 (+/-3) cm, estèril, envàs ind, un sol ús. Tipus Meritrans o equivalent.		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30004143
Descripció llarga:		
Eq bomba infusió, PVC, 198(+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador línia blava,extrem distal a/connexió LL M, v olum purgat 2,3 mL,pinça,tap,s/làtex/DEHP,est,env ind,lús.Compatible bombes inf ambulatories CADD Legacy/Solis/Prizm o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30004153
Descripció llarga:		
Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, es tèril, envàs individual, lús. Compatible reservoris i bombes CADD Legacy(Solis) o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30004211
Descripció llarga:		
Equ complet d'autotransfusió,PVC,a/2 equips: recol.lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia connex-buit,reservori a/filtre 40µ i un a/rentat circuit-màquina,campana 125 (+/-5)mL i bossa rebuig,estèril ,individual p/equip,lús.Comp màquina Electa o equ		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30004213
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins a 20 (+/-1) bars de pressió, per a injector automàtic agents radioopacs intravenosos, de clorur de polivinil (PVC), flex ible, transparent, de 150 (+/-10) cm de longitud. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30004264
Descripció llarga:		
Caixa de protecció per a connexió entre prolongadora/prolongadora, de polipropilè (PP), interior amb esponja de poliuretà (PUR), mid a: Alt 20 (+/-5) mm, ample 20 (+/-5) mm, longitud 30 (+/-5) mm. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30004443
Descripció llarga:		
Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG ,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió Ø1.14mm 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30004444
Descripció llarga:		
Eq monit altes press,transd adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG ,macrogot línia no soldat transd 150(+/-10)cm, connector cable monitor impermeable, clau 3p calibració, clau 3p, línia pressió 120(+/-5)+30(+/-2)cm,suport,s/làt/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 30004445
Descripció llarga:		
Eq EV bomba PVC transparent, 272 (+/-10) cm, punxó amb presa aire, cambra de degoteig 20 gotes/mL i filtre 15µ, clamp, cassat, punt d'injecció en "Y", s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Life Care/Plum o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 30004450
Descripció llarga:		
Eq EV bomba PVC, 300 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, bureta 150mL,cambra degoteig transparent+tròcar, purga 17(+/-1)mL, connexió distal Y"segur i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30004451
Descripció llarga:		
Eq EV bomba PVC, 255 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig+trocar, filtre 15µ, purga 22(+/-1)mL, connexió dis tal en "Y"de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30004453
Descripció llarga:		
Eq EV bomba TPE transparent, 275(+/-10)cm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre de 15µ, purga 25+/-1ml, port dist al en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind ,un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30004454
Descripció llarga:		
Eq EV sang en bomba, PVC, dos punxons en "Y" amb regulador de flux de rodet, cambra de degoteig amb filtre de 200 µ, casset amb port secundari de seguretat, connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, estèril, ind, un sol ús. Compatible LifeCare/plum o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30004456
Descripció llarga:		
Eq bomba infusió,PVC,290(+/-10)cm,dispositiu arrossegat,vàlv antireflux, perforador+filtre,port inyec s/agulla,extrem distal a/conne xió LL M ,purgat 14mL,pinça,tap,s/làt/DEHP,est,env ind,lús.Compatible bombes inf ambulatòries CADD Legacy/Solis/Prizm o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30004457
Descripció llarga:		
Línia prolongadora EV sensor de pressió bomba xeringa, opaca ambre, 200 (+/-10)cm, purga 1,5 mL, connexió proximal L-L femella i con nexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible bomba Alaris CC o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30004474
Descripció llarga:		
Línia prolongadora 5 (+/-1) bars de pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm diàmetre, extrems amb connexions amb connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella i clau 3 vies punt injecció, s/làt/DEHP, est,env ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30004475
Descripció llarga:		
Línia prolongadora 5 (+/-1) bars,PVC transparent, resistent lípids, 17(+/-3)cm, 2x4,15 (+/-0,15)mm de diàmetre, extrems amb connexio ns amb connexions Luer Lock mascle giratòria i Luer Lock femella i clau de 3 vies, sense làtex, s/DEHP, est, env ind,lús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30004838
Descripció llarga: BossaNPT,EVA multicapafotoprot,baixpermeabO2/CO2/H2O, 2000mL,escala ,nansa,3 línies d'entrada de 65 (+/-7) cm+filtre, clamps, punxó+filtre aire,connexió Luer femella, punt d'addició amb tap de seguretat.S/làtex/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30004862
Descripció llarga: BossaNPT ped,EVA multicapafotoprot,baixpermeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,250mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L femella+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additiuació+tap ,conn sortida a/membrana.S/làtex/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 30004865
Descripció llarga: BossaNPT ped,EVA multicapafotoprot,baixpermeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,500mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L mascle+tap i clamp segur p/segell via ompliment,punt additiuació+tap ,conn sortida a/membrana.S/làtex/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30005131
Descripció llarga: Equip infusió elàstomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 7 mL/h, volum d'ompliment màxim de 300 (+/-10) mL i nomina 27 2 mL, durada teràpia 39 hores, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex/DEHP, estèril,envàs individual,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30005204
Descripció llarga: Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC transparent,resistent lípids, 150(+/-10)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle-mascl,taps, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30005206
Descripció llarga: Línia prolongadora de 20 (+/-1) bars pressió, PVC transparent, resistent a lípids, de 100 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems L-L mascle giratori i L-L femella ,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30005209
Descripció llarga: Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 25(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre ext ern consta de: clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,lúa		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30005229
Descripció llarga: Línia prolongadora 20 (+/-1) bars de pressió, PVC transparent, resistent a lípids, 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 (+/-0 ,15) mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-mascl ,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs ind,lús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30005230
Descripció llarga:		
Línia prolongadora 20 (+/-1) bars pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle giratòria- filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30005231
Descripció llarga:		
Línia prolongadora d'infusió de 2(+/-1)bars de pressió, PVC transparent, resistent lípids, 100(+/-4)cm de longitud, de diàmetre intern de 3x4 ,1 (+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle-masclé,taps,s/làtex,s/DEHP,estèril,envàs individual,ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30005233
Descripció llarga:		
Línia prolongadora EV amb sensor pressió bomba xeringa, PVC, transparent, 200 (+/-10) cm, purga 1,5mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, ús. Compatible bomba xeringa Alaris CC/P7000 o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30005234
Descripció llarga:		
Xeringa 3cosos 50mL a/agulla càrrega connectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat ,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,lús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30005358
Descripció llarga:		
Eq sang autòloga/drenatge buit,tròcar 14G+catèter CH14, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap por t entrada i eq transfusió+cambrà goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est ,envàs ind,lús.Compatible Bellovac o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30006506
Descripció llarga:		
Eq lastomèric amb flux variable de 2 mL/hora, reservori de 120 (+/-10) mL, durada del tractament 60h, per a l'administració d'analgèsic, amb filtre clamp, connexió Luer Lock mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30006508
Descripció llarga:		
Equip d'infusió elastomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum compliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30006533
Descripció llarga:		
Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació peristàtica, de 4,2 (+/-0 ,2) metres (m) de longitud, amb punxó, tram de silicona. Sen se làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb Chiripro 980 o equivalent.		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30006535
Descripció llarga:	Transductor sonda h20 urodinàmica, dispositiu de rentat, vàlvula sobrepressió, sistema evacuador, clau de posta a "0", connexió L-L, connexió elèctrica, flux 3mL/h, rang -50 a +300 mmHg, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Solar i Nexam o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30006681
Descripció llarga:	Línia prolongadora 2(+/-1)bars, PVC, resistent a lípids, de 10(+/-5)cm de longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15)mm diàmetre ext ern consta de: clau 3v PC transparent 2 connexions L-L F, 1 connexió L-L M, taps protecció,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30006916
Descripció llarga:	Eq infusió elastomèric amb+H93:R93 flux variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 mL/hora, graduat, volum reservori de 250 mL, durada del tract ament segons el flux programat, admanalgèsia, línia amb filtre, clamp, connexió Luer Lock, s/làtex/DEHP,est,en ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30007049
Descripció llarga:	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 5, 7, 12 mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 20 a 48h, codi color, administració analgèsia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30007167
Descripció llarga:	Equip per a mesurar la pressió intra-compartmental amb sistema de calibratge i connexió a xeringa. Pantalla digital en mmHg	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30007426
Descripció llarga:	Eq EV sang a/bomba volumètrica,PVC, 275(+/-10)cm,punxó a/cambra degoteig transparent a/filtre 200µ aleta compatible a/sensor,sist an ti-reflux ,rodet,purga 26mL,conn distal iL mascie rotatori,s/làt/DEHP,est,lús.Compatibl bomba Signature Edition I/II o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30007467
Descripció llarga:	Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexi ó L-L mascie, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril, envàs ind, lús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30007492
Descripció llarga:	Eq elastomèric transparent, flux 1mL/h, volum ompliment 110(+/-10)mL, filtre antipartícules+doble de venteig hidròfug, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 105(+/-5)cm, contenidor,reservori,clamp línia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind,un sol ús	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30007502
Descripció llarga:		
Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 280 (+/-10) cm, sensor pressió i resistència, cambra degoteig, filtre 15µ, purga 25(+/-1)mL, por t injecció en "Y"+vàlvula segur,connexió distal L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,lisol ús.Compatible bomba Signature Edition o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30007525
Descripció llarga:		
Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòme tre 360° escala rang 0-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar pèrdua pressió, s/latex,lús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30007567
Descripció llarga:		
Línia prolongadora d'infusió endovenosa per a bomba de xeringa, PVC/PE), de baixa absorció, calibre de 3 mm, de 200 (+/-10) cm de longitud, purga de 1,7mL, connexió Luer Lock (proximal i distal), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30007672
Descripció llarga:		
Bossa NPT ped,EVA multicapa fotoprot,baixa permeabilitat O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,150mL escala,nansa ergonòmica,conn L-L femella+tap i ciamp segur p/segeill via ompliment,punt additivació+tap ,conn sortida a/membrana.S/làt/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30007999
Descripció llarga:		
Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 5 mL/h, volum d'ompliment 120 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional,s/làtex/DEHP,est,en ind ,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 30008000
Descripció llarga:		
Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 10 mL/h, graduat, volum d'ompliment 240 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) m L, contenidor, reserv ori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 30008205
Descripció llarga:		
Eq inf EV gravetat compat citos/lípids,de PVC trans 180(+/-1)cm ,punxó+presa aire+filtre antibact,cambra degoteig 20got/mL part sup r ígida/inf flexible+filtre segur 15µ base cambra,rodet,conn LL a/tap hidròfug,tub 3x4(+/0,15)mmØ,s/làt/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 30008292
Descripció llarga:		
Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics ,plàstic flexible,amb:3entrades líquids (1-sèrum/2-contrast), filtre,sensor pressió,L-L,tub p/incorporar a rodets-injector contras ,durada 24h.,no làtex,estèril.Com injector Ulrich o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30008294
Descripció llarga:	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, Ø intern 2,5mm x 150 (+/-10) cm, amb: 2 vàlvules antiretorn, Luer Lock, apirògen, estèril, individual, un ús. Compatible injectors Ulrich o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30008306
Descripció llarga:	Eq inj CO2 angiograf.Xerig 100mL/dosis 20mL+sist tancament ajustar dosis, clau gir 90° injectió/càrrega CO2, línia 100 (+/-10) cm ga s+conn distal Luer mascle,tub conn pacient 150 (+/-10) cm+conn distal Luer mascle.Treball màx 1,3bars.S/làtex,est,ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30008382
Descripció llarga:	Equip d'infusió per irrigar per a l'equip d'urodinàmica, de silicona transparent, de 3,7 (+/-0,1) metres (m) de longitud, consta de: un punxó, dues línies i connexió Luer Lock universal, estèril. Compatible amb l'equip d'urodinàmica Solar o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30008403
Descripció llarga:	Bossa NPT,EVA multicapa col.lapsab,flex, transp,fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vitA/C,3000mL escala,nansa ergon òmica,LL M a bossa+tap i clamp segur segellar via omplir,punt additivació+tap,sortida membrana,S/làtx/DEHP,est,env ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30008465
Descripció llarga:	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, alt volum, PVC transparent, amb punxó amb purga d'aire per utilitzar amb ampolles sense connector amb entrada a pressió.Est,s/làtex/DEHP,env ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30008468
Descripció llarga:	Línia transferir líquids microvolum, de PVC i silicona, transparent, transferència de medicaments amb volum encebament inferior a 10 mL, entrada i sortida amb connexió Luer Lock mascle, s/làtex, estèril, envàs ind, lús. Compatible Repeater Pump o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30008483
Descripció llarga:	Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en procediments de microdialisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30008703
Descripció llarga:	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, de color, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30008705
Descripció llarga:	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles (protecció UV), de polietilè (PE), semitransparent, de color, mid a de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30008734
Descripció llarga:	Adaptador universal vials transferència-preparació de fluids com fàrmacs/citostàtics/antibiòtics, filtre venteig hidròfob de 0,2 µm i vàlvula seguretat-biocconnector, volum de purgat de 0,10 (+/-0,01)mL, longitud 6,4 (+/-0,1)cm.Est,s/làtx/DEHP,lús,env ind	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 30008850
Descripció llarga:	Bossa fotoprotectora PE xeringa, tractada pintura metal·litzada alumini d'alta protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica molt propera al "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) mm x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 30008947
Descripció llarga:	Línia prolongadora d'1 (+/-0,1)bar de pressió, de 180 (+/-2) cm, de diàmetre interior 3mm i exterior 4,1 (+/-0,15) mm, amb connexió Luer Lock mascle-femella amb tap protector, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 30009097
Descripció llarga:	Línia prolongadora d'infusió d'alta pressió 40 bars (+/-1), per a bomba de xeringa, de polietilè (PE), de 200 (+/-10) cm de longitud , connexions a cada extrem Luer Lock mascle i Luer Lock femella, sense PVC,s/làtx/DEHP, estèril, envàs ind, lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 30009100
Descripció llarga:	Línia prolongadora 2 (+/-1) bars,PVC, resistent a lípids, de 30(+/-2)cm longitud, diàmetre intern de 3x4,1(+/-0,15) mm de diàmetre e xtern, extrems amb connexions Luer Lock mascle giratori i Luer Lock femella, taps protecció,s/làtx/DEHP,est,envàs ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 30009185
Descripció llarga:	Equip de reemplaçament dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 22G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenest rada, xeringa 20cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchronmed o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 30009600
Descripció llarga:	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 1,5 mL/h,volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 252mL,du rada teràpia 7 dies, codi de color, administració analgèsia, quelació i quimioteràpia ,sense làtex/DEHP,estèril,env ind,lús	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30009685
Descripció llarga:		
Línia NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó+filtre antibacterià, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, dob le punt additivació, connexió Luer Lock femella, 210(+/-10)cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30009686
Descripció llarga:		
Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió Luer, longitud de 10 (+/-1) cm, sen se làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30009922
Descripció llarga:		
Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV , mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10), oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30009923
Descripció llarga:		
Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca, de color, amb filtre per a radiació UV , mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30010098
Descripció llarga:		
Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° e scala fins 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/làtex,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30010109
Descripció llarga:		
Línia prolongadora d'infusió endovenosa per perfusió de fluids,PVC transparent,2 punts d'injecció agulla,Øextern 4,1mm,Øintern 3mm,l ongitud 100cm+/-10cm (trams 15+70+15cm),2 clamps,connexió LL femella i LL mascle rotatori,lliure làtex i DEHP,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30010137
Descripció llarga:		
Bossa fotoprotectora oberta per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca, de color, amb filtre per a radi ació UV, mida d 460 (+/-10) mm x 295 (+/-10) mm, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30010138
Descripció llarga:		
Bossa NPT,EVA multicapa fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C,3500mL,nansa,3 línies 72(+/-5)cm-pres a aire,filtr bact 3µ,clamps ,conn LLM,clamp segur p/seguell via omplir,punt additiv+tap,conn sortid a/membran.s/làtx/DEHP,est,env ind,lús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 30010233
Descripció llarga:	Línia prolongadora baixa absorció, pressió 10(+/-1)bars, PVC, flexible, transparent, capa interna PE, 200 (+/-10)cm longitud, diàmetr e intern 2 ,5x4 (+/-0,1)mm diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-mascle giratori.S/làtex/DEHP,est,envàs ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 30011412
Descripció llarga:	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 2 ,5ml/h,volum d'ompliment màxim de 130 (+/-5) mL i nominal 120mL ,durada de la teràpia de 48hores, codi de color,administració quimioteràpia, sense làtex/DEHP,estèril,envàs individual,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 30011606
Descripció llarga:	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 2, 4, 6 mL/h, volum ompliment màxim 300(10+/-)mL i nominal 24 0mL, durada teràpia 40h a 5 dies, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 30011742
Descripció llarga:	BossaNPT, EVA, 125mL. Connector ompliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automat itzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 30011846
Descripció llarga:	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, amb velocitat flux 5 mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 120 mL , durada teràpia 24 hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 30011891
Descripció llarga:	Eq sang autòloga/drenatge buit,trocar 10G+catèter CH10, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap por t entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est , envàs ind,lús.Compatible Bellovac o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 30012040
Descripció llarga:	Equip d'infusió elastomèric fotoprotector-transparent per a medicació amb velocitat de flux de 100 mL/h, volum d'ompliment màxim de 105 (+/-5) , contenidor, reservori, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 30012343
Descripció llarga:	Eq sang autotransfusió CIR, PVC,reservori a/filtre 3L, línia i tub conn L-L+clamp, línies i cambra de rentat especial, bossa de rebu ig 10L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i tub de doble llum,PVC,est,envàs ind,lús. Compatible CATS+ o equivalent	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 30012496
Descripció llarga: Dispositiu transferència fluids/citostàtics, consta: connector a/vàlvula femella seguretat p/ús s/agulla i segellat bidirec antiaeros ol, doble filtre aire hidròfug 0,2µm, punxó, purga 0,1l (+/-0,01)mL. Est, s/làtx/DEHP, lús, env ind. Compatible sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 30012600
Descripció llarga: Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, dur ada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 30013205
Descripció llarga: Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux de 1, 2, 3mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 96 mL, durada teràpia 32 a 96h, codi color, administració analgèsia, quimioteràpia, sense làtex/DEHP, estèril, env ind, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 30013276
Descripció llarga: Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 2,5 x 37, 5 (+/-5) cm, agulla+introdutor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 30014542
Descripció llarga: Equip d'infusió per l'equip urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 3 (+/-0,1) metres (m) de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 30014705
Descripció llarga: Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 7,5 x 42, 5 (+/-5) cm, agulla+introdutor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 30014706
Descripció llarga: Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 15 x 50 / +/-5) cm, agulla+introdutor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 30015297
Descripció llarga: Eq EV bomba PVC, 230 (+/-5) cm, i 3mm calibre, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22(+ /-1)mL, conn distal L-L, tancament amb pinça de cargol, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un ús. Compatible Alaris GW o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 30015298
Descripció llarga:		
Eq EV bomba volumètrica, PVC opac, 250 (+/-10) cm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça cargol, s/làtex,sense DEHP ,estèril,ind,lús.Compatible bomba Alaris GW o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 30015307
Descripció llarga:		
Eq EV bomba, baixa absorció, TPE, 270 (+/-10) cm i 3mm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig, tròcar x flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24 (+/-1)mL, conn distal L-L,tancament pinça cargol,s/làtex/DEHP,est,ind,lús.Compatible Alaris GW o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 30015801
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa inesborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 30015802
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos de 50 mL per a bombes de perfusió amb connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent lubricat amb escala impresa a inesborrable de graduació 1 mL, èmbol amb anella de seguretat.Est,s/làt ,lús,env ind. Compatible a/bomba infusió xeringa.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 30016920
Descripció llarga:		
Transductor de pressió de butoral de polivinil (PVB), sense equip de rentat, per a manometries anorectals i esofàgiques, per utilitz ar amb bombes de perfusió pneumocapil·lars, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb polígraf Synmed i eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 30017426
Descripció llarga:		
Sist irrigació continua recàrrega ràpida, injecció controlada contrast/altres solucions x coledocoscòpia endoscòpica, vàlvula unidi reccional omplir xeringa estirant l'èmbol, tub silicona 2,5 (+/-0,1)m punxó i regulador, xeringa de policarbonat. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 30017428
Descripció llarga:		
Vàlvula seguretat unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, lliure làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 30017431
Descripció llarga:		
Eq infusió líquid bufeta urir,3 línies unides 500(+/-10)mm PVC + 200(+/-10)mm silicona + 3000(+/-10)mm PVC, i llarg total 3,7 (+/-0, 1)m, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làt/DEHP ,est,env ind,lús.Compatible Phoenix plus o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 30017550
Descripció llarga:	Cúpula pressió per transductor connex L-L mascle integrada a clau 3 vies, extrem inferior L-L femella in tegrat clau 1 via ompliment sèrum, estèril, envàs individual, lús. Compatible transductor i eq Phoenix plus o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 30018084
Descripció llarga:	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible CADD Legacy/Solis o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 30018112
Descripció llarga:	Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió Luer a xeringa, terminal amb connexió al protec tor del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, Immucyst BCG o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 30018160
Descripció llarga:	Equip per a monitorització de pressions de manera automàtica en pediatria, consta de: transductor amb flux de 30mL/h, línia de press ió de 28 (+/-5) cm, 2 claus de 3 passos, amb sistema de rentat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 30018161
Descripció llarga:	Eq EV bomba,baixa absorció, TPE, 275 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig+ trocar x flascó/bossa, filtre15µ, purga 25(+/-1)mL, connexió distal L-L, pinça segur, pinça cargol+pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Alaris GP o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 30018162
Descripció llarga:	Eq EV bomba, PVC, 255 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24(+/-1)mL, 2 ports en "Y"+vàlvula se gur, connexió distal L-L, tancament pinça seguretat i pinça rodet,s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible Alaris GP o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 30018163
Descripció llarga:	Eq EV bomba PVC, 265 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça seguretat i amb pinça rodet, s/làtex/DEHP,estèril ,ind,lús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 30018164
Descripció llarga:	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 250 (+/-10) cm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 23(+/-1)mL, connexió dis tal L-L, pinça seguretat, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Alaris GP o eq	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 30018370
Descripció llarga: Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra irrigació, amb tub i tap, 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 30018445
Descripció llarga: Punxó plàstic vàlvula bidireccional per a reconstrucció fàrmacs (citostàtics), filtre de 0,2µm d'aire antibacterià i retenció d'aero sols. Filtre 5µm per a retenció de partícules.Base gran. Connexió a xeringa.Tap hermètic.Sense làtex,sense ftalats,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 30018446
Descripció llarga: Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, fins a 300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/ciau seguretat per evitar la pèrdua pressió, lliure latex, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 30018741
Descripció llarga: Transductor pressió rentat eq urodinàmica, PVB. Sistema rentat 30 mL/h, sistema purgat ràpid, connec L-L (un per la bomba de perfusió i aigua i altre pel polígraf),est,ind,lús. Compatible sist urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 30018775
Descripció llarga: Equip EV bomba volumètrica, TPU/EVA (baixa absorció), opac,265 (+/-10) cm longitud, 5 ports: vàlvula seguretat (4 en "Y"), cambra de goteig+filtre venteig 15µ,purga 24mL, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible Signature Edition o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 30018776
Descripció llarga: Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: Luer tancat amb vàlvula de seguretat-bioconnector, volum de purga de 0,12 (+/-0,1)mL. Est,s/làt/DEHP,lús,env ind		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 30018779
Descripció llarga: Prolongadora baixa absorció citotòxics PUR, 3mm x 55 (+/-5) cm, punxó+filtre 0,22 µ, port "Y"invertida+vàlvula segur, L-L giratori+ filtre+ vàlv unidireccional, vàlvula antirreflux, 2 clamps abans/després filtre,purga 6 (+/-1)mL, s/làtex/DEHP,est,ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 30018780
Descripció llarga: Prolongadora baixa absorció,lípids,gravetat,opaca fàrmac fotosen/citos ,PVC,30 (+/-2) cm,punxó a/filtre venteig hidròfob 0,2µm, port "Y" invertida a/bioconnector,LL a/tap hidròfob,vàlv unidireccional,pinça,purga 1,7(+/-0,2)mL. Est,s/làt/DEHP,lús,env ind		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 30020182
Descripció llarga:	Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), codificació de color, amb filtre per a radia ció UV i transmissància UV <10%, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 30026557
Descripció llarga:	Eq monitorització PA, línia 120(+/-10)cm i línia extensió alta pressió 30(+/-5)cm + clau 3p, aixeta rentat amb flux manteniment 2 a 4 mL/h i flux de rentat 60 mL/h, s/làtex,estèril,envàs individual, lús.Compatible transductor reutilitzable LogiCal o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 30028047
Descripció llarga:	Vàlvula selectora primària per a nutrició parenteral, transparent, amb 24 fonts d'entrada, un connector de sortida de gran diàmetre per a l'ompliment de bosses.Est,s/làtex/DEHP,envàs individual,lús.Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 30028048
Descripció llarga:	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, PVC transparent, punxó sense purga d'aire per utilitzar amb bosses o ampolles amb purga d'aire, connector d'entrada a pressió.Est,s/làtex/DEHP,envàs individual ,lús.Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 30028050
Descripció llarga:	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de microvolum, PVC transparent, a punxó amb purga d'aire per utilitzar amb vials de mid a petita, connector amb entrada a pressió. Est,s/làtex/DEHP,envàs individual ,lús.Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 30028051
Descripció llarga:	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de clorur de polivinil (PVC) transparent, amb connexió Luer Lock femella (utilitzar per a xeringues), connector d'entrada a pressió. Est,s/làtex/DEHP,env ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 30028260
Descripció llarga:	Dispositiu adm fluids/citostàtics amb bossa infusió, consta:punxó a/filtre aire,connector amb vàlvula femella seguretat (sense agull a) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,06(+/-0,01)mL.Est ,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compatibl sist ChemoClave o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 30028261
Descripció llarga:	Adaptador universal a/bomba infusió i p/gravetat, PVC,tub Ø4,8x6,8mm p/5(+/-1)cm,vàlv a/connexió LL mascle segur(ús s/agulla,girator i,alt flux ,no desconnectable a/sist bloqueig),purga 1(+/-0,02)mL.Est ,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compatibl sist ChemoClave o eq	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 30028305
Descripció llarga:	Eq EV sang/hemoderivats PVC 275 (+/-10) cm, 2 ports "Y" (proximal i distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 3 l(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,lús.Compatible Alaris GP o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1780	MATERIAL: 30028306
Descripció llarga:	Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa,PC,vàlvula amb connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, d'a lt flux, no desconnectable amb sistema bloqueig),purga 0,1(+/-0,01)mL.Est,s/làt/DEHP ,lús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1790	MATERIAL: 30028654
Descripció llarga:	Equip infusió EV gravetat PVC transparent, 175 (+/-10) cm, punxó+presa aire, 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, "Y" amb biocnnctor bidi rrecional, regulador rodet 5-250 mL/h, connexió L-L giratòria+filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1800	MATERIAL: 30028715
Descripció llarga:	Línia prolongadora infusió fluids EV, PUR,PE,PP, fotoprotectora de color ambre, de 22(+/-2)cm longitud, filtre de 0,2 µ, extrems amb connexions Luer Lock M-F.Estèril, lliure làtex, s/ftalats,lús, envàs individual. Compatible sist ChemoClave o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1810	MATERIAL: 30029500
Descripció llarga:	Eq balanç hídric del pacient amb mesura la del volum d'orina i reposició automàtica del mateix volum, amb sistema infusió endovenós, bossa recollida d'orina, prolongadora per a la bossa d'orina,estèril,s/làtex ,lúsCompatible amb equip Renalguard o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1820	MATERIAL: 30029547
Descripció llarga:	Bossa NPT,EVA multicapà fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O i reduc% degradació vita/C,flexible,250mL escala,nansa,LL F gran+tap+clamp segur p/seguellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/làt/DEHP,est/env ind,lús.Compat maquina omplir	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1830	MATERIAL: 30029548
Descripció llarga:	Bossa NPT,EVA multicapà fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O i reduc% degradació vita/C,flexible,500mL escala,nansa,LL F gran+tap+clamp segur p/seguellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/làt/DEHP,est/env ind,lús.Compat maquina omplir	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1840	MATERIAL: 30029603
Descripció llarga:	Equip per a bomba infusió implantable per a l'administració intratecal de fàrmacs. Estèril. Compatible amb bomba TRUCUMED o equival ent.	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1850	MATERIAL: 30029656
Descripció llarga:	Vàlvula anti-sifó per evitar la caiguda de fluid lliure, de clorur de polivinil (PVC), unidireccional, volum de purga 0,2 ml, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1860	MATERIAL: 30029657
Descripció llarga:	Bosses NPT pediàtria, EVA, 500mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment i administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1870	MATERIAL: 30029658
Descripció llarga:	Bosses NPT, EVA, 2000mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1880	MATERIAL: 30029659
Descripció llarga:	Bosses NPT pediàtria, EVA, 1000 mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment, administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1890	MATERIAL: 30029714
Descripció llarga:	Eq complet autotransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia con-buit,reservori a/filtres i un a/rentat circuit-màquina,campana 125(+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L),estèril,individual,un ús.Comp a Xtra o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1900	MATERIAL: 30029750
Descripció llarga:	Equip per a l'obtenció i la concentració cèl·lules mesènquima (mare) de moll d'os per a 7 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consta de: cilindre separació,xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1910	MATERIAL: 30029969
Descripció llarga:	Eq EV sang/hemoderivats PVC 285 (+/-10) cm x 3mm, port "Y" per injecció (abans cambra), cambra degoteig+filtre200µ, purga 32(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i amb pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Alaris GW o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1920	MATERIAL: 30029990
Descripció llarga:	Eq EV bomba PVC, 220 (+/-10) cm x 3mm, cambra de degoteig+trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 21(+/-1)mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un ús. Compatible amb bomba Alaris GW o eq	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1930	MATERIAL: 30030092
Descripció llarga: Sistema de tubs amb circuit tancat per a la refrigeració de la peça de mà mitjançant la circulació de líquid, de silicona, sense làt ex, d'un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Visao o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1940	MATERIAL: 30030095
Descripció llarga: Línia prolongadora, 20+/-lbars de pressió, PVC flexible, transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions Luer Lock mascle i Luer Lock femella. Sense làtex, sense DEHP,est,ind,lús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1950	MATERIAL: 30030103
Descripció llarga: Bossa NPT,EVA multicapà fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C.1000mL,nansa,3 línies 72(+/-5)cm+presa aire,filtr bact 3µ.clamps ,conn LLM,clamp segur p/segell via omplir,punt additiv+tap,conn sortid a/membran.S/làtx/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1960	MATERIAL: 30030104
Descripció llarga: Bossà NPT,EVA multicapà fotoprot,baix permeab O2/CO2/H2O+reducció % degrad vit A/C.2000mL,nansa,3 línies 72(+/-5)cm+presa aire,filtr bact 3µ.clamps ,conn LLM,clamp segur p/segell via omplir,punt additiv+tap,conn sortid a/membran.S/làtx/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1970	MATERIAL: 30030239
Descripció llarga: Equip recol·lector sang x eq autotransfusió, PVC, línia asp/anticoagulació, línia connexió buit, reservori rigid+filtre 40µ per a au tottransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Xtra o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1980	MATERIAL: 30030316
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 50/60mL de capacitat per a bombes de perfusió, cos transparent amb connexió Luer Lock concèntric, escala impr esa imborrable de graduació 1mL, èmbol amb anella de seguretat. Est, s/làtex,lús,env ind compatible a/bomba infusió xeringa		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 1990	MATERIAL: 30030324
Descripció llarga: Dispositiu regulació flux infusió 0-250 mL/h doble escala permet treballar en funció l'espessor (10% o 40%), línia prolongadora PVC 3mmØ i 54 (+/-4) cm, volum purga 3,8 (+/-0,2)mL, connexió "Y", L-L giratori, posició ON/OFF, s/làtex/DEHP, est, ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2000	MATERIAL: 30030492
Descripció llarga: Línia 2vies p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir 2 solucions,100(+/-5)cm,a/6extrems:2 en punxó i LL a tub,1 con Luer Lock i a bomba,1 a bossa buit,ciamps.filtre aire,xer 60mL.Est,s/làtx/DEHP ,lús.Compatibl a/dosificad GRI-FILL 3.0 o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2010	MATERIAL: 30030533
Descripció llarga: Eq NPT domiciliària per a bomba, PVC, anticolzament, Ø1x2,2mm i 27(+/-3)cm llarg, punxó, guia, sensor pressió, clamp, filtre pla 1,2 µ i membrana aire 0,22µ, vàlvula antireflux amb conn L-L mascle, s/làtex/DEHP, est, idv, lús. Compatible Mini Rythmic PN o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2020	MATERIAL: 30030719
Descripció llarga: Eq-extensió prep/adm citos, consta: punxó+vàlv, port"Y" a/connector segur s/ag, clamp pinça, filtre 0,2µ, connector proximal segur s/ ag, tub Ø2 ,9 (+/-0,1)x4,1 (+/-0,15)mm i 36(+/-5)cm, purga 4.6(+/-0,5)mL. Est. s/làt/DEHP, lús, env ind. Comp sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2030	MATERIAL: 30030728
Descripció llarga: Eq infusió endovenós administració sang, per gravetat, de clorur polivinil (PVC) transparent, de 200(+/-10)cm llarg, punxó, doble ca mbra tancada am filtre de sang 200µ, regulador flux rodet, connexió terminal L-L mascle , s/làtex/ftalats, est, env ind, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2040	MATERIAL: 30030729
Descripció llarga: Equip infusió admin sang gravetat tub PVC transparent de 165 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL+filtre sang partícules, connexió terminal L-L mascle giratori amb tap+filtre purga membrana antibact, sense làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2050	MATERIAL: 30030741
Descripció llarga: Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús . Compatible amb bomba Infosumat Space o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2060	MATERIAL: 30030742
Descripció llarga: Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça a ntireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP, est, ind, lús . Compatible Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2070	MATERIAL: 30030743
Descripció llarga: Equip infusió EV bomba volumètrica, PUR, fàrmacs baixa absorció, punxó, cambra degoteig a/presa aire i filtre 15µm, regulador, clamp, tub 3 mm DI i 4,1mm DE, long 250 (+/-10) cm, connexió LL. Est. s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2080	MATERIAL: 30030881
Descripció llarga: Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 3000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, ra ng 0-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/ciau seguretat per evitar la pèrdua pressió, lliure latex, reutilitzable		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2090	MATERIAL: 30030883
Descripció llarga: BossaNPT,EVA multicapa, 2000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'adminis tració) , sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2100	MATERIAL: 30030884
Descripció llarga: BossaNPT,EVA multicapa, 3000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'adminis tració) , sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2110	MATERIAL: 30030975
Descripció llarga: BossaNPT,EVA multicapa fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reduc% degradació vitA/C,flexible,1000mL escala,nansa,iLL F gran+tap+clamp segur p/secellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/lât/DEHP,est/env ind,lús.Compat maquina omplir		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2120	MATERIAL: 30030976
Descripció llarga: BossaNPT,EVA multicapa fotoprot baixa permeab O2/CO2/H2O+reduc% degradació vitA/C,flexible,2000mL escala,nansa,iLL F gran+tap+clamp segur p/secellar via ompliment,punt d'additiv a/tap i punt adm twist-off.S/lât/DEHP,est/env ind,lús.Compat maquina omplir		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2130	MATERIAL: 30031051
Descripció llarga: Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàvula automàtica, clau pas, tub infusió per a connexió salina+línia color, dr ap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari,muntatge suport sèrum,s/làtex/DEHP,est,ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2140	MATERIAL: 30031133
Descripció llarga: Bossafotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida d e 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2150	MATERIAL: 30031180
Descripció llarga: Eq infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat flux 130 mL/h, volum de 65 mL amb 30 minuts, volum màxim de 8 0 (+/-5)mL ,contenidor, reservori transparent,vàlvula ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2160	MATERIAL: 30031181
Descripció llarga: Equip d'infusió elastomèric, velocitat de flux de 200mL/h, volum de 100 mL amb 30 minuts, volum màxim de 100 mL, per administrar med icació, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2170	MATERIAL: 30031191
Descripció llarga: Equip d'infusió elàstomèric transparent per a medicació, graduat de flux de 21 mL/h, volum màxim de 300 (+/-25) mL, conte nidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre,s/làtex/DEHP,est,en ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2180	MATERIAL: 30031660
Descripció llarga: Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, de color, transmissió 200-600nm <10%, mida de 175 (+/-1 0) mm x 350 (+/-10) mm, oberta, amb forat i tancament adhesiu, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2190	MATERIAL: 30032172
Descripció llarga: Adaptador-dispositiu a accés de vials amb vàlvula de seguretat-bioconnector, reconstituït i preparació de citostàtics, filtre vent eig hidròfob de 0,2 µm, de 13 mm de coll de vial, volum purga 0,15 mL, longitud 6 (+/-0,1)cm. Est,s/làt/DEHP,lús,env ind		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2200	MATERIAL: 30032173
Descripció llarga: Adaptador-dispositiu a accés de vials amb vàlvula de seguretat-bioconnector, reconstituït i preparació de citostàtics, filtre vente ig hidròfob de 0,2 µm, de 28 mm de coll de vial, volum purga de 0,15 mL, longitud 7 (+/-0,1)cm. Est,s/làt/DEHP,lús,env ind		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2210	MATERIAL: 30032174
Descripció llarga: Adaptador-dispositiu a accés de vials amb vàlvula de seguretat-bioconnector, reconstituït i preparació de citostàtics, filtre vente ig hidròfob de 0,2 µm, de 20 mm de coll de vial, volum purga de 0,15 mL, longitud 6 (+/-0,1)cm. Est,s/làt/DEHP,lús,env ind		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2220	MATERIAL: 30033432
Descripció llarga: Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica p ropera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent, estèril, env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2230	MATERIAL: 30033827
Descripció llarga: Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, semitransparent, transmissió 200-600nm <10%, mida de 120 (+/-10) x 230 (+/-10) mm, vial 100 mL, orifici per a penjar pal sèrum i sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2240	MATERIAL: 30034028
Descripció llarga: Eq inf EV bomba volumètr,PVC,opac,285(+/-10)cm,punxó a/pressa aire, cambra de degoteig a/vàlvula entrada aire+filtre 15 µ,casset,pinç a rodet,port "Y "injec segur, connexió LL M, tap,s/làt/DEHP,est,env ind,lús.Compatible bombes inf ambulatories Medina o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2250	MATERIAL: 30034030
Descripció llarga:		
Eq inf EV bomba volumètr,PVC,transparent,285 (+/-10)cm,punxó a/pressa aire, cambra de degoteig a/vàlvula entrada aire+filtre 15 µ,cass et,pinça rodet,port "Y "injec segur, connexió LL M, tap,s/làt/DEHP,est,env ind,lús.Compatible bombes inf ambulatories Medi		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2260	MATERIAL: 30034054
Descripció llarga:		
Eq infusió elastomèric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est,ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2270	MATERIAL: 30034195
Descripció llarga:		
Línia lvia p/omplir bossa sol parenteral a/dosificadora a partir d'1 solució,100 (+/-5)cm long,a/5extrems:1 en punxó i LL a tub i a s olució dosifiqueu,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer 50-60mL.Est,s/làt/DEHP ,lús.Compatib a/dosificad GRI-FILL 3.0 o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2280	MATERIAL: 30034205
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos de 50/60 mL connexió connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesbo rrible graduada 1 mL,èmbol a/anella segur.Est,s/làt/DEHP/BFA,lús,env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2290	MATERIAL: 30034238
Descripció llarga:		
Línia bomba infusió PVC 152 (+/-10) cm, filtre, volum purgat 1,8 mL, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DE HP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible reservori i bomba CADD Legacy(Solis) o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2300	MATERIAL: 30034250
Descripció llarga:		
Eq infusió EV sang bomba volum,PVC,250 (+/-10)cm llarg,punxó,pressa aire+filtre antibact,cistella filtrat 200µm,cambra gota a/filtre 15µm ,pinça antireflux,connexió LL rotatori a/tap a/membrana.Est,s/làt/DEHP,env ind,lús.Comp a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2310	MATERIAL: 30034662
Descripció llarga:		
Punxo/adaptador vial/flascó 20 i 28mm,sistema tancat transferència,sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillosos.Adaptador vial/flascó,pu rga 0 ,14 (+/-0.1)mL,long 6,6 (+/-1)cm, punxó i filtre 0.2 ìm amb globus.Est,s/làt/DEHP,lús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2320	MATERIAL: 30034889
Descripció llarga:		
Eq infusió EV de PVC transparent, 210 (+/-10) cm, punxó a/pressa aire, cambra amb degoteig 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, clamp, regu lador 5-250 mL/h, "Y" amb bioconnector bidirrecional, L-L mascle giratori, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2330	MATERIAL: 30034936
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos 3 mL, connexió Luer Lock concèntric, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,1 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làt/DEHP/BFA,lús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2340	MATERIAL: 30034937
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos 30 mL, connexió Luer Lock excèntrica, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada a 1 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làt/DEHP/BFA,lús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2350	MATERIAL: 30035007
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos 10 mL, connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent i lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,2 mL, èmbol amb anella seguretat.Est,s/làt/DEHP/BFA,lús, env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2360	MATERIAL: 30035015
Descripció llarga:		
Xeringa de 3 cossos 5mL connexió Luer Lock concèntrica, cos transparent lubricat siliconat amb escala impresa inesborrable graduada 0,2 mL, èmbol amb anella de seguretat. Est,s/làt/DEHP/BFA,lús,env ind.Compatible a/robot reconstitució fàrmac Kiro o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2370	MATERIAL: 30035711
Descripció llarga:		
Equip irrigació URS,cambra flexible Ø25mmx12cm llarg a/bombeig manual p/augmentar pressió,2connex bossa sèrum fisiològic a/ciamps ta ncament ,extrem distal Luer Lock p/adaptar ureteroscopi i regulador flux cremallera, 260 (+/-10) cm,s/làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2380	MATERIAL: 30035763
Descripció llarga:		
Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada pintura metal.litzada alumini protecció UV, capa interior PES, transmissió òptica propera "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament veta adherent, estèril, envàs individual, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2390	MATERIAL: 30037817
Descripció llarga:		
Eq infusió EV bomba volumètrica,PUR,fàrmacs baixa absorció,filtre 0,2µm ,punxó,cambra degoteig a/presa aire+filtre 15µm,regulador rod et,clamp,tub 3mmD1x4,1mmDE,250 (+/-10)cm,conn LL.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,lús.Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2400	MATERIAL: 30038040
Descripció llarga:		
Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió proximal Luer Lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP ,estèril,ind, lús.Compatible Mòdul DPS o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2410	MATERIAL: 30038041
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 50 mL a/ag 15G x 1 1/2" (1,8x40mm) p/bomba perfusió. Cos de polipropilè (PP) transparent amb escala impresa in esborrable, anel seguretat. Estèril, s/làt, làtex, DEHP, lús, env ind. Compatible amb bomba de xeringa Orchestra Mòdul DPS o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2420	MATERIAL: 30038882
Descripció llarga: Eq EV bomba transparent, 300 (+/-10)cm. Punxó, membrana segur+cambra gota+segur+presa aire+filtre 15µ, punt entrada medicació s/agulla, regulador rodet, tap antidegoteig, pinça, conn L-L. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2430	MATERIAL: 30039708
Descripció llarga: Línia Prolongadora per a administració de fàrmacs citostàtics, PUR, 35 (+/-2)cm llarg. Consta de: punxó, vàlvula antirreflux, connexió LL audible amb filtre hidròfob, clamp tancament. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2440	MATERIAL: 30039709
Descripció llarga: Eq inf EV bomba volum, PUR, sist tancat, citos, punxó, cambra gota a/presa aire+filtre 15µm, rodet, clamp, conn LL, tub 230 (+/-10)cm llarg, 2 vàlv antireflux fins 3,1 bars, 1 vàlv bidirecció. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2450	MATERIAL: 30039710
Descripció llarga: Eq inf EV bomba volum, PUR, sist tancat, citos, punxó, cambra gota a/presa aire+filtre 15µm, rodet, clamp, conn LL, tub 230 (+/-10)cm llarg, 4 vàlv antireflux fins 3,1 bars, 1 vàlv bidirecció. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/ bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2460	MATERIAL: 30039711
Descripció llarga: Línia Prolongadora administració/preparació i reconstitució citostàtics, PUR, 35 (+/-5)cm llarg, filtre 0,2µm línia, vàlvula fins 3,1 b ars, connexió LL audible a/filtre hidròfob, clamp. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2470	MATERIAL: 30039712
Descripció llarga: Línia Prolongadora administració/preparació i reconstitució fàrmacs citostàtics, PUR, 35 (+/-5)cm llarg, vàlvula bidireccional fins 3,1b ars, connexió LL filtre hidròfob, clamp, antireflux. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compatible a/bomba Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2480	MATERIAL: 30039713
Descripció llarga: Eq inf EV bomba volum, PUR opac, sist tancat p/citos, punxó, cambra gota+presa aire+filtre 15µm, rodet, clamp, connexió LL, tub 230 (+/-1)cm llarg, 4 vàlv antireflux fins 3,1bars, 1 vàlv bidireccional. Est, s/PVC/làtex/DEHP, env ind, lús. Compat Infosumat Space o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2490	MATERIAL: 30039714
Descripció llarga:		
Eq inf EV bomba volum,PUR opac,sist tancat p/citos,punxó,cambra gota+presa aire+filtre 15µm,rodet,clamp,connexió LL,tub 230(+/-1)cm llarg,2 vàlv antireflux fins 3,1bars,1 vàlv bidireccional.Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind,lús.Compat Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2500	MATERIAL: 30039715
Descripció llarga:		
Línia prolongadora administració/preparació i reconstituició citostàtics, PUR opac,35(+/-5)cm llarg,vàlvula resistent fins 3,1bars,co nnexió Luer Lock a/filtre hidròfob, clamp de tancament..Est,s/PVC/làtex/DEHP,env ind ,lús.Compat Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2510	MATERIAL: 30040078
Descripció llarga:		
Adaptador vial 13mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05(+/-0,01)mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,lús.Compatible Equashield o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2520	MATERIAL: 30040080
Descripció llarga:		
Adaptador L-L mascle,transferir/adm citostàtics/medicació,volum residual 0,09(+/-0,01)mL,converteix a femella L-L en una entrada se gellada per la membrana per injecció segura medicaments amb xeringa,s/làtex/DEHP/BPA, est,lús. Compatible Equashield o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2530	MATERIAL: 30040084
Descripció llarga:		
Bossa reinfusió autotransfusió 1 (+/-0,1) litre (L), PVC, connexió Luer Lock, set de rentat, 2 ports de sortida 1/4 pre-segellats (a mb clamp lliscant), estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible equip recuperació-reinfusió sistema XTRA o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2540	MATERIAL: 30040184
Descripció llarga:		
Dispositiu-punxó transferència fluids/citostàtics,5 (+/-1) cm, punxó 2,5 (+/-0,5) cm,per a microvial,connector a/vàlvula femella seg uretat ús s/agulla i segellat bidireccional antiaerosol,volum intern 0,16 (+/-0,05) mL. S/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2550	MATERIAL: 30040199
Descripció llarga:		
Eq EV bomba,PVC opac, 300 (+/-10) cm, disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+trò car flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27 (+/-1)mL, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,lús.Compatible Alaris VP o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2560	MATERIAL: 30040200
Descripció llarga:		
Eq EV bomba,PVC transparent, 300 (+/-10) cm,disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degote ig+tròcar flascó/bossa,filtrre 15µ, purga 27(+/-1)mL,tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,lús.Compat Alaris VP o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2570	MATERIAL: 30040255
Descripció llarga: BossaNPT pediatria EVA multicapa, 1000mL escala, part sup nansa i part inf connexió L-L femella petitatap, clamp via ompliment, pu nt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1sol ús. Compatible Exactamix o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2580	MATERIAL: 30040275
Descripció llarga: Connector/adaptador sense agulla volum purgat de 0,08 (+/-0,01) mL, connector Luer Lock mascle, vàlvula bidireccional, protector con nector final. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2590	MATERIAL: 30040292
Descripció llarga: Xeringa 3cosos 20mL a/agulla càrrega conectada+tap p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall s eguretats ,junta estanqueïtat.Est,s/làtex/DEHP,lús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2600	MATERIAL: 30040293
Descripció llarga: Xeringa bomba infusió 3cosos 50mL,agulla càrrega+filtre 15ïm,LL central ,taronja-ambre fotoprotector,doble graduació inesborrable,to pall segur,junta estanqueïtat.Est,s/làtd/DEHP,lús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2610	MATERIAL: 30040295
Descripció llarga: Línia prolongadora bomba xeringa, pediatria, transparent, pressió màxima de 4 bars, de polietilè (PE), volum de purga de 1,18 mL, de 150cm de longitud, connexions a cada extrem L-L mascle i L-L femella, s/PVC, làtex ,est,ind,lús. Compatible Perfusor o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2620	MATERIAL: 30040503
Descripció llarga: Eq inf EV bomba volum,sistema tancat,PVC translúcid,230(+/-10)cm llarg ,p/citos,punxó,cambra gota+filtre 15µm,5 vàlvules seg(4 unidir eccional i 1 bidireccional,conn LL audible+filtre hidròfob,clamp.Est,s/làtex/DEHP,env ind,lús.Compat Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2630	MATERIAL: 30040504
Descripció llarga: Línia Prolongadora per a fàrmacs citostàtics, PVC, 35(+/-5)cm llarg,punxó, vàlvula bidireccional de se guretats, filtre en línia de 0,2 µm, connexió LL audible amb filtre hidròfob,clamp tancament.Est,s/làtex/DEHP,env ind,lús.Compat Infosumat Space o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2640	MATERIAL: 30040656
Descripció llarga: Equip infusió irrigació, de polímer transparent, de 3 (+/-0,1)m de longitud, consta de: un punxó, una part de la línia per connectar al rodet de l'equip, connexió Luer Lock,s/làtex, estèril, envàs individual ,lús. Compatible eq urodinàmica Nexam o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2650	MATERIAL: 30040877
Descripció llarga:	Bossa infusió 1000 mL, amb Luer mascle, un port d'espiga i un port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2660	MATERIAL: 30040878
Descripció llarga:	Bossa infusió 100 mL, amb Luer mascle, 1 port de punta i 1 port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2670	MATERIAL: 30040879
Descripció llarga:	Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2680	MATERIAL: 30040880
Descripció llarga:	Vial d'injecció de 100 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2690	MATERIAL: 30041375
Descripció llarga:	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10)cm, punxó, membrana seguretat evitar despurgat eq, cambra degoteig segur+presa aire+filtrel5µ, punt entrada s/agulla, regulador rodet, pinça, conn L-L, tap antidegoteig. Est, s/làtex/DEHP, env ind, lús. Compat Infosumat Space o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2700	MATERIAL: 30041403
Descripció llarga:	Dispositiu adm fluids i citostàtics amb bossa infusió, consta: punxó a/filtre aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, a/segellat bidireccional, purga 0,34 (+/-0,06)mL. Est, s/làtex/DEHP, lús, env ind. Comp sist ChemoClave o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2710	MATERIAL: 30041443
Descripció llarga:	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat de flux de 1,4 mL/h, volum màxim de 130 (+/-10) mL, con tenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre, s/làtex/DEHP, est, env ind, lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2720	MATERIAL: 30041444
Descripció llarga:	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, graduat, velocitat de flux de 1 mL/h, volum 65 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre, s/làtex/DEHP, est, env ind, lús	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2730	MATERIAL: 30041445
Descripció llarga:	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació 24h hores, graduat, velocitat de flux 2,7 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia amb filtre, s/làtex/DEHP,estèril,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2740	MATERIAL: 30041677
Descripció llarga:	Adaptador xeringa, preparació/adm tancada citostàtics/medicaments, apte tots volums xeringues i connexió L-L, agulla 16G alumini, vo lum residual 0 mL, amb tap, s/làtex, s/PVC, est,ind,lús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2750	MATERIAL: 30041678
Descripció llarga:	Adaptador vial 13 i 20 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó acti vat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex/DEHP/PVC,est,ind,lús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2760	MATERIAL: 30041679
Descripció llarga:	Adaptador vial 28 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,lús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2770	MATERIAL: 30041680
Descripció llarga:	Adaptador Luer Lock, per a la preparació i administració tancada de citostàtics/medicaments, amb clic auditiu, per connexió correcta , s/làtex, s/PVC, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible CHEMFORT o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2780	MATERIAL: 30041739
Descripció llarga:	Connector Luer Lock preparació/administració fluids/citostàtics, amb vàlvula seguretat, sistema circuit tancat, canal endoluminal, s ege ll comprimible de silicona tipus Split Septum, bidireccional, sense agulles ,pressió neutra,s/làtex/DEHP est,env ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2790	MATERIAL: 30042055
Descripció llarga:	Connector per a transvasament de líquids de forma estèril de xeringa a xeringa, sense volum residual, amb connexió Luer i Luer Lock, amb aletes de subjecció, de material plàstic, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2800	MATERIAL: 30042369
Descripció llarga:	Adaptador vial 20mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05(+/-0,01) mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,lús.Compatible Equashield o eq	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2810	MATERIAL: 30042370
Descripció llarga:	Adaptador vial 28mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ,volum purga 0,05(+/-0,01) mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA,estèril,ind,lús.Compatible Equashield o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2820	MATERIAL: 30042627
Descripció llarga:	Eq EV bomba volumètrica PE transparent, 285 (+/-10) cm, filtre incorporat de 0,2 µm, cambra de degoteig, volum de purga de 25 mL, co nnexió distal L-L, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2830	MATERIAL: 30042741
Descripció llarga:	Eq complet autotransfusió,PVC,amb 2 equips: un recol·lecció a/línia aspiració-anticoagulació,línia con-buit,reservori a/filtres i un a/rentat circuit-màquina,campana 225 (+/-5)mL,bosses (rebuig 10L/reinfusió 1L) ,estèril,individual,un ús.Comp a Xtra o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2840	MATERIAL: 30042791
Descripció llarga:	Adaptador-connector tancat s.vesical,adm citostàtics/medicaments,extrem con adaptador sonda vesical 4,1mm,extrem línia/extensió s ist tancat transferència 3 (+/-0,1)cm longitud a/connexió adaptador xeringa.S/làt/DEHP/est,lús.Compatible CHEMFORT ONB o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2850	MATERIAL: 30043022
Descripció llarga:	Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus de 0,5 mL, clamp, filtre par tícules, connexió Luer Lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex/DEHP ,estèril,envàs ind, un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2860	MATERIAL: 30043361
Descripció llarga:	Xeringa estanca 1mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar) ,sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril pre carregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,lús.Compatible Equashield o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2870	MATERIAL: 30043362
Descripció llarga:	Xeringa estanca 3mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar) ,sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril pre carregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,lús.Compatible Equashield o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2880	MATERIAL: 30043363
Descripció llarga:	Xeringa estanca 5mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar) ,sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril pre carregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,lús.Compatible Equashield o eq	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2890	MATERIAL: 30043364
Descripció llarga:		
Xeringa estanca 10mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril pr ecarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,lús.Compatible Equashield o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2900	MATERIAL: 30043366
Descripció llarga:		
Xeringa estanca 35mL citostàtics/medicaments. Segellada(èmbol no desmuntar),sist s/agulles externes,connector soldat,aire estèril pr ecarregat, bloqueig èmbol,igualació pressions,connexió seca, s/làtex/DEHP/BPA,est,envàs ind,lús.Compatible Equashield o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2910	MATERIAL: 30043367
Descripció llarga:		
Adaptador Luer Lock femella, per a transferir i adm citostàtics/medicació. Converteix un Luer Lock estàndard en una sistema tancat p er a la injecció segura de medicaments fent servir la xeringa, s/làtex,DEHP,BPA,estèril ,lús. Compatible Equashield o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2920	MATERIAL: 30043368
Descripció llarga:		
Línia/perllongador 48(+/-2)cm long.Connexió segura i seca amb membrana hidrofòbica. Consta:punxó, cambra degoteig (20 gotes/mL),connector Luer Lock mascle,pinça/clamp de la línia i tap protector.S/làtex/DEHP/BPA,est ,env ind,lús.Compatible Equashield o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2930	MATERIAL: 30043603
Descripció llarga:		
Línia transparent bomba xeringa multicanal. Connexió simultània 2 flascons/bosses. 2 línies conn L-L femella, vàlvules antireflux, 1 línia 50(+/-5)cm amb connexió contenidor final L-L mascle,s/làtex/DEHP ,estèril,envind,lús. Compatible bomba Medimix o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2940	MATERIAL: 30043604
Descripció llarga:		
Línia prolongadora transparent baixa absorció lípids per a infusió EV amb bomba xeringa, PUR, 75(+/-5)cm, connexió Luer Lock M/F, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb bomba volumètrica multicanal Medimix o eq.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2950	MATERIAL: 30043605
Descripció llarga:		
Eq línia+xeringa bomba multicanal. 1 línia PUR transparent 25(+/-5)cm, punxó, cambra degoteig, filtre 15µ, presa aire amb filtre antibacterià amb connexió "T" Luer Lock M/F i 1 xeringa 50mL. S/làtex/DEHP, est,env ind ,un ús.Compatible bomba Medimix o eq.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2960	MATERIAL: 30043607
Descripció llarga:		
Equip línia+xeringa bomba multicanal. 1 línia PUR transparent, 25(+/-5)cm amb punxó unida a 1 connexió "T" Luer Lock mascle/femella i 1 xeringade 50 mL. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible bomba Medimix o eq.		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2970	MATERIAL: 30043749
Descripció llarga: Equip obtenció/concentració plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta de: cilindre de separació, xeringues, agulla 18, 22 i 25G, flascó ACD-A de 45,7 (+/-2)cm, papallona amb agulla 8G,gases estèrils ,cinta adhesiva,apòsit. Estèril,s/làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2980	MATERIAL: 30043750
Descripció llarga: Equip obtenció/concentració cèl·lules mesênquima(nare) moll os per a 3,5 (+/-0,5)mL d'aspirat de medul·la òssia, consta: cilindre se paració , xeringues,agulla 18G,flascó ACD-A 45,7(+/-1)cm,agulla aspir medul·lar,gases,est,s/làtex,lús.Compatible BiOCUE o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 2990	MATERIAL: 30043790
Descripció llarga: Línia aspiració amb anticoagulació integrada per a procediments d'autotransfusió, 3,5(+/-0,1)m longitud i línia de 4 (+/-0,1)m amb c ambra de degoteig i punxó. Sense làtex, sense DEHP, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb XTRA o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3000	MATERIAL: 30047366
Descripció llarga: Eq elàstomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus, clamp, filtre partícules, c onnexió Luer Lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex, sense DEHP ,estèril,envàs ind, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3010	MATERIAL: 30048549
Descripció llarga: Eq infusió EV bomba, tub resistent llum amb revestiment PE, 272(+/-10)cm, a/punxó amb presa aire+clamp, cambra degoteig amb filtre d e 15 µ i port, filtre 0,2 µ + clamp, punt injecc "Y", conn segur. S/làtex i DEHP, est, 1 ús. Compatible Life Care/Plum o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3020	MATERIAL: 30048613
Descripció llarga: Eq obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP), consta: cilindre extracció 20 mL centrifugació i obtenci ó diferents fraccions sanguínies al mateix dispositiu, èmbol roscat, xeringues 1,2,5mL, connector,tap. S/làtex, est, lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3030	MATERIAL: 30048853
Descripció llarga: Eq inf irrigació 2 vies "Y", s/cambra d'aire tub a/2 punxons de Ø5x6,8mm (int-ext) i 20(+/-5)cm long a/clamps, línia Ø5x6,8 mm (int- ext) i 170(+/-10)cm long a/regulador flux i extrem inferior a/tub 10(+/-2)cm, Ø5x9mm(int-ext), s/làtex/DEHP,est,env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3040	MATERIAL: 30048854
Descripció llarga: Punxó/adaptador vial/Flascó 20mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillous. Adaptador vial/flascó,purg a 0 ,14(+/-0,1)mL i long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre a/globus.Est,s/làtx/DEHP,lús,env ind.Compatibl sist ChemoClave o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3050	MATERIAL: 30048855
Descripció llarga: Punxó/adaptador vial/flascó 13(+/-1)mm,sist tancat transferència,sist s/agulla sang,fàrmacs,fàrmacs perill,filtre hidròfug 0,2µ,cos punxó 3(+/-)0,1cm a/braç bloqueig i protector,purga 0,27(+/-)0,02mL.Est ,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3060	MATERIAL: 30048952
Descripció llarga: Equip per a obtenció de grups cel·lulars de la SVF (Stromal Vascular Fraction) del teixit adipós. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Equip format `per 70-75 elements.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3070	MATERIAL: 30051283
Descripció llarga: Dispositiu per a transferència/connectors doble sense agulla, de policarbonat, per a xeringa-xeringa amb Luer lock femella / femella bidireccional, volum de purgat de 0,15 (+/-0,2)mL.Est.s/làt/DEHP,lús,env ind.Comp sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3080	MATERIAL: 30051304
Descripció llarga: Punxó/adapt vial/flascó 20mm, sist tancat per a transferència, sistema sense agulla per a fàrmacs perillosos/químio. Compost per: adaptador punxó, filtre 0,2 µm a/globus volum purga 0,18(+/-0,02)mL.Est.s/làt/DEHP ,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3090	MATERIAL: 30051305
Descripció llarga: Punxó/adaptador bossa a/injector, sist tancat p/transferència, sist s/agulla fàrmacs perillosos/quimioteràpia. Compost per: connecto r Luer lockmascle, tub injector 8(+/-1)cm volum purga 1,8(+/-0,1)mL.Est ,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3100	MATERIAL: 30051306
Descripció llarga: Dispositiu adm fluids i citostàtics a/bossa infusió,punxó amb filtre d'aire 1,2µm, connector a/vàlvula femella seguretat(sense agull a) i antiaerosol, a/segellat bidireccional,purga 0,38(+/-0,02)mL.Est ,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3110	MATERIAL: 30051307
Descripció llarga: Connector per a l'administració de fluids i citostàtics amb vàlvula f emella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segell a t bidireccional, volum de purga de 0,104(+/-0,01)mL.Est.s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3120	MATERIAL: 30051308
Descripció llarga: Connector xeringa o tub endovenós per a l'administració de fluids i citostàtics amb vàlvula mascle de seguretat (sense agulla) i ant iaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purgat 0,35 (+/-0 ,01)mL.Est.s/làt/DEHP,lús,env ind.Comp sist ChemoLock o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3130	MATERIAL: 30051309
Descripció llarga:		
Punxó/adaptador per a vial/flascó de 28 mm airejat, sistema sense agulla per a fàrmacs peril·losos/quimioteràpia. Compost per: adapta dor per a vial/flascó, punxó, volum de purga de 0,18 (+/-0,02)mL.Est,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3140	MATERIAL: 30051398
Descripció llarga:		
Punxó/adaptador per a vial/flascó 13mm, sistema tancat per a transfe rència, sistema sense agulla per a fàrmacs/fàrmacs peril·losos . Compost per: adaptador per a vial/flascó, punxó i filtre amb globus.Est ,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3150	MATERIAL: 30052229
Descripció llarga:		
Connector/adaptador sense agulla volum, compatible amb sonda vesical. Lliure de làtex, ftalats, estèril, d'un sol ús. Estèril, lliur e de làtex, lliure de DEHP, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb sistema ChemoClave o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3160	MATERIAL: 30052284
Descripció llarga:		
Línia prolongadora fins 20(+/-1)bars de pressió, PVC, 30 (+/-2)cm de longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 mm de diàmetre extern, punt d'injeccióen "Y", clamp, connexió Luer Lock mascle, lliure làtex, lliure ftalats,estèril, envàs individual, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3170	MATERIAL: 30052301
Descripció llarga:		
Eq infusió endovenosa gravetat,PVC transparent, 175(+/-10)cm long ,punxópresa aire, degoteig 20 gotes/mL, filtre seguretat 15µ,tap,re gulador deflux de rodet de 5 a 250 mL/h, connexió LL mascle amb tap estanc, s/làtex, s/DEHP,estèril,envàs individual,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3180	MATERIAL: 30052369
Descripció llarga:		
Eq elastomèric transparent 2mL/h, 96 mL (48hores) , volum màxim 130 (+/-10)mL, filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfug , port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3190	MATERIAL: 30052370
Descripció llarga:		
Eq elastomèric transparent 5mL/h, 240 mL (48hores) , volum màxim 300 (+/-10)mL, filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfu g, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,lús		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3200	MATERIAL: 30052371
Descripció llarga:		
Eq elastomèric transparent 10mL/h, 240 mL (24hores), volum màxim 300 (+/-10)mL, filtre antipartícules, filtre doble de venteig hidròfu g, port d'entrada amb vàlvula antiretorn, línia 105 (+/-5)cm, contenidor, reservori,sense làtex/DEHP, estèril, env ind,lús		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3210	MATERIAL: 30052494
Descripció llarga: Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica, PVC, opac, 240(+/-10) cm longitud, cambra degoteig, segment de bomba, filtre de 15 µ , volum de purga de 5(+/-1) mL, punt injecció s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril, lús. Compatible bomba Body Guard o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3220	MATERIAL: 30052495
Descripció llarga: Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, clamp, casset, punt d'injec ció en "Y", connexió Luer- lock, s/làtex/DEHP, est, ind, lús. Compatible LifeCare/Plumset		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3230	MATERIAL: 30052512
Descripció llarga: Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica, PVC, transparent , 240(+/-10) cm longitud, cambra degoteig, segment de bomba, filtre de 15 µ, volum de purga de 5(+/-1) mL, punt injecció s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril, lús. Compatible bomba Body Guard o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3240	MATERIAL: 30052683
Descripció llarga: 15 Punxons/adapt vial/flascó 20 i 28mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillous. Adaptador vial/flascó, p urga 0 , 14(+/-0,1)mL, long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre 0.2µm a/globus. Est, s/làt/DEHP, lús, env ind. Comp sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3250	MATERIAL: 30052827
Descripció llarga: Punxó/adaptador vial/flascó 28mm, sistema tancat transferència, sist s/agulla fàrmacs/fàrmacs perillous. Adaptador vial/flascó, pur ga 0 , 14(+/-0,1)mL i long 6,6(+/-1)cm, punxó i filtre amb globus. Est, s/làt/DEHP, lús, env ind. Compat sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3260	MATERIAL: 30052828
Descripció llarga: Punxó/adaptador vial/flascó de 13mm, sistema tancat transferència, sistema sense agulla, connector s/agulla, filtre d'aire hidròfug, punxó amb braç de bloqueig i protector, volum purgat 0,3(+/-0 ,02)mL. Est, s/làtex/DEHP, lús, env ind. Compatible ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3270	MATERIAL: 30052829
Descripció llarga: Equip de seguretat secundari compatible amb bomba d'infusió Plum 360. Compost per: Cambra de degoteig amb sistema sense agulla, tub de 97 (+/-3)cm, ganxó, i connexió tancada. Est, s/làt/DEHP, lús, env ind. Compat sist ChemoClave o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3280	MATERIAL: 30052831
Descripció llarga: 15 Connector xeringa ús en equip adm i extracció endovenosa, PC, vàlvula a/connexió LL mascle seguretat(ús sense agulla, giratori, al t flux, no desconnectable amb sistema bloqueig), purga 0,1(+/-0,01)mL. Est, s/làt/DEHP , lús, env ind. Comp sist ChemoClave o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3290	MATERIAL: 30052832
Descripció llarga:	Equip infusió endovenós per a bomba PVC,272 (+/-10) cm,amb filtre de 15µl en càmera transparent,port secundari,clamp,punt d'injecció en "Y" i ciamp amb tancament segur,s/làtex/DEHP,estèril,ind,lús. Compatibleamb bomba Lifeshield o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3300	MATERIAL: 30052977
Descripció llarga:	Línia prolongadora fins 21(+/-1)bars pressió, PVC, 15(+/-2)cm llarg, diàmetre intern 3 mm x 4,1 mm de diàmetre extern, punt injecció "Y" amb vàlvula de seguretat, clamp, connexió LL mascle amb tap de purga, lliure làtex/ftalats, estèril, envàs ind,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3310	MATERIAL: 30053417
Descripció llarga:	Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 7 (+/-0,5) mL, consta de: cilindre, torniquet, xeringues ,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cinta adhesiva. Estèril, sense làtex,lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3320	MATERIAL: 30053440
Descripció llarga:	Equip 15 punxons/adaptadors bossa/flascó, sistema tancat p/transferència ,sistema s/agulla p/fàrmacs/fàrmacs peril·losos.Compost per:p unxó i connector.Longitud punxó 8,4 (+/-0,2)cm,purga 0,35 (+/-1)mL.Est ,s/làtx/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoClave o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3330	MATERIAL: 30053796
Descripció llarga:	Cúpula de pressió per al transductor urodinàmia de policarbonat (PC), membrana silicona, consta de: clau d'l i 4 vies amb connector Luer Lock. estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb transductor MEMSCAP o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3340	MATERIAL: 30053864
Descripció llarga:	Eq injecció de CO2 procediments angiogràfics, línia connexió a dispositiu i a catèter amb connector Luer Lock mascle amb vàlvula un idireccional, filtre de 0,2 µm i clau de pas 2 vies. Sense làtex, estèril, un sol ús. Compatible injector Angiodroid o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3350	MATERIAL: 30053865
Descripció llarga:	Equip per a l'obtenció/concentració de plasma ric en plaquetes de sang autòloga (PRP) 3,5 (+/-0,5)mL, consta de: cilindre, torniquet , xeringues ,agulles (18,22,25G), flascó d'ACD-A, papallona de 18G, gases, apòsit i cintaadhesiva. Estèril, s/làtex, lús	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIO: 3360	MATERIAL: 30053957
Descripció llarga:	Eq infusió EV bomba,PVC, tub ambre PE per a fàrmacs fotosensibles ,216(+/-10)cm,4 ports segur tipus Clave, connector Y tipus Clave, c ambra de degoteig filtre de 15 µ. punxó flascó, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible bomba Plum 360 o eq	

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3370	MATERIAL: 30053958
Descripció llarga:		
Línia 43 (+/-3)cm a/punxo+filtre venteig, connector en Y tipus Clave, filtre 0,2µ baixa afinitat a proteïnes hidrofòbic, và lvula antiretorn,connector Luer Lock a/tap a/filtre 1,2µ,s/làtex/DEHP,estèril ,env ind,lús.Compatible bomba Plum 360 o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3380	MATERIAL: 30053959
Descripció llarga:		
Línia de 41 (+/-3)cm opaca, per a fàrmacs fotosensibles, punxo amb filtre de venteig, connector en Y tipus Clave, ciamp, vàlvula ant iretorn, connector Luer Lock amb tap amb filtre 1,2 µ, s/làtex/DEHP, estèril, env ind, lús.Compatible bomba Plum 360 o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3390	MATERIAL: 30054032
Descripció llarga:		
Eq EV infusió PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, 2 ports "Y" (proximali distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 25(+/- 1)mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol,s/làtex/DEHP ,est,ind,lús.Compatible Alaris GP o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3400	MATERIAL: 30054086
Descripció llarga:		
Punxo/adaptador vial/flascó de 20 i 28mm, sist tancat sense agulla fàrmacs perillosos/quimioteràpia. Adaptador vial/flascó s/bloque ig, punxó, purg 0,18(+/-0,02)mL, filtre 0,2µm a/globus.Est,s/làt/DEHP,lús,env ind.Compat sist ChemoLock o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3410	MATERIAL: 30054160
Descripció llarga:		
Tub de plàstic, de 114 (+/-10)cm, Ø4mm, per a injector de contrast en RMN i TAC. Amb sensor de pressió i filtre de partícules. Conne xió Luer Lock. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb bomba XD8003 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3420	MATERIAL: 30054403
Descripció llarga:		
Eq EV sang/hemoderivats PVC 300 (+/-10) cm x 3mm, disc sensor pressió, segment bomba silicona, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 29 (+/-1)mL, connexió distal L-L mascle, tancament pinça,sense DEHP,estèril,envàs individual,lús.Compatible bomba Alaris o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3430	MATERIAL: 30054405
Descripció llarga:		
Eq infusió endovenós baixa absorció bomba volumètrica, PVC,transparent ,240(+/-10)cm longitud,cambra degoteig, segment de bomba, filt re 15 µ, volum de purga de 5 (+/-1)mL, punt injecció s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,lús. Compatible bomba Body Guard o eq		
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3440	MATERIAL: 30057648
Descripció llarga:		
Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, transparent, pressió màxima de 4 bars,PVC, 150(+/-10)cm, connexió a cada extrem L uer Lock mascle i femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq		

SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3450	MATERIAL: 30057649
Descripció llarga:	Línia prolongadora d'infusió per bomba de xeringa, fotoprotectora, pressió màxima de 4 bars,de PVC, de 200(+/-10)cm, connexió Luer Lock mascle i Luer Lock femella, s/làtex/ftalats, est, envàs ind, d'un sol ús. Compatible bomba xeringa Perfusor Space o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3460	MATERIAL: 30058498
Descripció llarga:	Xeringa 3cossos 50mL p/bomba infusió,LL central,cos transparent doble graduació inesborrable,topall seguretat,junta estanqueïtat.Est ,s/làtex/DEHP,lús,env ind.Compat a/bomba xeringa tipus Perfusor Space/altres bombes o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3470	MATERIAL: 30058623
Descripció llarga:	Equip per alleugeriment del dolor i la inflamació,per a neuroplastia percutània. Compost de: Catèter epidural semirrígid,flexible di rigible de Ø2,1x295mm de llarg,guia,introductor,agulla Ø2,8x91,2mm de llarg i estilet.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3480	MATERIAL: 30059439
Descripció llarga:	Eq inf EV bomba sang, clorur polivinil (PVC) transparent, 240(+/-10)cmlong, cambra degoteig, segment de bomba, filtre sang 18µ, volu m purga 6(+/-1)mL, punt injecció Y sense agulla, LL, s/làtex/DEHP ,est,lús.Compatible bomba BodyGuard Color Vision o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3490	MATERIAL: 30059524
Descripció llarga:	Eq EV bomba,baixa absorció,elastòmer termoplàstic (TPE),300(+/-10)cm ,sensor pressió,cambra degoteig filtre15µ+trocac x flascó/bossa, purga27(+/-1)mL, conn distal L-L,pinça segur,pinça cargol+pinça rodet,s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Alaris VP o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3500	MATERIAL: 30060144
Descripció llarga:	Línia prolongadora contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, 16bar(230 psi), Øintern 2,5mm x 250 (+/-10) cm de llarg, 2 vàlvules antiretorn, luer lock, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Comp injectors Ulrich o eq	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3510	MATERIAL: 30060233
Descripció llarga:	Sistema tancat per a recollida de teixit autòleg(cartilag i os) activat per succió, compatible amb artroscòpia per a recollida de teixit, amb cambra i filtre. Compatible amb sistema Angel cPRP o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101352897	POSICIÓ: 3520	MATERIAL: 30060234
Descripció llarga:	Sistema per a obtenció de sèrum autòleg de trombina,amb 2 connexions a xeringa,de vidre de borosilicat i plàstic,estèril,individual, un ús.Compatible amb sistema Angel cPRP o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 21.06.2023
HORA: 08:57:04
PÀGINA: 45 / 45

SOL.COMANDA: 1101352897 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 30060581

Descripció llarga:

Tubs a/3 punxons (1 de sèrum i 2 de contrast) amb tap protector, administració contrast TC/RM, plàstic flexible, transparent, 114 (+/-5)cm llarg, sensor pressions, filtre partícules, connexions LL, est, s/làtex, lús. Compatible a/injectors Ulrich CT MOTION o eq

ANNEX C – Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

Guía informativa de la ficha de la oferta técnica

Tal como se indica en el pliego, en el apartado 10.1.1, en este anexo se detalla la información de la ficha técnica electrónica individual del producto.

A continuació se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado de cada uno de ellos y, en algunos casos, se hacen indicaciones más específicas. Los datos con los que se deben completar estos campos se deben obtener del documento de oferta económica Licitacion1100XXXXXX.xls que se anexa en el anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de Contratación electrónica de la Generalitat de Catalunya, en el apartado documentación, dentro de la **Documentación** que hay en **1100XXXXXX MODELO OFERTA TÉCNICAS Y ECON.zip**

Muestra de la oferta económica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																			
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																																			
Empresa:																																							
NIF:																																							
Data																																							
Segell Empresa:																																							
Signatura:																																							
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																																			
Número oferta Variant:																																							
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat																				
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00																											
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00																											
2	0		670	30030982	Cànula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											

1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página para cada ficha técnica individual pero para aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
Área <i>DATOS DE LA LICITACIÓN</i>		
Esta área contiene: - Datos de identificación de la licitación - Datos de cada artículo detallado en el ANEXO D. SE LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS		
Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Núm. de expediente	Código numérico de la licitación	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta	
Código SAP	Código del material, cuando la licitación se presenta detallando este código	
Código Agrupador	Código que se utiliza cuando la licitación se presenta agrupando los materiales en un código, en lugar del código detalle del material	

(Continuación)

Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para licitaciones con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, a la oferta específica

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos *Descripción breve y ampliada del producto* que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de **su** producto y de **sus** datos técnicos, argumentada con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado

referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

referencia fabricante Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035 "/ 0,89mm
EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.
Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual
Descripción breve del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado	
Marcado CE / Tipo de clase	Marcado CE = SI Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcado. Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE Marcado CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO <u>Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 Lista Resumen.</u> Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el material
Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios	Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y / o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient							
CS/CC00/1101352897/23/AMUP		Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids							
Descripció codi SAP o codi Agrupador									
LOT		Tipus oferta							
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa		NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)	
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada							
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *				Mètode d'esterilització *			
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material							
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència							
Dades d'acreditacions									
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC		Logo de l'empresa							
Marcat CE/Tipus de classe		(SI/NO)							
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1691/2009 regulació prod sanitaris									
Altres acreditacions i/o auto certificació		Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material							

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient			Codi SAP				
CS/CC00/1101352897/23/AMUP		Subministrament agregat d'Equips d'infusió i altre material per a administració de fluids							
Descripció codi SAP o codi Agrupador					Codi Agrupador				
LOT					Tipus oferta				
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)	
Dades del producte específic									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *			Especificacions tècniques de la referència ofertada				
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció ampliada del producte									

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

(No hi ha)

ANNEX E1 - Presentació de mostres

(Es demanarà mostra via Mail per el Lot 13 una vegada es faci la valoració tècnica del Sobre 2)

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNumber	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gln	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND LING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND LING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDate	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDate	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDate	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Periodo de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDate Time	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDate Time	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad 1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - combustible I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno