

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 40000012

Descripció llarga:

Bobina de cel·lulosa de 500g. Gramatge mig de 288g/m2, 16 capes i de color blanc. Mesures: 20cm d'amplada i 875 cm de longitud..UNIT

Descripció tècnica:

Bobina de cel·lulosa de 500g. Gramatge mig de 288g/m2, 16 capes i de color blanc. Mesures: 20cm d'amplada i 875 cm de longitud.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 40000020

Descripció llarga:

Full bisturí nº 11.Fabricat en acer al carboni.Alta precisió,amb gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit.Ra nur a per incorporar a mànec de bisturí convencional.Mesures:5,2mm amplada/42,8mm de llargada.Estèril.D'un sol ús..UNIT

Descripció tècnica:

Full bisturí nº 11. Full tallant d'acer al carboni d'alta precisió, amb gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit . Amb ranur a per incorporar a mànec de bisturí convencional. Mesures: 5,2 mm amplad a, 42,8 mm de llargada. Estèril i d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 40000021

Descripció llarga:

Full bisturí nº 21.Fabricat en acer al carboni.Alta precisió,amb gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit.Ra nur a per incorporar a mànec de bisturí convencional.Mesures:9,7mm amplada/53mm de llargada.Estèril.D'un sol ús.C.UNIT

Descripció tècnica:

Full bisturí nº 21. Full tallant d'acer al carboni d'alta precisió, amb gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit . Amb ranur a per incorporar a mànec de bisturí convencional. Mesures: 9,7 mm amplad a, 53 mm llargada. Estèril i d'un sol ús.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 40000041

Descripció llarga:

Equip d'extracció de sang de 70cm amb agulla pels dos costats.Compost per dues agulles d'acer inoxidable siliconat amb punta bisella da i triple facetat,amb dispositiu de protecció i separades per un tubuladura de PVC de 70cm amb clamp.Estèril..UNIT

Descripció tècnica:

Equip d'extracció de sang de 70cm amb agulla pels dos costats. Compost p er dues agulles de punta bisellada i triple facetat d'acer i noxidable d e grau mèdic siliconat, amb dispositiu de protector d'agulla en polietil è i separades per un tub perllongador de clorur d e polivinil amb clamp de 70cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 40000165

Descripció llarga:

Proveta vidre borosilicat 3,3 clase B , de 250ml.Graduació nítida i visible cada 2ml.Tolerància: +/- 2ml. Mesures aproximades: 43mm de diàmetre i 305mm d'alçada. Calibrat per contenir TC, In. Base hexagonal.Normativa: ISO 4788.No estèril.UNIT

Descripció tècnica:

Proveta vidre borosilicat 3,3 clase B , de 250ml.Graduació nítida i visi ble cada 2ml.Tolerància: +/- 2ml. Mesures aproximades: 43mm de diàmetre i 305mm d'alçada. Calibrat per contenir TC, In. Base hexagonal.Normativa : ISO 4788.No estèril.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 40000166

Descripció llarga:

Proveta vidre borosilicat 3,3 classe B , de 1000ml.Graduació nítida i visible cada 10ml.Tolerància: +/- 10ml. Mesures aproximades: 68 mm de diàmetre i 440mm d'alçada. Calibrat per contenir TC, In. Base hexagonal.Normativa: ISO 4788.No estèril.UNIT

Descripció tècnica:

Proveta vidre borosilicat 3,3 classe B , de 1000ml.Graduació nítida i vis ible cada 10ml.Tolerància: +/- 10ml. Mesures aproximades: 68mm de diàmetre i 440mm d'alçada. Calibrat per contenir TC, In. Base hexagonal.Normativa: ISO 4788.No estèril.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 40000336

Descripció llarga:

Tub de PS transparent de 5ml, amb fons rodó i tap pressió.Mesures: 75x13 mm. No estèril. No graduat. Resisitencia a cen trifugacions de fins a 4000RCF_{xg}.Presentació 1000 unitats.UNIT

Descripció tècnica:

Tub de PS transparent de 5ml, amb fons rodó i tap pressió.Mesures: 75x13 mm. No estèril. No graduat. Resisitencia a cen trifugacions de fins a 4000RCF_{xg}.Presentació 1000 unitats.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 40000793

Descripció llarga:

Bisturí complet nº10.Mànec de plàstic de grau mèdic.Fulla tallant d'acer inoxidable d'alta precisió. Mesures: Full del nº10 (7,8 mm d'amplada, 42,8 mm de llargada), maneg i capçal de 13 cm. Estèril i d'un sol ús..UNIT

Descripció tècnica:

Bisturí complet nº10 .Bisturí amb mànec de plàstic rígid de grau mèdic, amb fulla tallant d'acer inoxidable d'alta precisió incorpor ada, gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit. Mesures: Full de l nº10 (7,8 mm d'amplada, 42,8 mm de llargada), maneg i capçal de 13 cm . Estèril i d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 40000830

Descripció llarga:

Tub de polipropilè transparent de 5 ml, de fons rodó i tap a pressió.Mesures:12x75mm. No estèril. No graduat. Resisitencia a cen trifugacions de fins a 5000RCF_{xg}.Presentació 500 unitats.UNIT

Descripció tècnica:

Tub de polipropilè transparent de 5 ml, de fons rodó i tap a pressió.Mesures:12x75mm. No estèril. No graduat. Resisitencia a cen trifugacions de fins a 5000RCF_{xg}.Presentació 500 unitats.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 40001051

Descripció llarga:

Termometre de vidre en forma de vareta de bany.Graduació:-10°C/+110°C.Mesures:300mm.Subdivisió per cada 1 °C. Immersió parcial.Sense mercuri.UNIT

Descripció tècnica:

Termometre de vidre en forma de vareta de bany.Graduació:-10°C/+110°C.Me sures:300mm.Subdivisió per cada 1 °C. Inmersió parcial.Sense mercuri.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 40001080

Descripció llarga:

Equip de transferència de cèl·lules mare de 250ml,estèril.Kit pel rentat i infusió de CM.Compost de 2 bosses de PVC unides per un tu b d'EVA.De la bossa mare surt una línia amb 3 connexions en "Y"(dos spikes i un luer femella).Presentació individual.C.UNIT

Descripció tècnica:

Equip de transferència de cèl·lules mare de 250ml, estèril. Kit de bosse s pel rentat i d'infusió de sang de cordó. Kit compost de:2 bosses de PV C de 250ml (unides per una tubuladura amb regulador de flux i port d'inj eccions), i tubuladura, amb clamp i port d'injeccions, en Y (dos perfora dors i un luer-lock femella) amb clamps en cadascun d'ells.C.Empaquetame nt individual.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 40001128

Descripció llarga:

Allargadera de PVC transparent en Y amb 2 connexions luerlock femella i 1 connexió luerlock mascle.Longitud:18cm/diàmetre intern:3m m/diametre extern:4mm/Resistència presió màxia:1bar/Volum mort:2,035ml.No DEHP.Estèril.Presentació 200 unitats. C.

Descripció tècnica:

Allargadera de PVC transparent en Y amb 2 connexions luerlock femella i 1 connexió luerlock mascle mascle. Longitud: 18cm /diàmetre intern:3mm /diametre extern:4mm / Resistència presió màxia: 1 bar / Volum mort: 2,0 35ml. Sense DEHP. Estèril. Presentació 200 unitats. C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 40001138

Descripció llarga:

Escovilló de fusta amb cap de cotó.Vareta de fusta,amb unes mesures de 150 x 2,2 mm,amb tampó de cotó arrodonit de 5mm de diàmetre a l'extrem.Indicat per la presa de mostres biològiques sense deixar fibres ni restes.No estèril.

Descripció tècnica:

Escovilló de fusta amb cap de cotó. Vareta allargada i estreta de fusta, amb unes mesures de 150 x 2,2 mm, amb extrem proximal acaba t en petit tampó de cotó arrodonit, amb un diàmetre de 5 mm. Indiat per la presa de mostres biològiques sense deixar fibres ni res tes. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 40001234

Descripció llarga:

Clau de tres vies de pas,amb una connexió mascle i dos femelles, una de les femelles amb valvula de seguretat. Composta de plàst ic rígid, amb connexions Luer-Lock. Resistència a lípids i als antisèptics.UNIT

Descripció tècnica:

Clau de 3 vies amb valvula de seguretat en una de les seves connexions fe mella, estèril. Clau de tres vies de pas, un mascle i dos femelles, una d'elles amb valvula de seguretat. Composta de plàstic rígid, amb connexi ons Luer-Lock. Resistència a lípids i als antisèptics.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 40002006

Descripció llarga:

Equip de transferència de PVC.Compost de:Perforador,port de connexió sense agulla,tubuladura i connexió luer mascle.Longitud total d e 31 cm,volum d purga de 2,3 ml i diàmetre de 3mm. Sense làtex ni DEHP. Presentació de 100 unitats.C.

Descripció tècnica:

Equip de transferència de PVC, compost d'un perforador amb presa d'aire, port de connexió sense agulla en Y amb vàlvula de seguretat, tubuladura , amb clamp de pinça, i connexió luer mascle.Longitud total de 31 cm,volum de purga de 2,3 ml i diàmetre de 3mm. Sense làtex ni DEHP.C.Presentació de 100 unitats.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 40002007

Descripció llarga:

Tubuladura de 50cm amb connexió mascle Luer-Lock per un extrem i connexió femella Luer-Lock per l'altra.Diàmetre (int:3mm i ext:4,1mm)/Volum residual:3,7ml/Resistencia màxima:1 bar.Tubuladura composta de PVC transparent sense DEHP.No làtex. Estèril.C.UNIT

Descripció tècnica:

Tubuladura de 50 cm amb connexió mascle Luer-Lock per un extrem i connexió femella Luer-Lock per l'altra extrem.Diàmetre intern (3 mm), diàmetre extern (4,1mm), volum residual (3,7ml) i força de resistència màxima (1 bar). Tubuladura composta de clorur de polivinil transparent sense DEHP , sense làtex.C.Estèril.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 40002569

Descripció llarga:

Equip de transferència de 2 vies, sense latex. Compost per dos perforadors en Y, clamp pla blanc i una tubuladura de cloruri vinil que desemboca en luer-lock mascle, i tub de 2,9x4,1x150 mm. Estèril.C.UNIT

Descripció tècnica:

Equip de transferència , sense latex. Compost per dos perforadors en Y, clamp pla blanc i una tubuladura de clorur de polivinil que desemboca en luer-lock mascle, i tub de 2,9x4,1x150 mm.C.Estèril

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 40002571

Descripció llarga:

Equip transferència,de PVC,de 4 línies en Y amb 8 connexions amb clamps.Connexions:4 punxons(un amb presa d'aire) i 4 connexions Luer-Lock(3 mascles i 1 femella).Regulador de fluxe.Longitud 71cm.Volum purga 5ml.Estèril.No làtex ni DEHP.Presentació 50 U.C.

Descripció tècnica:

Equip de transferència, de PVC, de 4 línies en Y amb 8 connexions, amb clamps de pinça. Connexions: 4 punxons (un amb presa d'aire) i 4 connexions Luer-Lock (3 mascles i 1 femella).Amb regulador de fluxe al centre de l kit. Longitud total 71 cm.Volum de purga 5ml. Estèril. Sense làtex ni DEHP. Presentació 50 unitats.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 40002580

Descripció llarga:

Joc roba pel llit.Fabricat de tpe de PP.Joc compost de:Llençol ajustable amb 2 elàstics (240x120cm),Llençol (220x140cm) i funda de cotó (100x40cm).Gramatge de 20g/m2.Transpirable i resistent.Presentació individual.Un sol ús.

Descripció tècnica:

Joc roba pel llit. Fabricat de teixit sense teixir de polipropilè de col or blau. Joc compost de: Llençol ajustable amb 2 elàstics pel llit (240x 120 cm), Llençol de sobre el llit (220x140 cm) i funda de coixi (100x40 cm). Tot el joc té un gramatge de 20g/m2. Transpirable i resistent. Pre sentació individual. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 40002977

Descripció llarga:

Punta de pipeta universal, amb filtre, extra llarga, d'un volum de 200 µl. Estèril. Lliure de DNasa i RNasa. Longitud de 9,12 cm. Pr esentades en racks de 96 puntes.CAIX de 768 UNIT

Descripció tècnica:

Punta de pipeta universal, amb filtre, extra llarga, d'un volum de 20-20 0 µl. Estèril. Presentades en racks de 96 puntes. Amb una lo ngitud de 9 ,12 cm. Barrera hidròfoba i amb filtre d'estructura porosa que evita qua lsevol contaminant amb aerosols i líquids.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 40003138

Descripció llarga:

Flascó de polietilè tereftalat de glicol, graduat, amb boca estreta i taps de rosca de polietilè d'alta densitat. Base quadrada. Amb un volum de 2000ml i un diàmetre intern del coll de 37mm. Resitència a temperatures de -40°C fins 60°C. Estèril.

Descripció tècnica:

Flascó de polietilè tereftalat de glicol, graduat, amb boca estreta i ta ps de rosca de polietilè d'alta densitat. Base quadrada. Amb un volum de 2000ml i un diàmetre intern del coll de 37mm. Resitència a temperature s de -40°C fins 60°C. Estèril.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 40003166

Descripció llarga:

Làmina silicona no adhesiva per placa PCR. Pel segellat/tancament de plaques de 96 pous(127x85mm). Pel·lícula extraïble. Resistè nci a T° de 52°C. No DNasa,RNasa ni ADN humà.Compatible amb assajos amb microesferes fluorescents.C.CAIX 50 UNIT

Descripció tècnica:

Làmina de silicona no adhesiva per placa PCR amb pel·lícula extraïble, l liure de DNasa, RNasa i ADN humà. Làmina pel segellat i tanc ament de pl aques de 96 pous, que suporti temperatures de fins a 52°C. Compatible am b plaques d' hibridació per Luminex.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 40003349

Descripció llarga:

Filtre de transfusió amb malla de poliester de 40µm.Pre-sistema de filtre per a la separació de cèl·lules. Volum de retenció residu al (20ml). Àrea de filtració (161cm2). Estèril.Presentació 40 unitats.UNIT

Descripció tècnica:

Filtre de transfusió amb malla de poliester de 40µm.Pre-sistema de filt re per a la separació de cèl·lules. Volum de retenció residual (20ml). À rea de filtració (161cm2). Estèril.Presentació 40 unitats.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 40003475

Descripció llarga:

Punta de pipeta de 300µl, sense filtre. Compatible amb pipetes Rainin. Mesures: 60mm de longitud. Amb sistema per reduir l'esforç de pressió. Presentades en racks amb frontisses i antiaixecament. Esterelitzable en autoclau. CAIX de 8 RACK de 96 UNIT

Descripció tècnica:

Punta de pipeta compatible amb pipetes Rainin, d'un volum de 300µl. Sen se filtre, no estèril. Mesures: 60mm de longitud. Amb sistema per reduir l'esforç de pressió. Presentades en racks de 96 puntes. Racks amb fron tisses i antiaixecament, també disposa de pestanya davantera per facilit ar l maneig. Esterelitzable en autoclau.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 40003477

Descripció llarga:

Làmina gel per equip descongelació cèl·lules mare crioconservades del sistema SAHARA-TSC. Mesures:16x23,5cm. Presentació 5 unitats.

Descripció tècnica:

Làmina gel per equip descongelació cèl·lules mare crioconservades del si stema SAHARA-TSC. Mesures:16x23,5cm. Presentació 5 unitats.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 40003565

Descripció llarga:

Tap d'alumini, tipus volandera, de 20mm de diàmetre i 8mm d'alçada. Pel tancament hermètic d'un vial de vidre amb productes farm ace utic liofilitzat.C.UNIT

Descripció tècnica:

Tap d'alumini, tipus volandera, de 20mm de diàmetre i 8mm d'alçada. Pel tancament hermètic d'un vial de vidre amb productes farm aceutic liofili tzat.C.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 40003566

Descripció llarga:

Vial de vidre transparent 23mm de diàmetre i 46mm d'alçada. Destinat a emmagatzemar productes farmaceutics liofilitzats.C.UNIT

Descripció tècnica:

Vial de vidre transparent 23mm de diàmetre i 46mm d'alçada. Destinat a e mmagatzemar productes farmaceutics liofilitzats.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 40003567

Descripció llarga:

Tap de silicona o similar, en forma circular per vial. Mesures: diàmetre extern 2 cm, diametre intern 1,3 cm i longitud 1,6 cm. Pres entació 1250 unitats.C.UNIT

Descripció tècnica:

Tap de silicona o similar, en forma circular per vial. Mesures: diàmetre extern 2 cm, diametre intern 1,3 cm i longitud 1,6 cm. Presentació 1250 unitats.C.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 40003578

Descripció llarga:

Unitat filtració amb membrana de PVDF.Mesures:Porositat(0,22µm),diàmetre membrana(73mm),vol max.(1000ml),àrea filtració(40cm2).Compo st d'un receptor de filtració,un flascó d'emmagatzematge i un filtre al mig.Estèril.Envàs individual.Presentació 12 U.UNIT

Descripció tècnica:

Unitat de filtració amb membrana de PVDF de 0,22µm i una superfície de f iltratge de 40cm2. L'ampolla receptora disposa d'un volum de 1000ml amb laterals per la facilitat de subjecció. Estèril i envasat individualment . Sistema de filtració al buit combina un filtre dampolla amb un recepto r de filtració i un flascó d'emmagatzematge. L'ampolla receptora de filt ració té un disseny en forma de matràs. Les aplicacions inclouen l'ester ilització de medis de cultiu de teixits i additius, solucions de proteïn es, suspensions de virus, ADN i altres solucions aquoses.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 40003599

Descripció llarga:

Escuma encunyada amb unes mesures de 22 x 22 x 5 cm. Es troben dos talls al centre del quadrat i dos cercles a cada costat. Ús pel t ransport i protecció de les còrnies.

Descripció tècnica:

Escuma encunyada amb unes mesures de 22 x 22 x 5 cm. Es troben dos talls al centre del quadrat i dos cercles a cada costat. Ús pel transport i p rotecció de les còrnies.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 40003608

Descripció llarga:

Filtre de membrana d'èsters barrejats de cel·lulosa hidròfila.Mesures:Porositat(0,45µm),diàmetre(25mm),índex de refracció(1.51), gru ix(150 µm).Estèril.No surfactants.Apte per mètodes d'esterilització d'òxid d'etilè,gamma,i autoclau.Presentació 100.UNIT

Descripció tècnica:

Filtre de membrana de nitrat de cel·lulosa i acetat de cel·lulosa, amb u na porositat de 0,45µm i un diàmetre de disc de 25 mm, estèr il. Sense s urfactants. Compatible amb mètodes d'esterilització d'òxid d'etilè, gamm a, i autoclau. Mètode de detecció Cromogènic Radi actiu Fluorescent. Tem peratura de funcionament màxima 75 ° C. Aplicacions per colonies / plaqu es de lisis, transferència en poue cultiu cel·lular, clarificació de sol ucions aquoses.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 40003612

Descripció llarga:

Blister de PETG termoconformat de 1,5mm de gruix.Envàs de dos peces de plàstic transparent,encaixables entre si,amb forma de pr ism e rectangular.Vores aplanades,amb vertex arrodonit.Mesures aprox:envàs primari 14x11x5cm/envàs secundari 11x7,5x5cm.C.UNIT

Descripció tècnica:

Blister de PETG termoconformat de 1,5mm de gruix. Envàs compost de dos peces de plàstic transparent, encaixables entre si, amb form a de prisme rectangular. Vores aplanades d' un cm (una de les vores del envàs secun dari és irregular), amb tots els vertex arrodonit menys un per facilita r l'obertura. Les mesures aproximades amb vores: envàs primari 14 x 11 x 5 / envàs secundari 11 x 7,5 x 5.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 40003618

Descripció llarga:

Talla estèril impermeable de 90 x 150 cm. Talla composta de 2 capes mitjançant sistema de laminació, una de polipropilè hidròfil abs orbent i un altra de polietilè impermeable. Empaquetament individual.

Descripció tècnica:

Talla estèril impermeable de 90 x 150 cm. Talla composta de 2 capes mitj ançant sistema de laminació, una de polipropilè hidròfil absorbent i un altra de polietilè impermeable. Empaquetament individual.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 40003620

Descripció llarga:

Llençol de teixit sense teixir de polipropilè (FISELINA). Multifilaments termosegellats. Propietats hidrofíles i hidrofobes. Alta re sistència a factors químics i físics. No deixa residus. Mesures de 75 x 200 cm. No tòxic ni al·lèrgic.

Descripció tècnica:

Llençol de teixit sense teixir de polipropilè (FISELINA). Multifilaments termosegellats. Propietats hidrofíles i hidrofobes. Alta resistència a factors químics i físics. No deixa residus. Mesures de 75 x 200 cm. No t òxic ni al·lèrgic.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 40003657

Descripció llarga:

Terminal d'irrigació compatible amb pistola Inter Pulse d' Stryker pel rentat del canal femoral. Terminal cònic amb protector in cor porat per evitar les esquitxades i no malmetre el teixit. Irrigació. Estèril. D'un sol ús..UNIT

Descripció tècnica:

Terminal d'irrigació compatible amb pistola Stryker pel rentat del canal femoral. Terminal de plàstic cònic amb protector incorporat per evitar les esquitxades i no malmetre el teixit. Compatible amb la pistola Inter Pulse d' Stryker de rentat a pressió. Irrigació. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 40003666

Descripció llarga:

Flascó de 100ml, fabricat en PVC transparent. Amb la boca ampla, tap a rosca i obturador. Mesures aprox: 4,5cm d'alçada i 6cm d e d iàmetre. Presentació 200 unitats.UNIT

Descripció tècnica:

Flascó de 100ml, fabricat en PVC transparent. Amb la boca ampla, tap a rosca i obturador. Mesures aprox: 4,5cm d'alçada i 6cm d e d iàmetre. Pre sentació 200 unitats.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 40003670

Descripció llarga:

Flascó de vidre transparent amb tapa a rosca de 2000ml. Coll ample. Mesures aproximades: 20 cm d'alçada, 12 cm de diàmetre i 10 cm de diàmetre del coll. Utilitzat per a l'emmagatzematge de materials.UNIT

Descripció tècnica:

Flascó de vidre transparent amb tapa a rosca de 2000ml. Coll ample. Mes ures aproximades: 20 cm d'alçada, 12 cm de diàmetre i 10 cm de diàmetre del coll. Utilitzat per a l'emmagatzematge de materials.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 40003713

Descripció llarga:

Plat alumini 10cm de diàmetres i 1cm d'alçada. Un sol ús. Platet d'alumini, un sol ús. Per calcular el contingut d'humitat de les mostres. Presentació 500unitats.UNIT

Descripció tècnica:

Plat alumini 10cm de diàmetres i 1cm d'alçada. Un sol ús. Platet d'alumini, un sol ús. Per calcular el contingut d'humitat de les mostres. Presentació 500unitats.UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 40003715

Descripció llarga:

Trehalosa dihidrat solució 1M. C12H22O11·2H2O. Estèril. Lliure de Dnasa i Rnasa. Presentació de 500ml.FLAS de 500 ML

Descripció tècnica:

Trehalosa dihidrat solució 1M. C12H22O11·2H2O. Estèril. Lliure de Dnasa i Rnasa. Presentació de 500ml.FLAS de 500 ML

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 40003749

Descripció llarga:

Bossa de transferència de PVC de 1L.Disposa de 2 tubuladures de PVC de 75cm amb punxons a l'extrem i clamps de pinça. La bossa també disposa de 2 ports per a punxons protegits amb llengüetes.Resistent a la centrifugació.Estèril.C.UNIT

Descripció tècnica:

Bossa de transferència de PVC plastificada amb BTHC de 1000ml. Bossa composta de dues tubuladures de PVC plastificat amb DEHP de 75 cm amb punxons a l'extrem i clamps de pinça. La bossa també disposa dos ports per a punxons protegits amb llengüetes. Resistent a la centrifugació.C.Estèril.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 40003755

Descripció llarga:

Punta de pipeta de 20µl, amb filtres i estèrils. Compatible amb pipetes Rainin. Baixa retenció. Amb sistema de reduir l'esforç de pressió.Lliure de Dnasa i RNasa. Presentades en racks.CAIX de 960 UNIT

Descripció tècnica:

Punta de pipeta de 20µl, amb filtres i estèrils. Compatible amb pipetes Rainin. Baixa retenció. Amb sistema de reduir l'esforç de pressió.Lliure de Dnasa i RNasa. Presentades en racks.CAIX de 960 UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 40004144

Descripció llarga:

Equip de preparació, conservació d'aliquotes de gotes ulls de hemocomponents. Compost de 20 ampolles de PVC amb capacitat per 1,45 ml (45 gotes de 0,031ml/ampolla), xeringa de 20/30ml, clamps, tubladures, connectors i filtres. Recipient isotermic. Estèril. C.

Descripció tècnica:

Kit per la preparació d'aliquotes de gotes per als ulls amb hemocomponents. Equip compost de 20 ampolles per preparar, conservar i emmagatzemar hemocomponents, 2 claus de 3 passos (una amb línia amb filtre d'aire hi dròfob i antibacterià amb connexió luer-lock, i l'altra amb línia amb clau i connexió luerlock per la transferència desde la bossa) connectades a una xeringa de 20/30 ml. També disposa d'un recipient isotèrmic per transport. Ampolles de PVC sense DOP ni DEHP amb capacitat per 1,45 ml. 45 gotes d'un volum de 0,031ml per ampolla. Estèril. Sense làtex. C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 40004154

Descripció llarga:

Manta de polièster de color vermell o fosc, amb unes mesures de 150 x 200 cm. Amb un gramatge de 80 g /m2. D'un sol ús, no estèril.

Descripció tècnica:

Manta de polièster de color vermell o fosc, amb unes mesures de 150 x 200 cm. Amb un gramatge de 80 g /m2. D'un sol ús, no estèril.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 40004355

Descripció llarga:

Nansa digralsky, de PS, pel cultiu cel·lular. Amb la superfície tractada. En forma de L. Mesures: 145 x 38 mm. Estèril. Envàs individual. UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 40004622

Descripció llarga:

Mopa desechable d'un sol ús en teixit 100% polièster multicapa. Estèril. Mesures: 12 x 40,5 cm / 52g. Absorció: 225ml. Presentació 100 unitats. C. UNIT

Descripció tècnica:

Mopa desechable d'un sol ús en teixit 100% polièster multicapa. Estèril. Mesures: 12 x 40,5 cm / 52g. Absorció: 225ml. Presentació 100 unitats. C. UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 40004784

Descripció llarga:

Tub de 50ml, fabricat en PP, facilita l'aïllament de PBMCs mitjançant gradients de densitat. Mostra inicial: 4-17ml, segons hematies empaquetats: 2-17ml, respectivament, i volum gradient de densitat: 15ml. Diagnòstic in vitro. Estèril. C. BOSS de 500 UNIT

Descripció tècnica:

Tub de 50ml, fabricat en PP, facilita l'aïllament de PBMCs mitjançant gradients de densitat. Mostra inicial: 4-17ml, segons hematies empaquetats: 2-17ml, respectivament, i volum gradient de densitat: 15ml. Diagnòstic in vitro. Estèril. C. BOSS de 500 UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 40005450

Descripció llarga:

Filtre de gassos amb membrana de PTFE hidrofobic.Porositat:0,2µm.Diàmetre:64mm.Volum:3ml.Àrea de filtració:20cm2.Resistencia a pressions de 3 bar.Connexions estriades.Estèril.Autoclavable:20 cicles a 134 °C,2bar.USP clase VI.C.CAIX de 25 UNIT

Descripció tècnica:

Filtre de gassos amb membrana de PTFE hidrofobic.Porositat:0,2µm.Diàmetre:64mm.Volum:3ml.Àrea de filtració:20cm2.Resistencia a pressions de 3 bar.Connexions estriades.Estèril.Autoclavable:20 cicles a 134 °C,2bar.USP clase VI.C.CAIX de 25 UNIT

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 40006119

Descripció llarga:

Tap d'alumini i silicona gas-permeable, compatible amb TISSUE-C (medi pel cultiu de còrnies).Permet l'intercanvi gasós.Rosca d'alumini i goma d'alumini central extraïble.Diàmetre 36mm.No estèril.Presentació 100 rosques d'alumini + 100 taps de silicona.

Descripció tècnica:

Tap d'alumini i silicona gas-permeable, compatible amb TISSUE-C (medi pel cultiu de còrnies).Permet l'intercanvi gasós. Rosca d'alumini i goma d'alumini central extraïble. Diàmetre 36mm. No estèril. Presentació 100 rosques d'alumini + 100 taps de silicona.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 40006793

Descripció llarga:

Kit per la preparació d'aliquotes d'hemocomponents.Kit compost de 12 bosses de 20 ml. Cada bossa disposa d'un punt d'injecció i està connectada de dos en dos per tubuladures. Resistents a temperatures inferiors a -80°C. Estèril. Caixes de 6 kits.C.

Descripció tècnica:

Kit per la preparació d'aliquotes d'hemocomponents.Kit compost de 12 bosses de 20 ml. Cada bossa disposa d'un punt d'injecció i està connectada de dos en dos per tubuladures. Resistents a temperatures inferiors a - 80°C. Estèril. Caixes de 6 kits.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 40006856

Descripció llarga:

Bossa EVA multicapa de 2L per nutrició parenteral per gravetat.Buida.Compatible amb màquina omplidora.Connector Luer Lock femella amb clamp de seguretat al port d'ompliment,punt d'aditivació i port per punxons.No Làtex/DEHP.Estèril.C.Presentació 30 U

Descripció tècnica:

Bossa EVA multicapa per la nutrició parenteral per gravetat de 2L. Buida . Compatible amb màquina omplidora.Disposa de connector Luer Lock femella amb clamp de seguretat al port d'ompliment, punt d'aditivació i port per punxons .Sense Làtex ni DEHP. Estèril.Un sol ús.Presentació 30 unitats.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 40006884

Descripció llarga:

Bossa EVA multicapa de 1L per nutrició parenteral per gravetat.Buida.Compatible amb màquina omplidora.Connector Luer Lock femella amb clamp de seguretat al port d'ompliment,punt d'aditivació i port per punxons.No Làtex/DEHP.Estèril.C.Presentació 30 U

Descripció tècnica:

Bossa EVA multicapa per la nutrició parenteral per gravetat de 1L. Buida . Compatible amb màquina omplidora.Disposa de connector Luer Lock femella amb clamp de seguretat al port d'ompliment, punt d'aditivació i port per a punxons .Sense Làtex ni DEHP. Estèril.Un sol ús.Presentació 30 unitats.C.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 40006945

Descripció llarga:

Bossa de 25ml per criopreservació de SCU.Disposa de 2 compartiments amb ports per punxó,que permet l'aliqotació.Tubuladura amb clamp i punxó.Apte per congelació amb nitrogen líquid.Resistent DMSO.Compatible Set Sepax-Bioarchivo.Presentació 48 unitats.C.

Descripció tècnica:

Bossa de 25ml per la criopreservació de sang de cordó.Bossa dividida en 2 compartiments amb ports per punxó en cada compartiment, que permeten l'aliqotació. Disposa de tubuladura amb clamp i punxó. Apte per la congelacióamb nitrogen líquid. Resistent a DMSO.Compatible amb Set Sepax-Bioarchivo.C.Presentació 48 unitats.

SOL.COMANDA: 1100004717 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 40007245

Descripció llarga:

Placa de cultiu de Teixits amb tapa.Mesures: Diàmetre (32,8mm) / Superfície (8,5cm2). Apte per la valoració y transport de la cornea . diàm. Estèril.C.Paquets de 10 unitats.

Descripció tècnica:

Placa petri pel cultiu de Teixits amb tapa.Mesures: Diàmetre (32,8mm) / Superfície (8,5cm2). Apte per la valoració y transport de la cornea. Estèril.C.Paquets de 10 unitats.

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 001 Material de vidre de laboratori**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000165	Proveta vidre borosilicat 3,3 clase B , de 250ml.Graduació nítida i visible cada 2ml.Tolerància: +/- 2ml. Mesures aproximades: 43mm de diàmetre i 305mm d'alçada. Calibrat per contenir TC, In. Base hexagonal.Normativa: ISO 4788.No estèril.UNIT	UN	1,000	11,603900	9,590000	11,60	9,59	21
40000166	Proveta vidre borosilicat 3,3 clase B , de 1000ml.Graduació nítida i visible cada 10ml.Tolerància: +/- 10ml. Mesures aproximades: 68mm de diàmetre i 440mm d'alçada. Calibrat per contenir TC, In. Base hexagonal.Normativa: ISO 4788.No estèril.UNIT	UN	1,000	29,995900	24,790000	30,00	24,79	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003670	Flascó de vidre transparent amb tapa a rosca de 2000ml. Coll ample. Mesures aproximades: 20 cm d'alçada, 12 cm de diàmetre i 10 cm de diàmetre del coll. Utilitzat per a l'emmagatzematge de materials.UNIT	UN	90,000	4,836975	3,997500	435,33	359,78	21

Total partida amb iva:	476,93
Total partida sense iva:	394,16
Total lot amb iva:	476,93
Total lot sense iva:	394,16

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 002 Material de plàstic de laboratori**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000336	Tub de PS transparent de 5ml, amb fons rodó i tap pressió.Mesures: 75x13 mm. No estèril. No graduat. Resisitencia a cen trifugacions de fins a 4000RCFyg.Presentació 1000 unitats.UNIT	UN	10.000,000	0,027830	0,023000	278,30	230,00	21
40000830	Tub de polipropilè transparent de 5 ml, de fons rodó i tap a pressió.Mesures:12x75mm . No estèril. No graduat. Resisitencia a cen trifugacions de fins a 5000RCFyg.Presentació 500 unitats.UNIT	UN	52.000,000	0,048400	0,040000	2.516,80	2.080,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003138	Flascó de polietilè tereftalat de glicol, graduat, amb boca estreta i taps de rosca de polietilè d'alta densitat. Base quadrada. Amb un volum de 2000ml i un diàmetre intern del coll de 37mm. Resistència a temperatures de -40°C fins 60°C. Estèril.	UN	1.000,000	24,348225	20,122500	24.348,23	20.122,50	21
40003612	Blíster de PETG termoconformat de 1,5mm de gruix.Envàs de dos peces de plàstic transparent, encaixables entre si, amb forma de prisme rectangular.Vores aplanades, amb vertex arrodonit.Mesures aprox:envàs primari 14x11x5cm/envàs secundari 11x7,5x5cm.C.UNIT	UN	5.500,000	5,650700	4,670000	31.078,85	25.685,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003666	Flascó de 100ml, fabricat en PVC transparent. Amb la boca ampla, tap a rosca i obturador. Mesures aprox: 4,5cm d'alçada i 6cm d e diàmetre. Presentació 200 unitats.UNIT	UN	2.000,000	1,851300	1,530000	3.702,60	3.060,00	21

Total partida amb iva:	61.924,78
Total partida sense iva:	51.177,50
Total lot amb iva:	61.924,78
Total lot sense iva:	51.177,50

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 003 Punes de pipeta**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002977	Punta de pipeta universal, amb filtre, extra llarga, d'un volum de 200 µl. Estèril. Lliure de DNasa i RNasa. Longitud de 9,12 cm. Presentades en racks de 96 puntes.CAIX de 768 UNIT	UN	7.680,000	0,375100	0,310000	2.880,77	2.380,80	21
40003475	Punta de pipeta de 300µl, sense filtre. Compatible amb pipetes Rainin.Mesures: 60mm de longitud. Amb sistema per reduir l'esforç de pressió. Presentades en racks amb frontisses i antiaixecament.Esterelitzable en autoclau..CAIX de 8 RACK de 96 UNIT	UN	122.880,000	0,096800	0,080000	11.894,78	9.830,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003755	Punta de pipeta de 20µl, amb filtres i estèrils. Compatible amb pipetes Rainin. Baixa retenció. Amb sistema de reduir l'esforç de pressió.Lliure de Dnasa i RNasa. Presentades en racks.CAIX de 960 UNIT	UN	4.800,000	0,181500	0,150000	871,20	720,00	21

Total partida amb iva:	15.646,75
Total partida sense iva:	12.931,20
Total lot amb iva:	15.646,75
Total lot sense iva:	12.931,20

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 004 Material de filtració**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003578	Unitat filtració amb membrana de PVDF.Mesures:Porositat(0,22µm),diàmetre membrana(73mm),vol max.(1000ml),àrea filtració(40cm2).Compos t d'un receptor de filtració,un flascó d'emmagatzematge i un filtre al mig.Estèril.Envàs individual.Presentació 12 U.UNIT	UN	204,000	26,216586	21,666600	5.348,19	4.419,99	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003608	Filtre de membrana d'èsters barrejats de cel·lulosa hidròfila.Mesures:Porositat (0,45µm),diàmetre (25mm),índex de refracció (1.51), gruix (150 µm).Estèril.No surfactants.Apte per mètodes d'esterilització d'òxid d'etilè,gamma,i autoclau.Presentació 100.UNIT	UN	1.000,000	1,878525	1,552500	1.878,53	1.552,50	21
40005450	Filtre de gassos amb membrana de PTFE hidrofòbic.Porositat:0,2µm.Diàmetre:64mm.Volum:3ml.Àrea de filtració:20cm2.Resistència a pressions de 3 bar.Connexions estriades.Estèril.Autoclavable:20 cicles a 134 °C,2bar.USP classe VI.C.CAIX de 25 UNIT	UN	25,000	11,422400	9,440000	285,56	236,00	21

Total partida amb iva: 7.512,28

Total partida sense iva: 6.208,49

Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:	7.512,28
Total lot sense iva:	6.208,49

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 005 Altra material de laboratori**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40001051	Termometre de vidre en forma de vareta de bany.Graduació:-10°C/+110°C.Mesures:300 mm.Subdivisió per cada 1 °C. Immersió parcial.Sense mercuri.UNIT	UN	3,000	29,161000	24,100000	87,48	72,30	21
40001138	Escovilló de fusta amb cap de cotó.Vareta de fusta,amb unes mesures de 150 x 2,2 mm,amb tampó de cotó arrodonit de 5mm de diàmetre a l'extrem.Indicat per la presa de mostres biològiques sense deixar fibres ni restes.No estèril.	UN	5.000,000	0,023595	0,019500	117,98	97,50	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003166	Làmina silicona no adhesiva per placa PCR. Pel segellat/tancament de plaques de 96 pous (127x85mm). Pel·lícula extraïble. Resistència T° de 52°C. No DNasa, RNasa ni ADN humà. Compatible amb assajos amb microesferes fluorescentes. C.CAIX 50 UNIT	UN	50,000	3,920400	3,240000	196,02	162,00	21
40003713	Plat alumini 10cm de diàmetres i 1cm d'alçada. Un sol ús. Platet d'alumini, un sol ús. Per calcular el contingut d'humitat de les mostres. Presentació 500unitats. UNIT	UN	500,000	0,359189	0,296850	179,60	148,43	21
40003715	Trehalosa dihidrat solució 1M. C12H22O11·2H2O. Estèril. Lliure de Dnasa i Rnasa. Presentació de 500ml. FLAS de 500 ML	UN	10,000	1.815,000000	1.500,000000	18.150,00	15.000,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40004355	Nansa digralsky, de PS, pel cultiu celular. Amb la superfície tractada. En forma de L. Mesures: 145 x 38 mm. Estèril. Envàs individual. UNIT	UN	2.000,000	0,476740	0,394000	953,48	788,00	21
40004784	Tub de 50ml, fabricat en PP, facilita l'aïllament de PBMCs mitjançant gradients de densitat. Mostra inicial: 4-17ml, segons hematies empaquetats: 2-17ml, respectivament, i volum gradient de densitat: 15ml. Diagnòstic in vitro. Estèril. C.BOSS de 500 UNIT	UN	500,000	2,258707	1,866700	1.129,35	933,35	21

Total partida amb iva:	20.813,91
Total partida sense iva:	17.201,58
Total lot amb iva:	20.813,91
Total lot sense iva:	17.201,58

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 006 Material de Teixit Liofilitzat**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003565	Tap d'alumini, tipus volandera, de 20mm de diàmetre i 8mm d'alçada. Pel tancament hermètic d'un vial de vidre amb productes farmaceutic liofilitzat.C.UNIT	UN	30.000,000	0,048400	0,040000	1.452,00	1.200,00	21
40003566	Vial de vidre transparent 23mm de diàmetre i 46mm d'alçada. Destinat a emmagatzemar productes farmaceutics liofilitzats.C.UNIT	UN	30.000,000	0,181500	0,150000	5.445,00	4.500,00	21
40003567	Tap de silicona o similar, en forma circular per vial. Mesures: diàmetre extern 2 cm, diàmetre intern 1,3 cm i longitud 1,6 cm. Presentació 1250 unitats.C.UNIT	UN	30.000,000	0,133100	0,110000	3.993,00	3.300,00	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	10.890,00
Total partida sense iva:	9.000,00
Total lot amb iva:	10.890,00
Total lot sense iva:	9.000,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 007 Material de Teixits**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000020	Full bisturí n° 11.Fabricat en acer al carboni.Alta precisió,amb gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit.Ra nura per incorporar a mànec de bisturí convencional.Mesures:5, 2mm amplada/42,8mm de llargada.Estèril.D'un sol ús..UNIT	UN	100,000	0,084700	0,070000	8,47	7,00	21
40000021	Full bisturí n° 21.Fabricat en acer al carboni.Alta precisió,amb gran capacitat de tall i alta efectivitat en el tall repetit.Ra nura per incorporar a mànec de bisturí convencional.Mesures:9, 7mm amplada/53mm de llargada.Estèril.D'un sol ús.C.UNIT	UN	18.000,000	0,084700	0,070000	1.524,60	1.260,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000793	Bisturí complet nº10.Màneg de plàstic de grau mèdic.Fulla tallant d'acer inoxidable d'alta precisió. Mesures: Full del nº10 (7,8 mm d'amplada, 42,8 mm de llargada), maneg i capçal de 13 cm. Estèril i d'un sol ús..UNIT	UN	500,000	0,326700	0,270000	163,35	135,00	21
40003599	Escuma encunyada amb unes mesures de 22 x 22 x 5 cm. Es troben dos talls al centre del quadrat i dos cercles a cada costat. Ús pel transport i protecció de les còrnies.	UN	4.608,000	6,582400	5,440000	30.331,70	25.067,52	21
40003657	Terminal d'irrigació compatible amb pistola Inter Pulse d' Stryker pel rentat del canal femoral. Terminal cònic amb protector in corporat per evitar les esquitxades i no malmetre el teixit. Irrigació. Estèril. D'un sol ús..UNIT	UN	96,000	24,284700	20,070000	2.331,33	1.926,72	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40006119	Tap d'alumini i silicona gas-permeable, compatible amb TISSUE-C (medi pel cultiu de còrnies).Permet l'intercanvi gasós.Rosca d'alumini i goma d'alumini central extraible.Diàmetre 36mm.No estèril.Presentació 100 rosques d'alumini + 100 taps de silicona.	UN	1.000,000	13,915000	11,500000	13.915,00	11.500,00	21
40007245	Placa de cultiu de Teixits amb tapa.Mesures: Diàmetre (32,8mm) / Superfície (8,5cm2). Apte per la valoració y transport de la cornea. diàm. Estèril.C.Paquets de 10 unitats.	UN	4.800,000	0,289783	0,239490	1.390,96	1.149,55	21

Total partida amb iva:	49.665,41
Total partida sense iva:	41.045,79
Total lot amb iva:	49.665,41
Total lot sense iva:	41.045,79

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 008 Material de cobertura**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002580	Joc roba pel llit.Fabricat de tst de PP.Joc compost de:Llençol ajustable amb 2 elàstics (240x120cm),Llençol (220x140cm) i funda de coixi(100x40cm).Gramatg e de 20g/m2.Transpirable i resistent.Presentació individual.Un sol ús.	UN	600,000	1,234200	1,020000	740,52	612,00	21
40003618	Talla estèril impermeable de 90 x 150 cm. Talla composta de 2 capes mitjançant sistema de laminació, una de polipropilè hidròfil absorbent i un altra de polietilè impermeable. Empaquetament individual.	UN	3.000,000	1,481040	1,224000	4.443,12	3.672,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003620	Llençol de teixit sense teixir de polipropilè (FISELINA). Multifilaments termosegellats. Propietats hidrofíles i hidrofòbes. Alta resistència a factors químics i físics. No deixa residus. Mesures de 75 x 200 cm. No tòxic ni al·lèrgic.	UN	400,000	0,375100	0,310000	150,04	124,00	21
40004154	Manta de polièster de color vermell o fosc, amb unes mesures de 150 x 200 cm. Amb un gramatge de 80 g /m2. D'un sol ús, no estèril.	UN	576,000	2,238500	1,850000	1.289,38	1.065,60	21

Total partida amb iva:	6.623,06
Total partida sense iva:	5.473,60
Total lot amb iva:	6.623,06
Total lot sense iva:	5.473,60

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 009 Connexions i Equips de conservació i tra**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000041	Equip d'extracció de sang de 70cm amb agulla pels dos costats.Compost per dues agulles d'acer inoxidable siliconat amb punta bisellada i triple facetat,amb dispositiu de protecció i separades per un tubuladura de PVC de 70cm amb clamp.Estèril..UNIT	UN	100,000	1,403600	1,160000	140,36	116,00	21
40001080	Equip de transferència de cèl·lules mare de 250ml,estèril.Kit pel rentat i infusió de CM.Compost de 2 bosses de PVC unides per un tub d'EVA.De la bossa mare surt una línia amb 3 connexions en "Y"(dos spikes i un luer femella).Presentació individual.C.UNIT	UN	72,000	41,769200	34,520000	3.007,38	2.485,44	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40001128	Allargadera de PVC transparent en Y amb 2 connexions luerlock femella i 1 connexió luerlock mascle.Longitud:18cm/diàmetre intern:3mm/diàmetre extern:4mm/Resistència pressió màxima:1bar/Volum mort:2,035ml.No DEHP.Estèril.Presentació 200 unitats. C.	UN	1.500,000	0,726000	0,600000	1.089,00	900,00	21
40001234	Clau de tres vies de pas,amb una connexió mascle i dos femelles, una de les femelles amb valvula de seguretat. Composta de plàstic rígid, amb connexions Luer-Lock. Resistència a lípids i als antisèptics.UNIT	UN	500,000	2,335300	1,930000	1.167,65	965,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002006	Equip de transferència de PVC.Compost de:Perforador,port de connexió sense agulla,tubuladura i connexió luer mascle.Longitud total de 31 cm,volum de purga de 2,3 ml i diàmetre de 3mm. Sense làtex ni DEHP. Presentació de 100 unitats.C.	UN	300,000	3,375900	2,790000	1.012,77	837,00	21
40002007	Tubuladura de 50cm amb connexió mascle Luer-Lock per un extrem i connexió femella Luer-Lock per l'altra.Diàmtre (int:3mm i ext:4,1mm)/Volum residual:3,7ml/Resistencia màxima:1 bar.Tubuladura composta de PVC transparent sense DEHP.No làtex. Estèril.C.UNIT	UN	10.000,000	0,363000	0,300000	3.630,00	3.000,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40002569	Equip de transferència de 2 vies, sense latex. Compost per dos perforadors en Y, clamp pla blanc i una tubuladura de cloruri vinil que desenhoca en luer-lock mascle, i tub de 2,9x4,1x150 mm. Estèril.C.UNIT	UN	1.200,000	0,762300	0,630000	914,76	756,00	21
40002571	Equip transferència,de PVC,de 4 línies en Y amb 8 connexions amb clamps.Connexions:4 punxons(un amb presa d'aire) i 4 connexions Luer-Lock(3 mascles i 1 femella).Regulador de fluxe.Longitud 71cm.Vol purga 5ml.Estèril.No làtex ni DEHP.Presentació 50 U.C.	UN	300,000	4,891425	4,042500	1.467,43	1.212,75	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40003349	Filtre de transfusió amb malla de polièster de 40µm.Pre-sistema de filtre per a la separació de cèl·lules. Volum de retenció residual (20ml). Àrea de filtració (161cm2). Estèril.Presentació 40 unitats.UNIT	UN	160,000	9,680000	8,000000	1.548,80	1.280,00	21
40003749	Bossa de transferència de PVC de 1L.Disposa de 2 tubuladures de PVC de 75cm amb punxons a l'extrem i clamps de pinça. La bossa també disposa de 2 ports per a punxons protegits amb llengüetes.Resistent a la centrifugació.Estèril.C .UNIT	UN	400,000	8,107000	6,700000	3.242,80	2.680,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40004144	Equip de preparació, conservació d'aliquotes de gotes ulls de hemocomponents. Compost de 20 ampolles de PVC amb capacitat per 1,45 ml (45 gotes de 0,031ml/ampolla), xeringa de 20/30ml, clamps, tubladures, connectors i filtres. Recipient isotermic. Estèril. C.	UN	4.000,000	4,475004	3,698350	17.900,01	14.793,40	21
40006793	Kit per la preparació d'aliquotes d'hemocomponents. Kit compost de 12 bosses de 20 ml. Cada bossa disposa d'un punt d'injecció i estan connectades de dos en dos per tubuladures. Resistents a temperatures inferiors a -80°C. Estèril. Caixes de 6 kits. C.	UN	12,000	217,800000	180,000000	2.613,60	2.160,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40006856	Bossa EVA multicapa de 2L per nutrició parenteral per gravetat.Buida.Compatible amb màquina omplidora.Connector Luer Lock femella amb clamp de seguretat al port d'ompliment,punt d'aditivació i port per punxons.No Làtex/DEHP.Estèril.C.Pr esentació 30 U	UN	60,000	5,747500	4,750000	344,85	285,00	21
40006884	Bossa EVA multicapa de 1L per nutrició parenteral per gravetat.Buida.Compatible amb màquina omplidora.Connector Luer Lock femella amb clamp de seguretat al port d'ompliment,punt d'aditivació i port per punxons.No Làtex/DEHP.Estèril.C.Pr esentació 30 U	UN	60,000	5,118300	4,230000	307,10	253,80	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40006945	Bossa de 25ml per criopreservació de SCU.Disposa de 2 compartiments amb ports per punxó,que permet l'aliquotació.Tubuladur a amb clamp i punxó.Apte per congelació amb nitrogen líquid.Resistent DMSO.Compatible Set Sepax- Bioarchivo.Presentació 48 unitats.C.	UN	48,000	21,780000	18,000000	1.045,44	864,00	21

Total partida amb iva:	39.431,95
Total partida sense iva:	32.588,39
Total lot amb iva:	39.431,95
Total lot sense iva:	32.588,39

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/2000/1100004717/23/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI I DE LABORATORI FUNGIBLE DIVERS**Lot:** 010 Altra material d'ús sanitari**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40000012	Bobina de cel·lulosa de 500g. Gramatge mig de 288g/m2, 16 capes i de color blanc. Mesures: 20cm d'amplada i 875 cm de longitud..UNIT	UN	240,000	3,067048	2,534750	736,09	608,34	21
40003477	Làmina gel per equip descongelació cèl·lules mare crioconservades del sistema SAHARA-TSC. Mesures:16x23,5cm. Presentació 5 unitats.	UN	30,000	84,700000	70,000000	2.541,00	2.100,00	21
40004622	Mopa desechable d'un sol ús en teixit 100% poliéster multicapa.Estèril.Mesures: 12 x 40,5 cm / 52g.Absorció: 225ml.Presentació 100 unitats.C.UNIT	UN	1.200,000	6,969600	5,760000	8.363,52	6.912,00	21

Total partida amb iva:	11.640,61
Total partida sense iva:	9.620,34
Total lot amb iva:	11.640,61
Total lot sense iva:	9.620,34

Pressupostos per Lots

Total expedient amb iva:	224.625,68
Total expedient sense iva:	185.641,05

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge.

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes i unitats mínimes de dispensació han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

6.7.2 L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).

- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

6.7.3 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

6.7.4 Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

1. La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
2. La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
3. Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4. Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

6.7.5 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


1.	Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2.	Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3.	Carga/descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4.	Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE 
5.	Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6.	En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).	

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

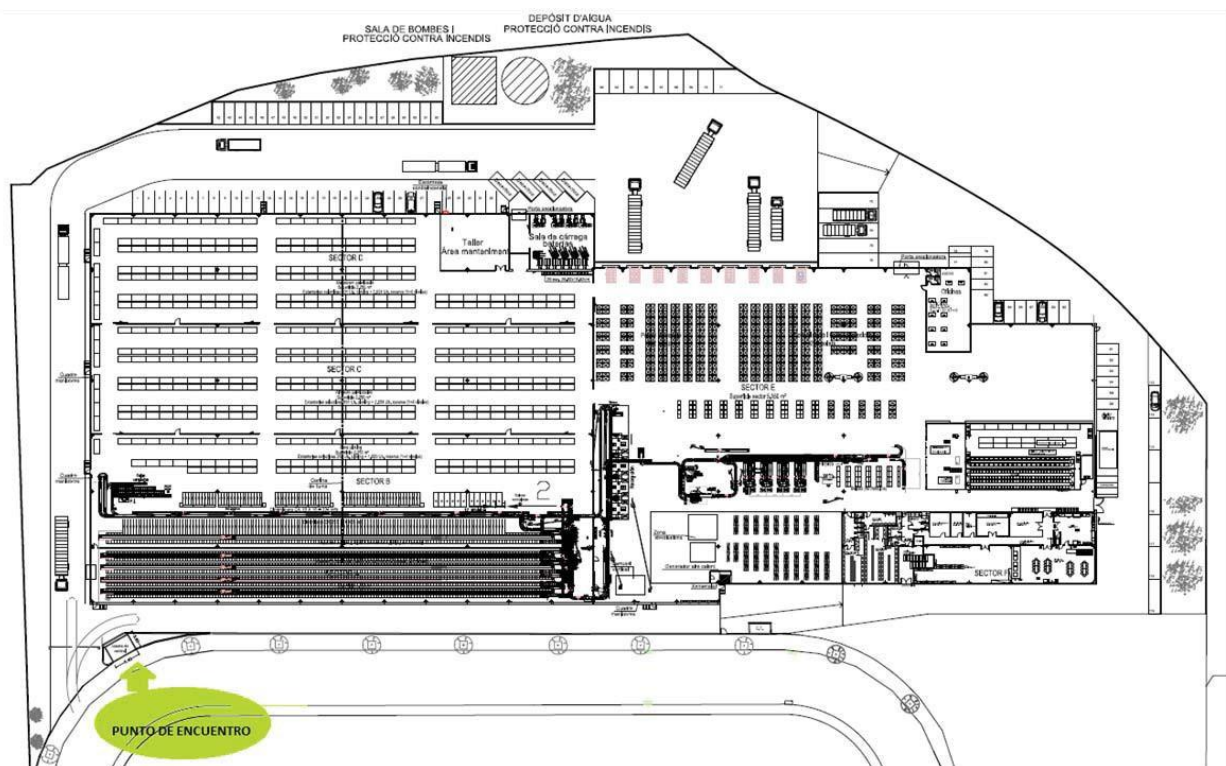

6.8 Lloc de lliurament

Pel que fa al lloc de lliurament del material, l'oferta s'haurà de fer partint de la base que serà als magatzems de l'operador logístic del BST, indicats a l'annex 1 del Plec de clàusules administratives, principalment a l'ubicat al de Sant Sadurn d'Anoia,

6.9 Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS –Logaritme, Serveis Logístics AIE), utilitza com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors el sistema EDI, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- Albarà electrònic (missatge DESADV D.96A UN EAN005)
- Confirmació de recepció de mercaderia (missatge RECADV D.96A UN EAN003)

Abans de la formalització del contracte, el adjudicatari hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats, a més de la factura electrònica (missatge INVOIC D.93A UN EAN007)

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>.



Transitòriament, i durant un termini màxim de 50 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, a la que hauran d'introduir les següents dades d'accés:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L' incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del corresponent contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es poden configurar una adreça de correu electrònic, per rebre els corresponents avisos de comanda. Des de aquesta mateixa plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop validat a la plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar amb l'operador Logístic.

7- Requeriments addicionals obligatoris

7.1 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (F.D.S) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

7.2 Formació

Si el centre destinatari ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes.

7.3 Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà.

8. Oferta tècnica

8.1 Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar en sobre 2

Les ofertes tècniques consistiran en la ***Fitxa tècnica del producte en el format que s'adjunta a l'annex*** , del present plec de prescripcions tècniques i degudament emplenada.

La presentació d'aquesta **és obligatòria**.

Imprescindiblement, aquesta informació haurà d'**acomplir els següents requisits**, per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:



1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte (codi SAP) a totes les pàgines. De no ser ben identificat es podria no valorar la oferta.
2. Aquesta informació addicional haurà d'estar redactada en català i/o castellà.
3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la descripció del producte i/o els criteris d'adjudicació.

Una de les coses que s'ha de fer constar a la fitxa tècnica del BST és les condicions de temperatura a l'apartat Temperatura d'emmagatzematge. En cas que no s'especifiqui en la oferta i el material es deteriorés per aquest motiu, anirà a càrrec de l'empresa les despeses per la seva reposició urgent i gratuïta.

Un altra cosa que s'ha de fer constar a la fitxa tècnica del BST és la presentació de la referència que s'ha ofert. Es a dir, per exemple, si s'ha ofert unes puntes, a l'apartat "Envasat del material ofert", s'haurà de complimentar amb Caixa de 10 racks de 96 puntes.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica del producte en el format que se adjunta a l'annex , amb la suficient informació i la forma de presentació no sigui la sol·licitada, l'oferta tècnica podria no ser avaluada i per tant es rebutjarà.

També és obligatori presentar la fitxa pròpia del producte (Product Data o data sheet), juntament amb la fitxa tècnica del BST.

Un altra documentació obligatòria, alhora de presentar la oferta tècnica, són els certificats que demostren el compliment de la normativa aplicable de cada producte exposats tant en el punt 4.2 i punt 5 del present plec.

En cas de no presentar aquesta documentació anteriorment exposada (Fitxa tècnica del BST, Fitxa tècnica pròpia del producte i Certificats que demostrin el compliment de la normativa sol·licitada), es podria arribar a no valorar la oferta.

A més, també es pot presentar informació addicional del producte com la documentació del catàleg del proveïdor o fabricant.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica del productes oferts. En cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú es requerirà a les empreses.

L'oferta tècnica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic. És obligatori que els fitxers vinguin identificats amb el codi logaritme i el contingut del fitxer. Per exemple:

- 40000133 Fitxa tècnica BST
- 40000133 Fitxa tècnica Proveïdor
- 40000133 Certificats

En cas de no penjar els documents en el format que s'indica, el BST es guarda el dret de no valorar la oferta degut a la dificultat d'identificar els documents.



8.2 Presentació de mostres

Caldrà presentar mostra de tots el material crítics, es a dir, d'aquells codis que al final de la descripció consti una "C". El volum de mostra a subministrar haurà de ser de 3 unitats.

També caldrà presentar mostra per totes les ofertes sobre puntes de pipeta del lot 3. El volum de la mostra a subministrar haurà de ser d'un rack.

L'entrega de les mostres s'ha de realitzar abans de la apertura del sobre tècnic.

Per la resta de codis no identificats, en principi, no caldrà aportar mostres. Si fos necessari, la Mesa de Contractació que les avaluarà, les demanarà un cop oberta la proposta tècnica. Per tant, l'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú.

En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 48 hores.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada pot no ser avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, el BST és reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit al BST en el moment del lliurament.

Totes les despeses associades a les mostres i al seu lliurament i recollida aniran a càrrec del proveïdor.

9. Oferta econòmica

9.1 Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació són els preus que figuren en el llistat de pla de necessitats (model d'oferta econòmica), per a cada article.

Els preus són màxims, de forma que sí limiten el preu unitari de les ofertes.

Per altra banda, s'ha de tenir en compte que les ofertes presentades pels lots que s'han de presentar a tots els articles (Lot 6), han de passar 2 filtres:

- 1- Preu unitari. Per un costat ha de respectar el màxim establert com a preu unitari de cada article.
- 2- Preu de Lot sencer. Per l'altra costat ha de respectar el màxim establert per cada lot. Aquest es calcularà mitjançant la suma de cada preu unitari de cada article que compona el lot, multiplicat pel consum estimat

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en els llistats de model d'oferta material, així com la descripció tècnica del material.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.



9.2 Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta com a annex C al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic.

Així mateix, el format paper haurà de contenir, obligatòriament, la signatura de l'apoderat i el segell de l'empresa.

En aquest sobre C s'ha d'incorporar un qüestionari de qualitat associat a aquesta licitació, degudament emplenat, que s'annexa en el conjunt d'annexos de la licitació com a qüestionari de qualitat, i que s'avaluarà d'acord amb els criteris de valoració que consten en l'annex 7 del PCAP. Aquest document només es presentarà una vegada, independentment de les ofertes que realitzi, sigui a ofertes per article o ofertes per lot sencer.

9.3 Us d'un sistema informàtic per la presentació de les ofertes.

La contractació associada té un sistema de gestió de les ofertes tècniques/econòmiques associat

En tot cas s'exposarà en l'anunci de la licitació i/o en les bases tècniques i t'adjuntarà el corresponent full informatiu

10. Adjudicació

L'adjudicació es realitzarà tant per article com per lot sencer segons el lot.

En els següents lots, l'adjudicació es realitzarà per article:

Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 7, Lot 8, Lot 9 i Lot 10

En els següents lots, l'adjudicació es realitzarà per lot sencer:

Lot 6

També cal dir, com s'ha informat en el punt 3, que es pot produir una adjudicació parcial, pendent del resultat de la validació dels articles crítics (C).