

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT, REACTIUS I
MATERIAL FUNGIBLE PER PROVES DE DETECCIÓ
D'ANTICOSSOS I D'ANTÍGENS

CS/CC00/1101358077/23/AMUP

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	5
2. Requeriments obligatoris	5
2.1. Normativa aplicable	5
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	11
3. Com presentar la oferta	11
3.1. Oferta tècnica	11
3.2. Model d'oferta tècnica	11
3.3. Presentació de mostres	13
3.4. Documentació confidencial.....	13
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	14
4.1. Prevenció de riscos laborals	14
4.2. Formació.....	14
4.3. Manual d'usuari	14
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	15
4.4.1. Condicions de subministrament.....	15
4.4.2. Garantia de subministrament.....	15
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	15
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	16
4.4.2.3. Termini de lliurament.....	17
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	17
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	17
4.4.3. Sistema EDI	17
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	20
4.5.1. Embalatges	20
4.5.2. L'albarà	21

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	21
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	22
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	22
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	24

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament d'equipament, reactius i material fungible per les proves de detecció d'anticossos i d'antígens per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

En aquesta licitació les quantitats indicades fan referencia a l'activitat anual que han tingut els laboratoris clínics de l'Institut Català de la Salut. Les empreses licitadores hauran de garantir que aquesta activitat és satisfeta amb la seva proposta. L'incompliment d'aquest requeriment podrà comportar la resolució del contracte.

Abast de la contractació:

LABORATORIS:

- Laboratori Clínic Hospital Universitari de Vall Hebron.
- Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].
- Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].
- Laboratori Clínic de la GT Girona. [Hospital Universitari Josep Trueta- Parc Hospitalari Martí i Julià].
- Laboratori Clínic de la GT Tarragona [Hospital Universitari Joan XXIII].
- Laboratori Clínic de la GT Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova].
- Laboratori Clínic de la GT Terres de l'Ebre [Hospital Verge de la Cinta-Tortosa].

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes per a diagnòstic "in vitro", en el sobre 2 l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 8 de l'Annex I del RD 1662/2000, de 29 de setembre pel qual es regulen els productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro", amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Tant la Normativa aplicable descrita en punt 2.1, com els requisits que es detallen a continuació, son d'aplicació a la totalitat dels lots d'aquesta licitació.

- S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
- Serà d'obligat compliment que tots els empaquetatges portin codi de barres que identifiqui el lot i la data de caducitat.

2.3.1. Condicions bàsiques per tots els equipaments

- L'equipament ha de tenir un sistema d'emmagatzemament de resultats i controls.
- L'adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació i la connectivitat al SIL propi de cada centre.

- Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips analítics necessari en cada laboratori.
- Els reactius o el material consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.
- Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips
- Certificació Norma ISO 9001 de Gestió de Qualitat.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d' equips durant la vigència del contracte
- Suport a la implementació de la acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditat alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.

2.3.2. Requisits obligatoris específics per lot

Lot 1 Serologia semiautomatitzada per tècnica CLIA

*L'instrument ha de registrar i mostrar la traçabilitat d'una mostra en quan al lot amb el que s'ha realitzat una tècnica.

*L'instrument haurà d'admetre tub primari i alíquota, per tal que s'adapti als diferents diàmetres de tub amb els que treballem als laboratoris.

*L'instrument haurà de ser de càrrega continua de mostres.

*L'instrument ha de poder realitzar diferents tècniques en una mateixa sèrie analítica.

Lot 4 Detecció d'anticossos i antígens per tècniques d'immunocromatografia

*Conservació a temperatura ambient.

*Envàs individual amb dessecant de llarga durada i en el que ha de constar la data de caducitat.

*El kit haurà de contenir tot el material necessari per a fer la prova, inclòs el del pretractament de la mostra si fos necessari de realitzar-lo.

*Presència de una banda control del procediment que garanteixi la validesa de la prova.

*El material i els components dels kits hauran de tenir consistència i elasticitat suficient per a permetre la seva correcta manipulació durant la realització del procediment tècnic sense riscos de trencadissa o vessament per part del manipulador.

*Els contenidors inclosos han de tenir tancament estanc i ser hermètics per a evitar vessaments durant el seu emmagatzematge, manipulació i eliminació.

*Les instruccions d'ús han de ser comprensibles i de fàcil lectura.

Lot 5 Detecció d'anticossos per tècnica ELISA de Strongyloides, Zika i Schistosoma

*L'instrument ha de registrar i mostrar la traçabilitat d'una mostra en quan al lot amb el que s'ha realitzat una tècnica.

*L'instrument haurà d'admetre tub primari i d'alíquota, per tal que s'adapti als diferents diàmetres de tub amb els que treballem als laboratoris.

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

Lot 8 – VIH: Reactius per a proves de confirmació ràpida

*L'instrument ha de registrar i mostrar la traçabilitat d'una mostra en quan al lot amb el que s'ha realitzat una tècnica.

*Disposar de tècniques en format monotest, on cada test es realitza de forma individual i independent de la resta de tests.

*El reactiu ofert ha de permetre la detecció i diferenciació de les diferents proteïnes en front de VIH1 i VIH2.

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites

Lot 9 – Detecció d'antígens de patògens respiratoris per immunofluorescència

*Tecnologia d' immunofluorescència ràpida.

*Equip per a lectura objectiva i automatitzada de resultats.

*El temps màxim d' obtenció de resultats per a cada prova no ha de superar els 15 minuts.

*Connexió al sistema informàtic del laboratori (SIL).

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

Lot 10 – Detecció d'antigen per immunofluorescència automatitzada amb càrrega continua

*Control de qualitat en cadascun dels tests, per garantir la validesa de la prova.

*Possibilitat de processament de l'instrument de més d'una mostra a la vegada (càrrega continua)

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

Lot 11 – Detecció d'anticossos per tècnica d'immunoblot

*Equip per a lectura objectiva i automatitzada de resultats.

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, reactius i controls de positius i negatius inclosos.

En el cas que, les empreses licitadores no compleixin els criteris bàsics establerts en els punts 2.3.1 i 2.3.2, la seva oferta no serà avaluada i per tant es rebutjarà.

2.3.3. Manteniment

2.3.3.1. Condicions del manteniment

Garantir el manteniment dels equipaments i instal·lacions inclosos en aquesta licitació. L'adjudicatari tindrà cura permanent dels equipaments, sistemes i instal·lacions durant el període de vigència del contracte.

Garantir l'òptim funcionament permanent dels sistemes, instal·lacions i equipaments inclosos en la contractació, mitjançant l'òptim estat de conservació de cadascun dels elements, i la seva ràpida reposició segons les especificacions detallades.

Garantir el compliment de les normatives vigents sobre els sistemes, instal·lacions i equipaments, mantenint al dia les inspeccions i revisions normatives, i actualitzar qualsevol instal·lació a les modificacions que poguessin donar-se en qualsevol normativa o ordenança.

Ajustar-se al compliment de les normes de qualitat del laboratori. 2.3.3.2. Tipus de manteniment

El manteniment a oferir és a tot risc i/o integral per a tots els àmbits de la contractació.

El servei de manteniment inclourà els costos de mà d'obra i tots els materials, la substitució de peces, recanvis i altres elements necessaris per garantir el correcte funcionament dels equipaments.

Els costos de mà d'obra i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis, incomplets o executats incomplint la normativa vigent, seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3.3.2. Tipus d'intervenció

Les intervencions de manteniment a realitzar son de tres tipus: preventiu, normatiu, i correctiu.

El manteniment preventiu consta d'una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries, i d'obligat compliment, per conservar i garantir el bon funcionament de les instal·lacions i equipaments. El manteniment preventiu es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat pactat amb el laboratori i seguint les normes de qualitat.

El manteniment normatiu, també és realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi laboratori. En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent. Les revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, al igual que la contractació, quan sigui necessari, d'una empresa d'inspecció i control (EIC) per realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent. L'adjudicatari del manteniment s'assegurarà també de fer arribar una còpia a la Direcció del Laboratori de l'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

El **manteniment correctiu** comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en els diversos sistemes, instal·lacions, i equipaments, sota les següents condicions:

- Per als laboratoris amb activitat urgent. S'ha de garantir la seva continuïtat 24 hores els 365 dies de l'any mitjançant sistemes de suport hot-line, i reparacions urgents presencials en cas que sigui necessari. El temps de resposta en cas d'avaries urgents ha de ser inferior a 2 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- Per als laboratoris amb activitat programada. S'ha de garantir la continuïtat del servei de 8 a 22 hores, els dies laborables, de dilluns a divendres, mitjançant hot-line i reparacions. El temps de resposta ha de ser inferior a 4 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- En cas que la previsió de l'aturada del sistema sigui de dues jornades o més, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar un informe amb la planificació de les intervencions que realitzaran respecte els manteniments preventius i normatius.

2.3.3.3. Característiques generals del manteniment

Tant per a les tasques de manteniment preventiu com per a la resolució d'avaries, els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics i materials que calgui a fi de poder realitzar els treballs previstos.

Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques pròpies del servei de laboratori clínic, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que representin molèsties per al personal del centre o bé per al públic s'hauran de programar d'acord amb el responsable del laboratori.

Una vegada acabada la intervenció, el tècnic romandrà a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips en condicions de rutina. Un cop realitzats els manteniments el sistema ha de quedar en posició de verificat.

2.3.4. Control de qualitat

L'adjudicatari haurà de facilitar els materials de control intern i extern adients i necessaris per garantir la qualitat dels resultats:

- El tipus i el nombre de materials de control intern a subministrar seran els escollits per el laboratori i els necessaris, en funció de l'activitat, de la tècnica i de l'estat dels aparells de cada centre. El proveïdor ha de finançar el cost dels materials de control intern.
- Les característiques metrològiques han d'estar en els límits establerts per la Unitat de Garantia de la Qualitat del Laboratori.

- L'adjudicatari garantirà, i finançarà la participació en els programes d'avaluació externa de la qualitat escollits pels diferents laboratoris objecte d'aquesta licitació.
- Els resultats obtinguts per la Unitat de Garantia de la Qualitat de cada centre, es lliuraran en cas necessari a l'adjudicatari. En cas que s'incompleixin els criteris de la qualitat establerts, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec, en el termini màxim de 48 hores.

2.3.5. Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de la integració amb el SIL corporatiu actual, Modulab de Werfen, instal·lat en tots els laboratoris clínics de l'ICS.

Tanmateix, si durant la vigència del contracte es produeix una actualització, renovació tecnològica o s'instal·len més equips l'adjudicatari ha de fer-se càrrec d'aquesta integració.

En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent per la traçabilitat, gestió i validació de resultats.

2.3.6. Actualitzacions tècniques als equipaments actuals

L'adjudicatari incorporarà les modificacions, millores, i actualitzacions tècniques i de software que es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte, i que siguin d'interès per a l'ICS, previ acord amb la direcció dels laboratoris. I sense que aquesta actualització impliqui cap increment del preu del contracte ni cap modificació de la seva durada.

Els proveïdors queden obligats durant la vigència del contracte, i les seves eventuais pròrrogues, a:

- L'exercici de la tutoria tècnica de les instal·lacions i materials per assegurar el seu aprofitament al 100%.
- La informació de la millores tecnològiques, la ampliació del catàleg de productes, l'aparició de nous instruments, noves versions d'equipament i de software, etc.

2.3.7. Característiques generals de la instal·lació

Els equips s'han d'ubicar a l'espai que indiqui cada laboratori, incloent possibles trasllat durant la vigència del contracte. Les tasques d'adequació dels espais necessaris per a la instal·lació dels equips i els altres equipaments auxiliars, aniran a càrrec del proveïdor.

La instal·lació de l'equipament porta implícita la necessària adequació dels espais i tot allò relacionat amb garantir un correcte funcionament dels equips així com amb facilitar la funcionalitat dels espais i aconseguir un adequat entorn físic de treball i salut laboral.

Tots els equips ofertats disposaran d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) que anirà a càrrec del proveïdor.

En cas dels equipaments que requereixin aigua desionitzada el proveïdor instal·larà i mantindrà els equips necessaris al seu càrrec.

Els licitadors donaran el servei de suport a la instal·lació, i la connectivitat al SIL propi de cada laboratori. En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent.

Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i en condicions de correcte funcionament i integració al sistema informàtic del laboratori. Les tasques d'adequació dels espais, transport, instal·lació, intercomunicació i posada en funcionament són a càrrec de l'adjudicatari, així com els trasllats de la maquinària per canvis d'ubicació

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació

complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de

propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc,

sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:

	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

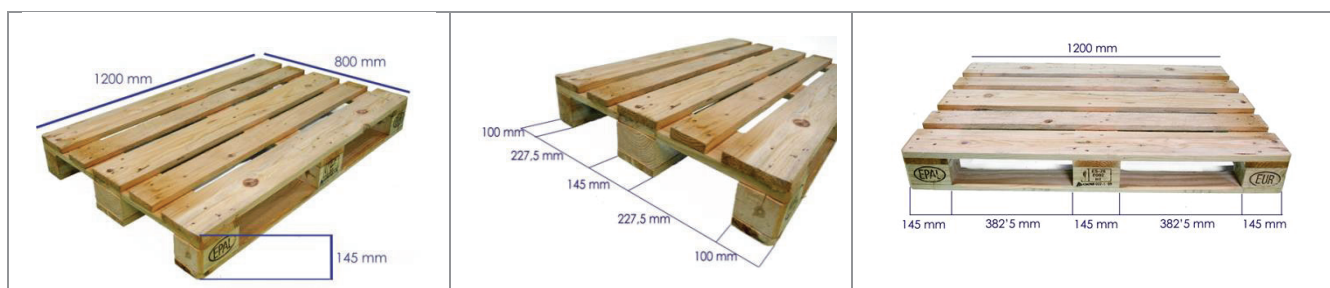

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot

- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiquen-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en

tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A – Característiques de la licitació

ANNEX A_ CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	LOTS OBLIGATORIS
001	Serologia semiautomatitzada per tècnica CLIA	<i>Totalitat lot</i>
002	Detecció d'anticossos per tècniques de seroaglutinació	<i>No obligatori</i>
003	Serologia per a tècnica d' Immunofluorescència indirecta (IFI)	<i>No obligatori</i>
004	Detecció d'anticossos i antígens per tècniques d'immunocromatografia	<i>No obligatori</i>
005	Detecció d'anticossos per tècnica ELISA de Strongyloides, Zika i Schistosoma	<i>Totalitat lot</i>
006	Detecció d'anticossos per tècnica ELISA de paràsits	<i>No obligatori</i>
007	Detecció d'antigen GDH i toxines A+B per tècnica EIA de membrana	<i>No obligatori</i>
008	VIH: Reactius confirmació ràpida	<i>Totalitat lot</i>
009	Detecció d'antígens patògens respiratoris per immunofluorescència	<i>Totalitat lot</i>
010	Detecció d'antigen per immunofluorescència automatitzada amb càrrega continua	<i>Totalitat lot</i>
011	Detecció d'anticossos per tècnica d'immunoblot	<i>Totalitat lot</i>
012	Altres detecció d'antígens i anticossos	<i>No obligatori</i>
013	Antisèrum per a identificació ràpida	<i>No obligatori</i>

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l’expedient

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 10000332

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:g, p

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 10000333

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O: 11

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 10000335

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O: 1, 3, 19

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 10000337

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: e

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 10000795

Descripció tècnica:

Antisèrum per E. coli enteropatògen serotip O:55:B5

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 10000796

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 86:B7

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 10000797

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 127:B8

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 10000798

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 128:B12

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 10000799

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 124:B17

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 10000800

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 114:K90

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 10000801

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 142:K86

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 10000802

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 111:B4

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 10001774

Descripció tècnica:

Salmonella typhi: detecció d' anticossos (anti O, somàtic) per aglutinac ió en porta o tub.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 10001775

Descripció tècnica:

"Salmonella typhi: detecció d' anticossos (anti H, flagel·lar) per aglut inació en porta o tub.#"

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 10002773

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O125:K70

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 10002774

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O126

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 10002776

Descripció tècnica:

Antisèrum per E. coli enteropatògen serotip O:26:B6

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 10002787

Descripció tècnica:

Antisèrum ident.rap.Shigella, anti shigella II (s. dyse).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 10002794

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:g,m

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 10002795

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:5

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 10002798

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:3,10,15.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 10002799

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:4,5.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 10002800

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:6,14,24.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 10002801

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:2.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 10002803

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: i.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 10002809

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:6,7,8.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 10002811

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:9.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 10002815

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent Vi.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 10002884

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: seteció d'anticossos. Tècnica: Hemaglutinació (TPHA)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 10002893

Descripció tècnica:

VIH2: Detecció d' anticossos. Prova confirmatoria. Tècnica Westernblot.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 10003170

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: detecció d'anticossos tipus IgG/IgM. Tècnica: Seroag lutinació (RPR)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 10003182

Descripció tècnica:

Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgG. Tècnica Immunoblot

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 10003300

Descripció tècnica:

Antisèrum per a identificació ràpida Haemophilus influenzae, Antisèrum a glutinant monovalent tipus B.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 10003301

Descripció tècnica:

Antisèrum per a V. Cholerae aglutinació polivalent Cholera.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 10003302

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: g.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 10003304

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:13,22,23.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 10003306

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:8.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 10003307

Descripció tècnica:

Aspergillus fumigatus. Detecció d'antigen (galactomanà) en sèrum i orina . Tècnica: EIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 10003357

Descripció tècnica:

Legionella pneumophila: Detecció d'antigen en mostres respiratòries per IF. Tècnica: immunoflorescència

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 10003374

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació omnivalent Omni - O.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 10003385

Descripció tècnica:

Antisèrum per a salmonella aglutinació polivalent OMB.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 10003386

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:d.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 10003387

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:r

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 10003388

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:7.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 10003403

Descripció tècnica:

Brucella: detecció d' anticossos. Tècnica seroaglutinació (prova de rosa de bengala)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 10003456

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O:157 H:7.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 10003808

Descripció tècnica:

Fasciola hepatica: Detecció d'anticossos IgG. Tècnica hemaglutinació

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 10003812

Descripció tècnica:

Legionella pneumophila: detecció d'antigen en mostres d'orina. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 10004038

Descripció tècnica:

Clostridioides difficile: detecció ràpida en femta d'antigen GDH. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 10004211

Descripció tècnica:

Mycoplasma pneumoniae: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 10004212

Descripció tècnica:

Mycoplasma pneumoniae: detecció d' anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 10004245

Descripció tècnica:

Erythrovirus (Parvovirus) B19: detecció anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 10004246

Descripció tècnica:

Erythrovirus (Parvovirus) B19: detecció anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 10004252

Descripció tècnica:

Virus Epstein-Barr (EBV): detecció ràpida d'anticossos heteròfils . Tècnica: Seroaglutinació.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 10004687

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Yersinia, yersinia serogrup 03.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 10004688

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Yersinia, yersinia serogrup 09.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 10004726

Descripció tècnica:

Streptococcus pneumoniae: detecció d'antigen en mostres d'orina. Tècnic a d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 10004919

Descripció tècnica:

Cryptococcus neoformans: detecció d'antigen capsular. Tècnica per agluti nació.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 10005546

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació polivalent OMA.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 10005548

Descripció tècnica:

Antisèrum per a salmonella aglutinació polivalent OMC.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 10007300

Descripció tècnica:

Estreptococs: Reactiu per identificació per làtex aglutinació.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 10007459

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: Detecció d'anticossos, prova confirmatoria. Tècnica Immunoblot

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 10007662

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: detecció d'anticossos (amb tampó salí). Tècnica VDRL .

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 10008574

Descripció tècnica:

Plasmodium: detecció d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 10008723

Descripció tècnica:

Herpes 1: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 10009246

Descripció tècnica:

Virus Epstein-Barr (EBV): detecció ràpida d'anticossos heteròfils. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 10009490

Descripció tècnica:

Estreptococs A: detecció ràpida d'antigen en mostres faríngies. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 10009774

Descripció tècnica:

Micoplasma Pneumoniae: detecció d'anticossos. Tècnica: Seroglutinació.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 10010423

Descripció tècnica:

Antisèrum per a E. enteropatògen (nonavalent)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 10010427

Descripció tècnica:

Antisèrum per E. coli enteropatògen (tri valent)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 10011022

Descripció tècnica:

Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O119:B14

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 10011140

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:a

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 10011141

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H : c

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 10011142

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:b

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 10011238

Descripció tècnica:

Leishmania donovani: antigen per a la detecció d'anticossos. Tècnica: Im munofluorescència indirecta (IFI).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 10011796

Descripció tècnica:

Varicel·la zoster: detecció d' anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 10012070

Descripció tècnica:

Echinococcus granulosus: Detecció qualitativa i semiquantitativa d'antic ossos. Tècnica: Hemaglutinació indirecta.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 10014303

Descripció tècnica:

Coxiella burnetii: detecció d'anticossos IgG/IgM/IgA IFI fase I+II. Tècnica: Immunofluorescència indirecta (IFI).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 10014305

Descripció tècnica:

Parotiditis: detecció d' anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 10015042

Descripció tècnica:

Virus Influença A i B: detecció ràpida d'antigen. Tècnica d' Immunocrom atografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 10015043

Descripció tècnica:

Virus respiratori sincitial (RSV): detecció ràpida d'antigen. Tècnica d ' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 10017403

Descripció tècnica:

Brucella abortus: detecció d'anticossos. Tècnica seroaglutinació (Agluti nacio en placa).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 10017621

Descripció tècnica:

Legionella pneumophila: detecció d'anticossos IgG+IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 10017773

Descripció tècnica:

Virus Influença A i B: Detecció d'antigen en mostres respiratòries. Tècn ica: Immunofluorescència.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 10017920

Descripció tècnica:

Micobacterium tuberculosis complex: detecció ràpida (MPT64) a partir de medi líquid. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 10017943

Descripció tècnica:

Antisèrum per a Shigella boydii aglutinació Polivalent.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 10019187

Descripció tècnica:

Rickettsia conorii: detecció d'anticossos tipus IgG. Tècnica: Immunofluor escència indirecta (IFI).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 10023378

Descripció tècnica:

Trypanosoma cruzi: detecció d'anticossos IgG enfront antigen nadiu.Tècni ca: Immunofluorescència indirecta (IFI).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 10023727

Descripció tècnica:

VIH: Control prova confirmatoria. Tècnica immunocromatografia.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 10023728

Descripció tècnica:

VIH (tipus 1 i 2): Detecció d'anticossos, prova confirmatoria. Tècnica i mmunocromatografia.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 10023968

Descripció tècnica:

Strongyloides: detecció d'anticossos tipus IgG. Tècnica ELISA.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 10024059

Descripció tècnica:

Toxocara canis: detecció d'anticossos tipus Ig. Tècnica ELISA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 10024090

Descripció tècnica:

Chlamydomphila pneumoniae: detecció d'anticossos IgG . Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 10024091

Descripció tècnica:

Chlamydomphila pneumoniae: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 10024093

Descripció tècnica:

Taenia solium: detecció d'anticossos tipus Ig. Tècnica ELISA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 10024098

Descripció tècnica:

Trichinella spiralis: detecció d'anticossos tipus Ig. Tècnica ELISA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 10024100

Descripció tècnica:

Echinococcus granulosus: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 10024101

Descripció tècnica:

Leishmania: detecció anticossos IgG+IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 10024102

Descripció tècnica:

Brucella: detecció d'anticossos IgG . Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 10024103

Descripció tècnica:

Virus Dengue: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 10024104

Descripció tècnica:

Virus Dengue: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 10024107

Descripció tècnica:

Entamoeba histolytica: detecció d'anticossos tipus Ig. Tècnica ELISA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 10024892

Descripció tècnica:

Coxiella burnetii: detecció d'anticossos IgG Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 10024897

Descripció tècnica:

Detecció d'antigen uninaris de Legionel·la pneumophila i Streptococcus pneumoniae en mostres d'orina. Tècnica: Immunocromatografia. En un única tira.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 10024898

Descripció tècnica:

Legionel·la pneumophila: Detecció d'antigen en mostres d'orina. Tècnica: Immunofluorescència.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 10024908

Descripció tècnica:

Cryptosporidium i Giardia lamblia: detecció d'antigen en femta. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 10024978

Descripció tècnica:

Virus Zika: Detecció d'anticossos tipus IgG. Tècnica ELISA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 10024981

Descripció tècnica:

Brucella: detecció d'anticossos. Tècnica: Immunocaptura-aglutinació.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 10025032

Descripció tècnica:

"Schistosoma: Detecció d'anticossos tipus IgG/IgM. Tècnica: ELISA#"

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 10025033

Descripció tècnica:

Clostridioides difficile: detecció ràpida en femta d'antigen GDH i de to xina A i B. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 10025075

Descripció tècnica:

Streptococcus pneumoniae: Detecció d'antigen en mostres d'orina. Tècnic a: Immunofluorescència.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 10026332

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: detecció ràpida. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 10026333

Descripció tècnica:

HIV1-2 i antigen HIV-1: prova ràpida per detecció d'anticossos. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 10026376

Descripció tècnica:

Rickettsia conorii: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 10026377

Descripció tècnica:

Chlamydia trachomatis: detecció d'anticossos IgG . Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 10026407

Descripció tècnica:

Rickettsia conorii: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 10026408

Descripció tècnica:

Coxiella burnetii: detecció d'anticossos IgM anti- fase II. Tècnica CLI A

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 10026409

Descripció tècnica:

Legionella pneumophila: detecció d' anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 10026411

Descripció tècnica:

Clostridium tetani: detecció d'anticossos IgG Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 10026412

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 10028713

Descripció tècnica:

Chlamydia trachomatis: detecció d'anticossos IgM . Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 10028714

Descripció tècnica:

Bartonella henselae: detecció d'anticossos IgM (CLIA) . Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 10028716

Descripció tècnica:

Virus Zika: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 10028717

Descripció tècnica:

Virus Zika: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 10028718

Descripció tècnica:

Virus hepatitis E (VHE): detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 10028719

Descripció tècnica:

Virus hepatitis E (VHE): detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 10028720

Descripció tècnica:

Virus Chikungunya: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 10028721

Descripció tècnica:

Virus Chikungunya: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 10028812

Descripció tècnica:

Treponema pallidum: detecció d'anticossos IgM+IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 10028817

Descripció tècnica:

Virus d'hepatitis B: Determinació de l'antigen memòria relacionat amb el Core (HBcrAg). Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 10029064

Descripció tècnica:

Detecció d'anticossos tipus IgA, IgG i IgM anti-Chlamydia. Tècnica: Microimmunofluorescència (MIF).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 10029065

Descripció tècnica:

Bartonella quintana + Bartonella henselae: detecció d'anticossos tipus I gG.Tècnica: Immunofluorescència indirecta (IFI).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 10029066

Descripció tècnica:

Detecció de quists i trofozoïts de Pneumocystis carinii en mostres de ví as respiratòries. Tècnica: Immunofluorescència directa (IFD).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 10029201

Descripció tècnica:

Bartonella henselae: detecció d'anticossos IgG . Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 10029412

Descripció tècnica:

Bartonella quintana + Bartonella henselae: detecció d'anticossos tipus I gM.Tècnica: Immunofluorescència indirecta (IFI).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 10030828

Descripció tècnica:

Adenovirus (ADV), virus sincitial respiratori (RSV) i influença A + B: d etecció ràpida d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 10031275

Descripció tècnica:

Varicel·la zoster: detecció d' anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 10031276

Descripció tècnica:

Rubèola: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 10031581

Descripció tècnica:

West Nile, detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 10031582

Descripció tècnica:

West Nile: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 10033615

Descripció tècnica:

Aspergillus fumigatus: detecció de galactomanà. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 10033616

Descripció tècnica:

Borrelia burgdorferi, detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 10033617

Descripció tècnica:

Trypanosoma cruzii: detecció d'anticossos IgG+IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 10033619

Descripció tècnica:

Virus Herpes 2: detecció d'anticossos IgG. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 10033620

Descripció tècnica:

Xarampió: detecció d'anticossos IgM. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 10033621

Descripció tècnica:

Francisella tularensis: detecció d' anticossos. Tècnica Seroaglutinació.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 10033626

Descripció tècnica:

Aspergillus fumigatus: detecció de galactomanà. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 10033627

Descripció tècnica:

Cryptococcus neoformans: detecció d'antigen capsular. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 10033628

Descripció tècnica:

Rotavirus, Adenovirus i Astrovirus, norovirus: detecció d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 10033629

Descripció tècnica:

Virus Zika: Detecció d'anticossos tipus IgM. Tècnica ELISA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 10033630

Descripció tècnica:

Clostridium difficile: detecció ràpida en femta d'antigen GDH de i toxina A i B. Tècnica: ELISA en membrana

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 10033631

Descripció tècnica:

Virus respiratori sincitial (RSV):Detecció d'antigen en mostres respiratòries. Tècnica: Immunofluorescència.

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 10033632

Descripció tècnica:

Clostridium difficile: Detecció de GDH. Tècnica: immunoflorescència

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 10033633

Descripció tècnica:

Streptococcus pneumoniae: Detecció d' antigen en mostres respiratòries per IF. Tècnica: immunoflorescència

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 10033634

Descripció tècnica:

Yersinia enterocolitica: Detecció d'anticossos IgA/IgG. Tècnica EIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 10033637

Descripció tècnica:

HTLV I+II: Detecció d'anticossos. Tècnica Immunoblot

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 10033638

Descripció tècnica:

VIH 1 i 2: Detecció d'anticossos (Pèptids sintètics), prova confirmatoria. Tècnica Immunoblot

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 10033639

Descripció tècnica:

Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgG, Tècnica EIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 10033640

Descripció tècnica:

Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgM, Tècnica EIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 10033641

Descripció tècnica:

Fongs: detecció de 1-3 β -D-glucà (TUR).

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 10033955

Descripció tècnica:

Bordetella: detecció d' anticossos. Tècnica CLIA

SOL.COMANDA: 1101358077 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 10033956

Descripció tècnica:

Leptospira interrogans: prova ràpida per detecció d'anticossos. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

[No n'hi ha]

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació productes sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101358077/23/PNSP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'EQUIPAMENT, REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE PER PROVES DE DETECCIÓ D'ANTICOSSOS I D'ANTÍGENS

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Mètode d'esterilització
Referència fabricant	Material de fabricació *
	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

[No n'hi ha]