

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101379927/24/PNSP

Subministrament agregat d'Electrocirurgia bàsica general i
material per a cirurgia per ultrasò_Desert

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	8
3.1. Oferta tècnica	8
3.2. Model d'oferta tècnica	8
3.3. Presentació de mostres	10
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	11
4.1. Prevenció de riscos laborals	11
4.2. Formació.....	11
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.4.1. Condicions de subministrament.....	12
4.4.2. Garantia de subministrament	12
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	12
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	13
4.4.2.3. Termini de lliurament	14
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	14
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	14
4.4.3. Sistema EDI.....	14
4.5. Condicions de l'operador logístic	16
4.5.1. Embalatges.....	16
4.5.2. L'albarà.....	17
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	18
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	18

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 19
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)21

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'Electrocirurgia bàsica general i material per a cirurgia per ultrasó_Desert per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals, a aquesta licitació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

En el cas que sigui necessari la cessió d'equipament, les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic els aparells necessaris per la utilització d'aquest material en els nostres centres.

Tanmateix el manteniment dels equipaments anirà a càrrec del adjudicatari.

Com a orientació es detallen els aparells actualment cedits que pot variar, en el cas de necessitat dels centres.

Licitació Lot 14 "Fungible compatible amb equip Coolseal".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Coolseal, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació Lot 7 - "Fungible compatible amb equip Malis".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Malis, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació Lot 9 -"Fungible compatible amb equip Sonastar/Misonix".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Sonastar/Misonix, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació Lot 13 -"Fungible compatible amb equip Piezoelectric System".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Piezoelectric System, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació Lot 11 - "Fungible compatible amb equip Sonopet".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips Sonopet, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació Lot 8 - "Fungible compat equip AF GN200 ".

Actualment l'adjudicatari del fungible dels equips AF GN200, cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 9 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3

No hi ha

- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereixi.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

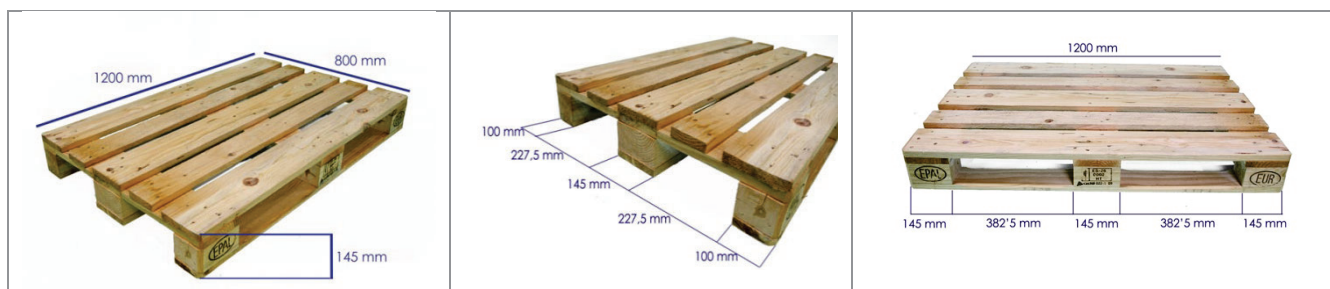

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE  ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals

ANNEX E – Presentació de mostres (NO HI HA)

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS AMB BATERIA	30042736	Electrocauteri bipolar de punta llaç amb bateria, de 7mm part activa, tija flexible de 5cm+/- 0,5cm, mànec d'activació manual de coagulació, d'alta temperatura (1204°C), longitud total sense tapa protectora 18,9cm+/-1cm (amb tapa 23cm). Estèril, d'un sol ús.	No Obligatori
2	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS CONVENCIONALS AMB EVACUACIÓ DE FUMS	30054097	Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums, p/plana roma antiad/aiïlada, mànec c/manual (tall-coagulació) basculant, conn/8mm sortida de fluids, connexió tub 22mm a sistema evacuació de fums tipus SafeAir o Neptune o equ. Lliure làtex, estèril, un sol ús.	Si Obligatori
2	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS CONVENCIONALS AMB EVACUACIÓ DE FUMS	30054098	Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums, p/plana roma antiadherent aiïlada, mànec control manual (tall-coagulació) amb botons, conn 8mm sortida de fluids, conn tub 22mm a sistema evacuació de fums SafeAir o Neptune o eq. Lliure làtex, estèril, un sol ús	Si Obligatori
2	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS CONVENCIONALS AMB EVACUACIÓ DE FUMS	30054099	Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums telescòpic, fins a 120mm, punta plana roma antiadherent aiïlada, mànec c/manual (tall-coagulació) a/ botons, conn 8mm sort fluids, conn tub 22mm sist evacuació fums SafeAir o Neptune o eq.s/làtex, estèril, 1sol ús	Si Obligatori
3	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELÈCTRODES PUNTA AGULLA	30054444	Elèctrode punta agulla de microdissecció per a electrobisturí monopolar. Agulla de tungstè ultrafina, eix aiïllat amb polímer, 10-11cm de longitud total, punta de 3mm en angle de 45°. Sense làtex, estèril, un sol ús.	No Obligatori
4	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA TANCADA: ELÈCTRODES PUNTA EN L O GANXO	30042359	Elèctrode amb punta de ganxo en L, aiïllat, cos de diàmetre 3mm x 34+/-1cm de llargària, mànec ergonòmic, amb connexió monopolar de 4mm tipus banana, d'acer inox i material plàstic, per a cirurgia laparoscòpia i pediàtrica, estèril, d'un sol ús	No Obligatori
4	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA TANCADA: ELÈCTRODES PUNTA EN L O GANXO	30043355	Elèctrode punta L (ganxo) pla per a coagulació i dissec monopolar, n/retràctil, beina aiïlada, eix Ø5mmx36cm útils+/-2cm, acer inox i recobr punta PTFE transp, p/laparc i torac a/cànules Ø≥5mm, n/làtex, estèril, 1ús. Compatible amb mànec electroquirúrgic estàndard	No Obligatori
5	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: NANSES CONITZACIÓ	30009080	Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida gran G, dissecció 15mmx18mm, llargada total 130mm+/- 5mm, rotació 360°, de tungstè. Compatible amb connexió de Ø 2,8mm. Lliure làtex, estèril, un sol ús.	Si Obligatori
5	COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: NANSES CONITZACIÓ	30040707	Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida mitjana M, dissecció 12mmx15mm, llargada total 132mm+/- 5mm, rotació 360°, de tungstè. Compatible amb connexió de Ø 2,8mm. Lliure làtex, estèril, un sol ús.	Si Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	COAGULACIÓ MONOPOLAR: PLAQUES DE RETORN PACIENT	30004172	Placa electroquirúrgica bilobulada per a pacient adult-pediàtric,adhesiva pregelada a/gel conductor hipoalèrgic,impermeable a fluids(TST-PE),anell de seguretat.Mides:12x13cm±1cm,superfície conductora 96,8cm²±1cm².Lliure làtex,un sol ús	No Obligatori
6	COAGULACIÓ MONOPOLAR: PLAQUES DE RETORN PACIENT	30010688	Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva,pregelada amb gel hipoalèrgic,per a pacient adult a partir 13.6 kg,mides aprox 11.43cmx18.26cm(208cm2)+/-2cm i conduc 16.51cm x 9.5cm(156cm2)+/-2cm,amb cable 2,7m-3m.Conn/estàndard.Lliure làtex,un sol ús	No Obligatori
7	COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: PINCES CONVENCIONALS	30058926	Pinça bipolar en baioneta tipus Malis,punta fina,sense topall de tancament.Mides:20cm+/-1cm de longitud,punta 0,5mm aïllada i antiadherent,cos d'alumini i punta de plata,amb cable integrat,a/pedal.Estèril,un sol ús.Compatible generador Malis o equivalent	No Obligatori
8	COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: PINCES CONVENCIONALS	30040922	Pinça bipolar laparoscòpia p/recta roma finestra obert simètr,segella fins Ø 7mm,mida: Ø 5x310+/-20mm long total,rotació 360°,mànec ergonòmic,activació pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comptible electroq bipolar,tipus AF GN200 o equival.	No Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30037989	Equip de tubs d'aspiració/irrigació per a sistema ultrasònic(tub curt Øextern 10mm,long 350cm+/-20cm/tub llargØ extern 7mm,long 400cm+/-20cm),Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible amb sistema ultrasònic tipus Sonastar/Misonix o equivalent	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30038000	Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta curta de punta estàndard de 7,62cm+/-1cm de long de treball,Øint 1,9mm,per a cirurgia oberta,Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Sonastar/Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30038001	Terminal d'aspiració equip ultrasons,corba llarga de punta estàndard de 18,42cm+/-1cm de longitud de treball,Øintern 1,9mm,per a cirurgia oberta,Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta Sonastar/Misonix o equivalent	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30041611	Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta curta de punta dentada de 7,62cm+/-1cm de long de treball,Øint 1,9mm,per a cirurgia oberta,Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Sonastar/Misonix o eq	Si Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30041612	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,punta llarga estàndard per a laparoscòpia,30cm+/-2cm long treball,Øint 1,9mm.REUTILITZABLE per a 6 usos,NO ESTÈRIL autoclavable.Inclou 6 puntes silicona estèrils.Comp/peça mà recta curta Sonastar/Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30041619	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta llarga de punta estàndard amb protector rígid,de 13,8cm+/-1cm long treball,Øint 1,9mm,cirurgia oberta accés profund.Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible amb peça mà curta recta Eq/Sonastar/Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047578	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 10mm,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de ,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047579	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047580	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 25mm,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047581	Terminal/Punta llima d'os per a equip ultrasònic,macro ganxo 2,2 x 3,0mm,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/equip ultrasònic Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047582	Terminal/Punta fresa d'os per a equip ultrasònic,fresa de diamant de Ø4,4mm,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq	Si Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047583	Equip tubs d'irrigació de la zona de tall d'os de PVC per a sistema ultrasònic amb connexió roscada,material:secció de la bomba de silicona,adaptadors de PP i plàstic ABS,punta PE i plàstic ABS.Lliure làtex, estèril,un sol ús.Comp/equip US Misonix o eq	Si Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047584	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm,inclou extensió llarga corba i funda de silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq	SI Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047585	Terminal/Punta fulla cureta de desbridament de ferides,per a equip ultrasònic,aliatge de titani.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,envàs unitari.Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.	SI Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30047586	Terminal/Punta fulla cilíndrica de desbridament de ferides,per a equip ultrasònic,aliatge de titani.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,envàs unitari.Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.	SI Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30048834	Terminal/Punta llima d'os per a equip ultrasònic,micro ganxo 1,3x 1,8mm,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/equip ultrasònic Misonix o eq	SI Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30051395	Terminal/Punta serrada 20mm amb extensió curta i funda de silicona,per dissecció amb ultrasons de teixits durs,lliure de làtex,estèril,un sol ús, Com/equip ultrasònic Misonix o eq	SI Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	30059968	Terminal/Punta dentada per desbridament de ferides d'equip ultrasònic, ampla, cureta amb tub d'aspiració integrat.Material: aliatge de titani. Lliure de làtex, estèril,un sol ús, envàs unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.	SI Obligatori
9	ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT	80011033	Peça de mà recta curta, mida 2x 13+/-1cm ,de plàstic rígid.Longitud cable 5,0-5,2m. Freqüència 23kHz.Lliure de làtex,no estèril,reutilitzable,compatible sistema ultrasons Sonastar o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059526	Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø10x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059527	Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x90mm+/-5mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059528	Terminal/sonda extractor per a taps de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059895	Terminal/sonda perforador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,Ø8,0x270mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059896	Terminal/sonda raspador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x270mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059897	Terminal/sonda perforador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,pla , 90mm+/-5mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30059898	Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
10	TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT	30060474	Terminal/sonda aixadella per a extracció de ciment en conductes estrets amb ultrasons US,Ø8,0x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30025015	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta, punta tipus Spetzler barracuda,mida: 11,4cm+/-1cm de llargària,Øextern 1,92mm,Øintern 1,50mm,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equ	SI Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30025016	Equip de tubs material plàstic compatible amb sistema d'irrigació/aspiració ultrasònic Sonopet o equivalent.Estèril,un sol ús	SI Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30043610	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons, ganiveta serrada agressiva, per a dissecció de teixit ossi,diàmetre 0,8mmx12,4mm long tall i 11cm+/-1cm long total,titani,estèril,lliure de làtex,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o eq	SI Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30050724	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta,mida: 11,4cm+/-1cm de llargària,Øextern 1,92mm,Øintern 1,50mm,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equivalent	SI Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30054263	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta tipus Payner 360 super llarga XL,per a dissecció de teixit ossi,11,4+/-1cm de long, 2,7mm long tall,3,12mm amplada tall,de titani.Estèril,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equ	Si Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30054264	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta, punta tipus Spetzler barracuda Extra-Llarga XL,mida: 20cm+/-1cm de llargària,long tall 1,92mm,Øint1,5mm,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equ	Si Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30054265	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta universal Extra-Llarga XL,mida: 20cm+/-1cm de llargària,long de tall 1,92mm,Ø1,5mm,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equivalent	Si Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30060564	Terminal recta punta estàndar 12cm,mides:115mm+/-5mm de longitud, Øext 1,92mm,Øint 1,5mm,de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent	Si Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30060565	Terminal recta punta tipus barracuda 12cm,mides:115mm+/-5mm de longitud,Øext 1,92mm,Øint 1,5mm.de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent	Si Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30060566	Equip de tubs de material plàstic. Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent	Si Obligatori
11	DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT	30060567	Terminal recta punta estàndar 20cm,mides:205mm+/-5mm de longitud, Øext 1,92mm,Øint 1,5mm,de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent	Si Obligatori
12	COAGULACIÓ PER GAS ARGÓ PER A CIRURGIA TANCADA, COMPATIBLE AMB SISTEMA BEAMER O EQUIVALENT	30012359	Sonda per a coagulació amb argó endoscòpi flexible. Ø2.3mm, 2.3m+/-0,3m de llargària,punta de ceràmica.Línia de connexió MABS per a sondes flexibles.Activació amb pedal.Lliure de làtex,estèril,un sol ús	No Obligatori
13	SISTEMA QUIRÚRGIC PER ULTRASONS I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA PIEZOELECTRIC O EQUIVALENT	30033795	Tub d'irrigació per a sistema quirúrgic d'ultrasó,mides: diàmetre 2,8mm, longitud 350mm+/-30mm,de silicona,estèril.Compatible per a sistema Piezoelèctric o equivalent.	Si Obligatori
13	SISTEMA QUIRÚRGIC PER ULTRASONS I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA PIEZOELECTRIC O EQUIVALENT	30060085	Bisturí plà per motor ultrasò,mida: 21,6x11,1x3 Øx0.5mm. Estèril.Compatible sistema Piezoelectric o equivalent.	Si Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101379927/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
14	COAGULACIÓ BIPOLAR AVANÇADA, SEGELLADORA PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: PINCES COMPATIBLES AMB SISTEMA COOLSEAL O EQUIVALENT	30060119	Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 12mm, 20cm+/-1cm long eix, Ø5mm eix, 11mm long segellat, 10mm long tall, segella vasos fins Ø7mm, segella indep tall. Obert bilat, activa manual, rota 335°, mànec ergo. S/làtex, estèril, 1 ús. Comp/generador Coolseal o eq	Si Obligatori
14	COAGULACIÓ BIPOLAR AVANÇADA, SEGELLADORA PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: PINCES COMPATIBLES AMB SISTEMA COOLSEAL O EQUIVALENT	30060120	Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm, 30cm+/-1cm long eix, Ø5mm eix, 19mm long segellat, 18mm long tall, segella vasos fins Ø7mm, segella indep tall. Obert bilat, activa manual, rota 360°, mànec ergo. S/làtex, estèril, 1 ús. Comp/generador Coolseal o eq	Si Obligatori
14	COAGULACIÓ BIPOLAR AVANÇADA, SEGELLADORA PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: PINCES COMPATIBLES AMB SISTEMA COOLSEAL O EQUIVALENT	30060121	Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm, 37cm+/-1cm long eix, Ø5mm eix, 19mm long segellat, 18mm long tall, segella vasos fins Ø7mm, segella indep tall. Obert bilat, activa manual, rota 360°, mànec ergo. S/làtex, estèril, 1 ús. Comp/generador Coolseal o eq	Si Obligatori
14	COAGULACIÓ BIPOLAR AVANÇADA, SEGELLADORA PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: PINCES COMPATIBLES AMB SISTEMA COOLSEAL O EQUIVALENT	30060122	Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm, 44cm+/-2cm long eix, Ø5mm eix, 19mm long segellat, 18mm long tall, segella vasos fins Ø7mm, segella indep tall. Obert bilat, activa manual, rota 360°, mànec ergo. S/làtex, estèril, 1 ús. Comp/generador Coolseal o eq	Si Obligatori
14	COAGULACIÓ BIPOLAR AVANÇADA, SEGELLADORA PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: PINCES COMPATIBLES AMB SISTEMA COOLSEAL O EQUIVALENT	30043231	Pinça bipolar punta corba 10mm long, tipus Maryland, eix 20cm+/-1cm long, 3mm Ø, segellat fins Ø5mm baixa potència, dispersió tèrmica inf 1mm, rotació fins 340°, activa manu cable integrat, c.gen-pediàt. Lliure de làtex, estèril, un ús, Comp/generador Coolseal o eq	No Obligatori
15	ACCESORIS I VARIS	30042790	Tub corrugat als extrems, adaptable a mànec bisturi, peces de suport per a l'aspiració de fums quirúrgics, material de plàstic, Ø 10mm, longitud 1,80m-2,0m, connexió distal Ø 22 mm, superfície interior llisa, estèril. Compatible amb tub de connexió Ø 22 mm	No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30004172
Descripció llarga: Placa electroquirúrgica bilobulada per a pacient adult-pediàtric, adhesiva pregelada a/gel conductor hipoalèrgic, impermeable a fluids (TST-PE), anell de seguretat. Mides: 12x13cmx1cm, superfície conductora 96,8cm²x1cm². Lliure làtex, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30009080
Descripció llarga: Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida gran G, dissecció 15mmx18mm, llargada total 130mm+/-5mm, rotació 360°, de tungstè. Compatible amb connexió de Ø 2,8mm. Lliure làtex, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30010688
Descripció llarga: Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva, pregelada amb gel hipoalèrgic, per a pacient adult a partir 13.6 kg, mides aprox 11.43cmx18.26cm (208cm²)+/-2cm i conduc 16.51cm x 9.5cm (156cm²)+/-2cm, amb cable 2,7m-3m. Conn/estàndard. Lliure làtex, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30012359
Descripció llarga: Sonda per a coagulació amb argó endoscòpi flexible. Ø2.3mm, 2.3m+/-0,3m de llargària, punta de ceràmica. Línia de connexió MABS per a sondes flexibles. Activació amb pedal. Lliure de làtex, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30025015
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons, recta, punta tipus Spetzler barracuda, mida: 11,4cm+/-1cm de llargària, Øextern 1,92mm, Øintern 1,50mm, de titani, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equ		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30025016
Descripció llarga: Equip de tubs material plàstic compatible amb sistema d'irrigació/aspiració ultrasònic Sonopet o equivalent. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30033795
Descripció llarga: Tub d'irrigació per a sistema quirúrgic d'ultrasò, mides: diàmetre 2,8mm, longitud 350mm+/-30mm, de silicona, estèril. Compatible per a sistema Piezoelèctric o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30037989
Descripció llarga: Equip#def#tubs#d'aspiració/irrigació per a sistema ultrasònic (tub curt Øextern 10mm, long 350cm+/-20cm/tub llarg Ø extern 7mm, long 400cm+/-20cm), Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible amb sistema#ultrasònic tipus Sonastar/Misonix o equivalent		

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30038000
Descripció llarga: Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta curta de punta estàndard de 7 ,62cm+/-1cm de long de treball,Øint 1,9mm,per a cirurgia obe rta,Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta Sonastar/Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30038001
Descripció llarga: Terminal d'aspiració equip ultrasons,corba llarga de punta estàndard de 18 ,42cm+/-1cm de longitud de treball,Øintern 1,9mm,per a cir urgia oberta,Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta Sonastar/Misonix o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30040707
Descripció llarga: Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida mitjana M,dissecció 12mmx15mm,llargada total 132m m+/-5mm ,rotació 360°,de tungstè.Compatible amb connexió de Ø 2,8mm.Lliure làtex, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30040922
Descripció llarga: Pinça bipolar laparoscòpia p/recta roma finestra obert simètr,segella fins Ø 7mm,mida: Ø 5x310+/-20mm long total,rotació 360°,mànc ergonòmic ,activació pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comptible electroq bipolar,tipus AF GN200 o equival.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30041611
Descripció llarga: Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta curta de punta dentada de 7 ,62cm+/-1cm de long de treball,Øint 1,9mm,per a cirurgia obert a,Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Sonastar/Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30041612
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,punta llarga estàndard per a laparoscòpia,30cm+/-2cm long treball,Øint 1,9mm.REUTILITZABL E per a 6 usos,NO ESTERIL autoclavable.Inclou 6 puntes silicona estèrils.Comp/peça mà recta curta Sonastar/Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30041619
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta llarga de punta estàndard amb protector rígíd,de 13,8cm+/-1cm long treball,Øint 1,9 mm,cirurgia oberta accés profund.Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible amb peça mà curta recta Eq/Sonastar/Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30042359
Descripció llarga: Elèctrode amb punta de ganxo en L, aïllat,cos de diàmetre 3mm x 34+/-1cm de llargària, mànc ergonòmic, amb connexió monopolar de 4mm tipus banana, d'acer inox i material plàstic, per a cirurgia laparoscòpia i pediàtrica, estèril, d'un sol ús		

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30042736
Descripció llarga: Electrocauteri bipolar de punta llaç amb bateria,de 7mm part activa,tija flexible de 5cm+/-0,5cm,màneg d'activació manual de coagulació, d'alta temperatura (1204°C), longitud total sense tapa protectora 18,9cm+/-1cm (amb tapa 23cm).Estèril,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30042790
Descripció llarga: Tub corrugat als extrems,adaptable a màneg bisturí,peces de suport per a l'aspiració de fums quirúrgics, material de plàstic, Ø 10mm , longitud 1 , 80m-2,0m,connexió distal Ø 22 mm, superfície interior llisa,estèril.Compatible amb tub de connexió Ø 22 mm		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30043231
Descripció llarga: Pinça bipolar punta corba 10mm long,típus Maryland,eix 20cm+/-1cm long, 3mm Ø,segellat fins Ø5mm baixa potència,dispersió tèrmica in f 1mm,rotació fins 340°,activa manu cable integrat,c.gen-pediàt.Lliure de làtex,estèril,un ús,Comp/generador Coolseal o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30043355
Descripció llarga: Elèctrode punta L (ganxo) pla per a coagulació i dissec monopolar ,n/retràctil,beina aïllada,eix Ø5mmx36cm útils+/-2cm,acer inox i re cobr punta PTFE transp,p/laparc i torac a/cànulesØ#5mm,n/làtex ,estèril,lús.Compatible amb màneg electroquirúrgic estàndard		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30043610
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,ganiveta serrada agressiva,per a dissecció de teixit ossi,diàm/fulla 0,8mmx12,4mm long ta ll i 11cm+/-1cm long total,titani,estèril,lliure de làtex,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30047578
Descripció llarga: Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 10mm ,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de ,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30047579
Descripció llarga: Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm ,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30047580
Descripció llarga: Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 25mm ,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq		

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30047581
Descripció llarga: Terminal/Punta llima d'os per a equip ultrasònic,macro ganxo 2,2 x 3,0mm ,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30047582
Descripció llarga: Terminal/Punta fresa d'os per a equip ultrasònic,fresa de diamant de Ø4 ,4mm,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani ,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30047583
Descripció llarga: Equip tubs d'irrigació de la zona de tall d'os de PVC per a sistema ultrasònic amb connexió roscada,material:secció de la bomba de silicona ,adaptadors de PP i plàstic ABS,punta PE i plàstic ABS.Lliure làtex, estèril,un sol ús.Comp/equip US Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30047584
Descripció llarga: Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm ,inclou extensió llarga corba i funda de silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30047585
Descripció llarga: Terminal/Punta fulla cureta de desbridament de ferides,per a equip ultrasònic,aliatge de titani.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,en vàs unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30047586
Descripció llarga: Terminal/Punta fulla cilíndrica de desbridament de ferides,per a equip ultrasònic,aliatge de titani.Lliure de làtex,estèril,un sol ú s,en vàs unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30048834
Descripció llarga: Terminal/Punta llima d'os per a equip ultrasònic,micro ganxo 1,3x 1,8mm ,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirurgia teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30050724
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta,mida: 11,4cm+/-1cm de llargària,Øextern 1,92mm,Øintern 1,50mm,de titani,lliure de làtex ,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equivalent		

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30051395
Descripció llarga: Terminal/Punta serrada 20mm amb extensió curta i funda de silicona,per dissecció amb ultrasons de teixits durs,lliure de làtex,estèril,un sol ús, Com/equip ultrasònic Misonix o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30054097
Descripció llarga: Electrobisturi monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma antiad/aïllada ,mànc c/manual(tall-coagulació) basculant,conn/8mm sortid a de fluids,connexió tub 22mm a sistema evacuació de fums tipus SafeAir o Neptune o eq.Lliure làtex,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30054098
Descripció llarga: Electrobisturi monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma antiadherent aïllada,mànc control manual(tall-coagulació) amb botons,co nn 8mm sortida de fluids,conn tub 22mm a sistema evacuació de fums SafeAir o Neptune o eq.Lliure làtex,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30054099
Descripció llarga: Electrobisturi monopolar amb evacuació de fums telescòpic,fins a 120mm ,punta plana roma antiadherent aïllada,mànc c/manual(tall-coa gulació)a/ botons,conn 8mm sort fluids,conn tub 22mm sist evacuació fums SafeAir o Neptune o eq.s/làtex,estèril,1sol ús		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30054263
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta tipus Payner 360 super llarga XL,per a dissecció de teixit ossi,11,4+/-1cm de long, 2,7mm long tall,3,12mm amplada tall,de titani.Estèril,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equ		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30054264
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta, punta tipus Spetzler barracuda Extra-Llarga XL,mida: 20cm+/-1cm de llargària,long tall 1 ,92mm,Øint1,5mm,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equ		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30054265
Descripció llarga: Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta universal Extra-Llarga XL ,mida: 20cm+/-1cm de llargària,long de tall 1,92mm,Ø1,5mm, de titani ,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30054444
Descripció llarga: Elèctrode punta agulla de microdissecció per a electrobisturi monopolar.Agulla de tungstè ultrafina,eix aïllat amb polímer,10-11cm de longitud total, punta de 3mm en angle de 45°.Sense làtex, estèril,un sol ús.		

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30058926
Descripció llarga:		
Pinça bipolar en baioneta tipus Malis,punta fina,sense topall de tancament.Mides:20cm+/-1cm de longitud,punta 0,5mm aïllada i antiad herent ,cos d'alumini i punta de plata,amb cable integrat,a/pedal.Estèril,un sol ús.Compatible generador Malis o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30059526
Descripció llarga:		
Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø10x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,u n sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30059527
Descripció llarga:		
Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x90mm+/-5mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30059528
Descripció llarga:		
Terminal/sonda extractor per a taps de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús.Compatibleamb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30059895
Descripció llarga:		
Terminal/sonda perforador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,Ø8,0x270mm+/-10mm de longitud,titani,estè ril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30059896
Descripció llarga:		
Terminal/sonda raspador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x270mm+/-10mm de longitud,titani,estèri l,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30059897
Descripció llarga:		
Terminal/sonda perforador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,pla , 90mm+/-5mm de longitud,titani,estèr il,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30059898
Descripció llarga:		
Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril, un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		

SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30059968
Descripció llarga: Terminal/Punta dentada per desbridament de ferides d'equip ultrasònic, ampla, cureta amb tub d'aspiració integrat.Material: aliatge de titani. Lliure de latex, estèril,un sol ús, envàs unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30060085
Descripció llarga: Bisturi plà per motor ultrasò,mida: 21,6x11,1x3 Øx0.5mm. Estèril.Compatible sistema Piezoelectric o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30060119
Descripció llarga: Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 12mm,20cm+/-1cm long eix ,Ø5mm eix,11mm long segellat,10mm long tall,segella vasos fi nsØ7mm,segeilla indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 335°,manec ergo.S/latex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30060120
Descripció llarga: Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm,30cm+/-1cm long eix ,Ø5mm eix,19mm long segellat,18mm long tall,segella vasos fi nsØ7mm,segeilla indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 360°,manec ergo.S/latex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30060121
Descripció llarga: Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm,37cm+/-1cm long eix ,Ø5mm eix,19mm long segellat,18mm long tall,segella vasos fi nsØ7mm,segeilla indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 360°,manec ergo.S/latex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30060122
Descripció llarga: Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm,44cm+/-2cm long eix ,Ø5mm eix,19mm long segellat,18mm long tall,segella vasos fi nsØ7mm,segeilla indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 360°,manec ergo.S/latex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30060474
Descripció llarga: Terminal/sonda aixadella per a extracció de ciment en conductes estretsamb ultrasons US,Ø8,0x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril ,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101379927	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30060564
Descripció llarga: Terminal recta punta estàndar 12cm,mides:115mm+/-5mm de longitud, Øext 1 , 92mm,Øint 1,5mm,de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet IQ o equivalent		

SOL.COMANDA: 1101379927 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30060565

Descripció llarga:

Terminal recta punta tipus barracuda 12cm,mides:115mm+/-5mm de longitud ,Øext 1,92mm,Øint 1,5mm.de titani.Estèril,un sol ús.Compatibl e amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent

SOL.COMANDA: 1101379927 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30060566

Descripció llarga:

Equip de tubs de material plàstic. Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equiv alent

SOL.COMANDA: 1101379927 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30060567

Descripció llarga:

Terminal recta punta estàndar 20cm,mides:205mm+/-5mm de longitud, Øext 1 ,92mm,Øint 1,5mm,de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent

SOL.COMANDA: 1101379927 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 80011033

Descripció llarga:

Peça de mà recta curta, mida 2x 13+/-1cm ,de plàstic rígid.Longitud cable 5,0-5,2m. Freqüència 23kHz.Lliure de làtex,no estèril,reut ilitzable , compatible sistema ultrasons Sonastar o equivalent

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Num. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101379927/24/PNSP	Subministrament agregat d'Electrocirurgia bàsica general i material per a cirurgia per ultrasó_Desert
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
LOT	
Tipus oferta	
Codi SAP	
Codi Agrupador	
Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
Fabricant	
(SI / NO)	
Distribuidor	
(SI / NO)	
Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	
* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció breu del producte	
Imatge de la referència	
Descripció ampliada del producte	
Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
(SI/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 reguladó prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101379927/24/PNSP	Subministrament agregat d'Electrocirurgia bàsica general i material per a cirurgia per ultrasó_Desert
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi Agrupador	
LOT	
Tipus oferta	

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO)	Distribuidor	(SI / NO)
-----	-----	-----------	-----------	--------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model			
Referència distribuïdor			
Referència fabricant			
Envasat del material ofertat *			
Material de fabricació *			
Mides del material ofertat *			

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Nom
NIF

LOT 1 - COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS AMB BATERIA (Lot No Obligatori)

LOT	CODI SAP	Descripció	Criteris objectius	
			<u>Carbur tunsté.</u> Per aquells materials que tinguin en la seva composició carbur de tunsté es valorarà, que aquest material sigui igual o superior a 99 % <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Ergonomia i facilitat d'ús.</u> Es valorarà que el mànec de l'electrobisturi sigui texturitzat per evitar que rellisqui amb els guants <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>
			10 punts SI/NO	10 punts SI/NO
1	30042736	Electrocauteri bipolar de punta llaç amb bateria,de 7mm part activa,tija flexible de 5cm+/-0,5cm,mànec d'activació manual de coagulació, d'alta temperatura (1204°C),longitud total sense tapa protectora 18,9cm+/-1cm (amb tapa 23cm).Estèril,d'un sol ús.		

ES OBLIGATORI OMLIR AQUEST ANNEX D4

Nom

NIF

LOT 2 -COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS CONVENCIONALS AMB EVACUACIÓ DE FUMS (Lot Obligatori)

		Criteris objectius			
LOT	CODI SAP	Descripció	<u>Bona/Optima connexió de l'elèctrode al mànec.</u>	<u>Ergonomia i facilitat d'ús.</u>	<u>Avisos acústics i visuals.</u>
			Connexió universal a mànec de 2,38-2,4mm-3/32"	Es valorarà que el mànec de l'electrobisturí sigui texturitzat per evitar que relisqui amb els guants	Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats
			Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.	Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.	Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.
			15 punts	10 punts	10 punts
			SI/NO	SI/NO	SI/NO
2	30054097	Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma antiad/aiçada, mànec c/manual(tall-coagulació) basculant,conn/8mm sortida de fluids,connexió tub 22mm a sistema evacuació de fums tipus SafeAir o Neptune o equ.Lliure làtex,estèril,un sol ús.			
2	30054098	Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma antiadherent aïllada,mànec control manual(tall-coagulació) amb botons,conn 8mm sortida de fluids,conn tub 22mm a sistema evacuació de fums SafeAir o Neptune o eq.Lliure làtex,estèril,un sol ús			
2	30054099	Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums telescòpic, fins a 120mm, punta plana roma antiadherent aïllada, mànec c/manual(tall-coagulació)a/ botons,conn 8mm sort fluids,conn tub 22mm sist evacuació fums SafeAir o Neptune o eq.s/làtex,estèril,1sol ús			

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Nom

NIF

LOT 3 - COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELÈCTRODES PUNTA AGULLA (Lot No Obligatori)

LOT	CODI SAP	Descripció	Criteris objectius			
			<u>Bona/Óptima connexió de l'èlectrode al mànec.</u> Connexió universal a mànec de 2,38-2,4mm-3/32", ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Carbur tunsté.</u> Per aquells materials que tinguin en la seva composició carbur de tunsté es valorarà, que aquest material sigui igual o superior a 99 % <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Punta antiadherent i protegida.</u> Es valorarà que la part activa de l'èlectrode sigui antiadherent <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	15 punts SI/NO
			10 punts SI/NO	15 punts SI/NO		
3	30054444	Elèctrode punta agulla de microdissecció per a electrobisturí monopolar. Agulla de tungstè ultrafina, eix aïllat amb polímer, 10-11cm de longitud total, punta de 3mm en angle de 45°. Sense làtex, estèril, un sol ús.				

ES OBLIGATORI OMPLIR AQUEST ANNEX D4

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l’aplicació dels criteris objectius

Nom	
NIF	

LOT 4 - COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA TANCADA: ELÈCTRODES PUNTA EN LO GANXO (Lot

		Criteris objectius	
		<u>Punta antiadherent i protegida.</u>	
		Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent	
		Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.	
		15 punts	
		SI/NO	
LOT	CODI SAP	Descripció	
4	30042359	Elèctrode amb punta de ganxo en L, aïllat,cos de diàmetre 3mm x 34+/-1cm de llargària, mànec ergonòmic, amb connexió monopolar de 4mm tipus banana, d'acer inox i material plàstic, per a cirurgia laparoscòpia i pediàtrica, estèril, d'un sol ús	
4	30043355	Elèctrode punta L (ganxo) pla per a coagulació i dissec monopolar,n/retràctil,beina aïllada,eix Ø5mmx36cm útils+/- 2cm,acer inox i recobr punta PTFE transp.p/laparc i torac a/cànulesØ≥5mm,n/làtex,estèril,1ús.Compatible amb mànec electroquirúrgic estàndard	

ES OBLIGATORI OMPLIR AQUEST ANNEX D4

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Nom	
NIF	

LOT 5 - COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: NANSES CONITZACIÓ (Lot Obligatori)

			Criteris objectius		
LOT	CODI SAP	Descripció	<u>Carbur tungsté.</u> Per aquells materials que tinguin en la seva compisició carbur de tungsté es valorarà, que aquest material sigui igual o superior a 99 % <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Punta antiadherent i protegida.</u> Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Codificació de color segons mida.</u> Es valorarà que les diferents mides de les nanses siguin codificades amb colors <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>
			10 punts SI/NO	10 punts SI/NO	10 punts SI/NO
5	30009080	Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida gran G,dissecció 15mmx18mm, llargada total 130mm+/-5mm, rotació 360°, de tungstè.Compatible amb connexió de Ø 2,8mm.Lliure làtex, estèril, un sol ús.			
5	30040707	Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida mitjana M,dissecció 12mmx15mm, llargada total 132mm+/-5mm, rotació 360°, de tungstè.Compatible amb connexió de Ø 2,8mm.Lliure làtex, estèril, un sol ús.			

Nom	
NIF	

LOT 6 - COAGULACIÓ MONOPOLAR: PLAQUES DE RETORN PACIENT (Lot No Obligatori)

		Criteris objectius				
LOT	CODI SAP	Descripció	<u>Amb cable incorporat/longitud de cable.</u> Es valorarà que els dispositius portin incorporat el cable amb longitud igual o superior a 3 metres. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>Anell seguretat.</u> Es valorarà que la placa tingui anells de seguretat <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>	<u>UNE-EN 60601-2-2: 2009</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS i omplir el Annex D4.
			10 punts SI/NO	10 punts SI/NO	10 punts SI/NO	10 punts SI/NO
6	30004172	Placa electroquirúrgica bilobulada per a pacient adult-pediàtric, adhesiva pregelada a/gel conductor hipoalèrgic, impermeable a fluids (TST-PE), anell de seguretat. Mides: 12x13cm±1cm, superfície conductora 96,8cm²±1cm². Lliure làtex, un sol ús	NO APLICA		NO APLICA	
6	30010688	Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva, pregelada amb gel hipoalèrgic, per a pacient adult a partir 13.6 kg, mides aprox 11.43cmx18.26cm(208cm²)+/-2cm i conduc 16.51cm x 9.5cm(156cm²)+/-2cm, amb cable 2,7m-3m. Conn/estàndard. Lliure làtex, un sol ús				

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Nom	
NIF	

LOT 7 - COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: PINCES CONVENCIONALS (Lot No Obligatori)

LOT	CODI SAP	Descripció	Criteris objectius	
			<u>Ergonomia i facilitat d'ús.</u> Es valorarà que el mànec de l'electrobisturí sigui texturitzat per evitar que rellisqui amb els guants <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts SI/NO	<u>Amb cable incorporat/longitud de cable.</u> Es valorarà que els dispositius portin incorporat el cable amb longitud igual o superior a 3 metres. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts SI/NO
7	30058926	Pinça bipolar en baioneta tipus Malis,punta fina,sense topall de tancament.Mides:20cm+/-1cm de longitud,punta 0,5mm aïllada i antiadherent,cos d'alumini i punta de plata,amb cable integrat,a/pedal.Estèril,un sol ús.Compatible generador Malis o equivalent		

ES OBLIGATORI OMPLIR AQUEST ANNEX D4

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Nom	
NIF	

LOT 8 - COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA TANCADA: PINCES CONVENCIONALS (Lot No Obligatori)

		Criteris objectius	
LOT	CODI SAP	Descripció	<u>Puntes antiadherents i protegides.</u> Es valorarà que la part activa de les puntes siguin antiadherents. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>
			15 punts SI/NO
8	30040922	Pinça bipolar laparoscòpia p/recta roma fenestra obert simètr, segella fins Ø 7mm, mida: Ø 5x310+/-20mm long total, rotació 360°, mànec ergonòmic, activació pedal. Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible electroq bipolar, tipus AF GN200 o equival.	<u>Amb cable incorporat/longitud de cable.</u> Es valorarà que els dispositius portin incorporat el cable amb longitud igual o superior a 3 metres. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i>
			15 punts SI/NO

ES OBLIGATORI OMPLIR AQUEST ANNEX D4

Nom

NIF

LOT 9 - ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT (Lot Obligatori).

			Criteris objectius				
LOT	CODI SAP	Descripció	<u>Punta antiadherent i protegit.</u> Es valorarà que la part activa de l'electrode sigui antiadherent que estigui. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts SI/NO	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts SI/NO	<u>Longitud dels equips d'irrigació/aspiració.</u> Es valorarà que els equips tinguin longitud igual o superior a 3 metres. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts SI/NO	Número màxim usos de la peça de mà. Es valorarà que el proveïdor indiqui el número màxim d'usos de la peça de mà. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts SI/NO	Número màxim usos de la peça de mà. Es valorarà que el proveïdor indiqui el número màxim d'usos de la peça de mà. <i>Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.</i> 10 punts NÚM
9	30037989	Equip de tub d'aspiració/irrigació per a sistema ultrasoníic curt Øintern 10mm, long 350cm +/-20cm/tub llarg Ø extern 7mm, long 400cm +/-20cm, Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible amb sistema ultrasoníic tipus Sonastar/Misonix o equivalent	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA
9	30038000	Terminal d'aspiració equip ultrasons, recta curta de punta estàndard de 7,62cm +/-1cm de long de treball, Øint 1,9mm, per a cirurgia oberta, Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Sonastar/Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30038001	Terminal d'aspiració equip ultrasons, corba llarga de punta estàndard de 18,42cm +/-1cm de longitud de treball, Øintern 1,9mm, per a cirurgia oberta, Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible peça de mà curta recta Sonastar/Misonix o equivalent			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30041611	Terminal d'aspiració equip ultrasons, recta curta de punta dentada de 7,62cm +/-1cm de long de treball, Øint 1,9mm, per a cirurgia oberta, Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Sonastar/Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30041612	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons, punta llarga estàndard per a laparoscòpia, 30cm +/-1cm long treball, Øint 1,9mm, REUTILITZABLE per a ús, NO ESTÈRIL autoclavable. Inclou 6 puntes silicona estèrils Comp/peça mà recta curta Sonastar/Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30041619	Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons, recta llarga de punta estàndard amb protector rígida de 13,8cm +/-1cm long treball, Øint 1,9mm, cirurgia oberta accés profund. Lliure làtex, estèril, sol ús. Compatible amb peça mà curta recta Eq/Sonastar/Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047578	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasoníic, fulla roma de 10mm, inclou extensió curta i funda de silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur, traumatològica, NCR i/o CMF. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047579	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasoníic, fulla roma de 20mm, inclou extensió curta i funda de silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur, traumatològica, NCR i/o CMF. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047580	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasoníic, fulla roma de 25mm, inclou extensió curta i funda de silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur, traumatològica, NCR i/o CMF. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047581	Terminal/Punta llina d'os per a equip ultrasoníic, macro ganxo 2,2 x 3,0mm, inclou extensió curta i funda silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur, traumatològica, NCR i/o CMF. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047582	Terminal/Punta fresa d'os per a equip ultrasoníic, fresa de diamant de Ø4,4mm, inclou extensió curta i funda silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur, traumatològica, NCR i/o CMF. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047583	Equip tubs d'irrigació de la zona de tall d'os de PVC per a sistema ultrasoníic amb connexió roscada, material: secció de la bomba de silicona, adaptadors de PP i plàstic ABS, punta PE i plàstic ABS. Lliure làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip US Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047584	Terminal/Punta dissecció d'os per a equip ultrasoníic, fulla roma de 20mm, inclou extensió llarga corba i funda de silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047585	Terminal/Punta cureta de desbridament de ferides, per a equip ultrasoníic, aliatge de titani. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, emís unitari. Compatible equip ultrasoníic Misonix o equivalent.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30047586	Terminal/Punta fulla cilíndrica de desbridament de ferides, per a equip ultrasoníic, aliatge de titani. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, emís unitari. Compatible equip ultrasoníic Misonix o equivalent.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30048834	Terminal/Punta llina d'os per a equip ultrasoníic, micro ganxo 1,3x 1,8mm, inclou extensió curta i funda silicona, aliatge de titani, per a cirurgia teixit dur, traumatològica, NCR i/o CMF. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30051395	Terminal/Punta serrada 20mm amb extensió curta i funda de silicona, per dissecció amb ultrasons de teixit dur, Lliure de làtex, estèril, un sol ús, Comp/equip ultrasoníic Misonix o eq			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	30059968	Terminal/Punta dentada per desbridament de ferides d'equip ultrasoníic, ampla, cureta amb tub d'aspiració integrat. Material: aliatge de titani. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, emís unitari. Compatible equip ultrasoníic Misonix o equivalent.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	80011033	Peça de mà recta curta, mida 2x 13 +/-1cm de plàstic rígida longitud cable 5,0 +/-2m, Freqüència 23KHz. Lliure de làtex, no estèril, reutilitzable, compatible sistema ultrasons Sonastar o equivalent	NO APLICA		NO APLICA		

Nom	
NIF	

LOT 10 - TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O. EQUIVALENT (Lot Obligatori)

		Criteris objectius		
LOT	CODI SAP	Descripció	Punta antiadherent i protegida. Es valorarà que la part activa de l'electrode sigui antiadherent. Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.	Avisos acústics i visuals. Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats Per verificar aquest criteri té que estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.
			10 punts	10 punts
10	30059526	Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US, recte, Ø8,0x180mm+/10mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent	SI/NO	SI/NO
10	30059527	Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US, recte, Ø8,0x90mm+/5mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
10	30059528	Terminal/sonda extractor per a taps de ciment en artroplàstia amb ultrasons US, recte, 1.80mm+/10mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
10	30059895	Terminal/sonda perforador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,Ø8,0x270mm+/10mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
10	30059896	Terminal/sonda raspador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x270mm+/10mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
10	30059897	Terminal/sonda perforador per a extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,pla , 50mm+/5mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
10	30059898	Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x180mm+/10mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		
10	30060474	Terminal/sonda aixadaella per a extracció de ciment en conductes estretsamb ultrasons US,Ø8,0x180mm+/10mm de longitud,titani,esteril,un sol ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent		