

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101386507/24/AMUP

Subministrament agregat Instrumental i accessoris d'un sol
ús per a procediments quirúrgics: cirurgia general,
urològica, proctològica i vascular

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: cirurgia general, urològica, proctològica i vascular per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Els requisits tècnics per lots seran de compliment obligatori així com la presentació de la documentació que acrediti el seu compliment a l'ANNEX D3.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

Els requisits tècnics obligatoris *per TOTS els Lots* son:

-Acreditació vigent per certificació del compliment de la normativa UNE-EN 13485:2018 Productes Sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits per a fins reglamentaris.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3
Omplir Excel d'aquest annex i presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D3.
- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4
No hi ha Excel per omplir, hi ha que presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D4 = Criteris puntuables.
- Fitxa Tècnica Individual Fotogràfica, ANNEX E
Omplir Excel d'aquest annex.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En l'**ANNEX F – Mostres_detall**, es detalla quins són els materials que requereixen la presentació de mostra obligatòria i el nombre de mostres a presentar per a cada un d'ells

En cas que s'hagi de presentar més d'una caixa, indicar quins lots van a cadascuna

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101386507/24/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX F – Mostres_detall**.

Les mostres s'entregaran a la Gerència de Compres, a l'*Àrea de Compres de Materials*, a l'atenció de :[Marietta Carretero Cruz](#), a la direcció següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2^a planta)
Departament: Àrea de Compres de Materials
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en el termini màxim que s'indiqui a la petició.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal** la **validació** d'una **alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

- b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

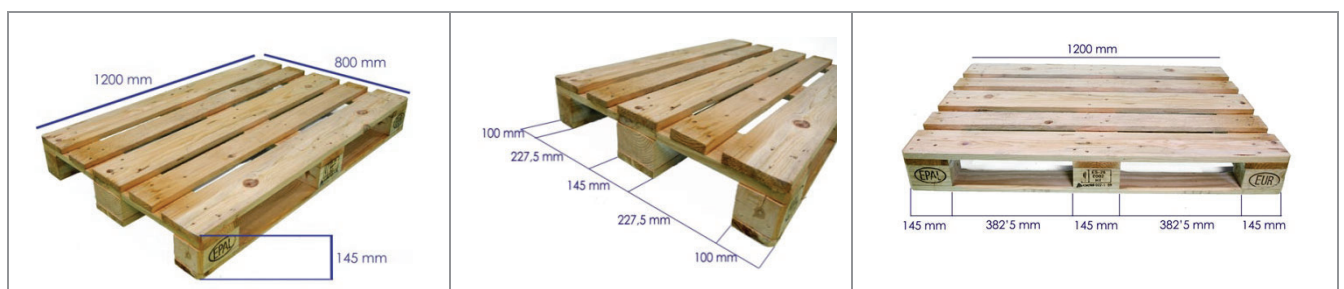

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot

- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.







En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>10. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>11. En cas d'emergència:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. 	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor **(NO HI HA)**

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment **(HI HA)**

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals *(No hi ha Excel per omplir, cal annexar documentació que acrediti compliment dels criteris Annex 4)*

ANNEX E – Fitxa Tècnica Individual Fotogràfica **(HI HA)**

ANNEX F – Presentació de mostres **(HI HA)**

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Fleboextractor	30004022	Extractor de varius/fleboextractor de poliamida (PA) compost de tres olives:(Ø 9,5mm, 12,8mm i 15,4mm aprox),un mànec amb dos cables de 1 ,54/ 1 ,66 mm x 100 cm estèril	Lot No Obligatori
2	Separadors elàstics quirug 360°	30020790	Separador elàstic quirúrgic 360° G 9-14cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP estèril sol ús	Lot Obligatori
2	Separadors elàstics quirug 360°	30020791	Separador/retractor elàstic quirúrgic 360° M 5-9cm a/anell rígid auto-re tracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP estèril sol ús	Lot Obligatori
2	Separadors elàstics quirug 360°	30028243	Separador /retractor elàstic quirúrgic 360° XL 11-17cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP ,estèril,sol ús.	Lot Obligatori
2	Separadors elàstics quirug 360°	30030091	Separador /retractor elàstic quirúrgic 360° XXL 17-25cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP ,estèril,sol ús.	Lot Obligatori
2	Separadors elàstics quirug 360°	30032530	Separador/retract elàstic quirúrgic 360°,mida XL Ø 11-17 cm, auto-retracció per a laparotom i cesàries camp operatiu 227cm².Compost: cèrcol sup rí gid, un de distensió, subjecció automàtic, membrana central transp/impermeab PUR.Lliure làtex/DHP,estèril	Lot Obligatori
2	Separadors elàstics quirug 360°	30032531	Separ/retract elàstic quirúrgic 360° ,mida L ,9-14cm auto-retracció per a laparotom i cesàries Ø camp operatiu 176 cm².Compost:cèrcol sup rígid ,un de distensió, subjecció automàtic,membra central transp/impermeab PUR.Lliure làtex/DHP,estèril	Lot Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30019657	Ganxo per a separ/retractor en interv quirúrgic , acer inox/silicona elàstica amb topalls a/punta semi roma 5 mm,(8unit), estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30031539	Separador o retractor per intervencions quirúrgiques,material de resina, quadrat, mides:14,1x14,1cm amb 4 frontisses lateral 20 obert perifèr.Un sol ús, estèril,lliure làtex.Compatible ganxos 30040195 /30040196 /30019657	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30031540	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta roma de 12mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica sense topalls, estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.(8unit)	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30040196	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta aguda de 5mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30040197	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta aguda de 3mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.(8unit)	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30041994	Separador o retractor per intervencions quirúrgiques, material de resina, forma doble circular asimètrica, mides: 35,5x28,8x15,8x19cm amb 2 frontisses laterals. Sol ús, estèril, lliure làtex. Compatible ganxos 30040196/3 00 40197/30040657/3004540	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30042562	Separador o retractor, tipus Roux o equivalent, longitud 170mm+/-5cm, mides distals: 1 retractor de 36mmx20mm i 1 retractor de 20mmx15mm+/-2mm, plàstic biocompatible, estèril, sol ús.	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30052786	Separador o retractor per intervencions quirúrgiques pediàtriques, material de resina, forma circular asimètrica, mides: 15x10x11,5cm+/-1cm amb 2 frontisses laterals. 1 ús, estèril, lliure làtex. Compatible ganxos 30040196/30040197/30019657/30031540	Lot No Obligatori
3	Separadors retractors resina/silicona i ganxos	30054464	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb puntaroma de 5mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539	Lot No Obligatori
4	Espàtules cerebrals	30034982	Espàtula cerebral atraumàtica, metàl·lica amb revestiment de silicona, plana, recte. Mida: diàmetre 7,5mm, llargària 200mm+/-5cm. Estèril, un sol ús	Lot Obligatori
4	Espàtules cerebrals	30034983	Espàtula cerebral atraumàtica, metàl·lica amb revestiment de silicona, plana, recte. Mida: diàmetre 10mm, llargària 200mm+/-5cm. Estèril, un sol ús	Lot Obligatori
4	Espàtules cerebrals	30034984	Espàtula cerebral atraumàtica, metàl·lica amb revestiment de silicona, plana, recte. Mida: diàmetre 12,5mm, llargària 200mm+/-5cm. Estèril, un sol ús	Lot Obligatori
5	Fixador penis pediàtric	30061839	Fixador-fixador per penis, pediàtric per cirurgies d'hipospàdia i altres IQ uretrals. Placa de polietilè, llisa i dura amb escotadura, orificis i ranures per passar els fils. Mida 150x88x2 mm. Estèr, 1 ús	Lot No Obligatori
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30002705	Pinça/clamp hemostàtica de 12 cm ± 1cm, tipus klemmer, material plàstic, lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.	Lot No Obligatori
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30004258	Pinça de dissecció per a cures, recta fina sense dents, mida 12+/-1 cm a prox, material de plàstic, lliure de làtex, estèril, envàs individual, un sol ús	Lot No Obligatori
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30010703	Pinça clamp hemostàtica de 12cm ±1cm, tipus klemmer, material plàstic, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Presentació envàs 50 unitats	Lot No Obligatori
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30018301	Pinça hemostasia d'acer inox, punta corba, sense dents, tipus Halsted. Mida 12,5+/-1cm estèril, envàs individual, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30031547	Pinça de dissecció de 13cm de plàstic, lliure de làtex, no estèril, un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30042563	Pinça de dissecció recta de 20cm ± 1cm, amb plataforma serrada, tipus Cush ing, de plàstic biocompatible. Lliure de làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
6	Pinces dissecció i hemostàsia	30042564	Pinça tipus Pean, punta recta, 20cm ± 1cm, amb plataforma serrada, de plàstic biocompatible. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031683	Equip torniquet per a cirurgia cardiovascular per canulació de catèters o derivacions, compost de: 1 llaç mandrí metàl·lic, 6 tubs (2 blau, 1 vermell i 3 transparents) 14cm long +/- 2cm. Estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031684	Cinta de cotó per a retracció de vasos, urèters i nervis. Amplada 4 mm, llargària 75 cm, recobriments siliconat, color blanc. Estèril.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031685	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per identificació, retracció u oclusió vasos sanguinis i nervis Color vermell (arteries). Mida MINI: Ample 1.3mm, alt 0.9mm llargària 45 cm. Lliure de làtex, Estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031686	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per identificació, retracció u oclusió vasos sanguinis i nervis Color blava (venes). Mida MINI: Ample 1.3, alt 0.9mm, llargària 45cm. Lliure de làtex, Estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031688	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per identificació, retracció u oclusió. Color blanc (nervis i tendons). Mida MINI : Ample 1.3, alt 0.9mm, llargària 45cm. Lliure de làtex, Estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031689	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color vermell (artèries). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0; llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031690	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color blau (venes). Mida GRAN : Ample 2,5; Alt 1,0; llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031691	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color blanc (nervis i tendons). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0; llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031692	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color groc (urèters). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0; Longitud 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031693	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color groc (ureters). Mida MINI: Ample 1,3; Alt 0,9; Longitud 45cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031694	Cinta cilíndrica suau i atraumàtica, elàstica i d'alta flexibilitat, de silicona per a subjectar artèries amb agulla corba de punta roma. Mida 18 G, 30+/-2cm long, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30032200	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color blau (venes). Mida EXTRA GRAN: Ample 5.0, Alt 1.3, llargària 45cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30043377	Torniquet de vasos en hemorràgia (severa) d'extremitats superiors i inferiors, tipus cremallera, corretja dentada de niló, resistència tracció mínima de 420kg/cm ² , 2 anelles de bloqueig, sivella trinquet. Mida des de g at 100cm +/- 40cm estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30031682	Equip torniquet per a per canulació catèters, cànules i shunts en cirurgia cardiovascular, compost: 1 obturador, 2 cintes de fixació de 3,2mmx61cm +/-1cm, 2 beines amb tap de retenció. Estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
7	Cintes identificadores i torniquets de vasos	30032201	Cinta de cotó amb la malla impregnada de silicona i les vores arrodonides, identificació i retracció d'estructures nervioses, color blanc, amplada 8 mm, llargària 75cm +/-5cm. Estèril, lliure de làtex i SVHC.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30004243	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø artèries < 1 mm pressió 40 gr mm ² , longitud total 14,5 mm ; 2,5mm amplada, separació entre clamps 7,5mm, pes 0,13gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30004791	Clamp senzill recte Fogarty de mandíbules paral·leles llargada 17mm±2mm, obertura màxima Ø6 mm, pressió suau uniforme, de plàstic amb ressort interior, per microcirurgia, radiopac. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30004817	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø artèries < 1mm pressió 40g mm ² , longitud total 14,5 mm; 2,5mm amplada, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30004818	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de plàstic i acer, mides: Ø artèries <1-2mm pressió 60g mm ² , longitud total 17 mm; 3mm amplada, separació entre clamps 12,5mm, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30004819	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø venes < 1 mm, longitud total 14,5 mm, pressió 20 gr, 2,5 mm amplada, separació entre clamps 7,5mm, pes 0,13gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
8	Clamps plàstic/policarbonat	30015564	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, Ø venes de 2 fins a 4 mm, mides: longitud total 21,5 mm, pressió 40 gr, 3,5 mm amplada, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30015631	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø fins 1 mm, longitud total 14,5 mm, pressió 20 gr, 2,5 mm amplada, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30034235	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: arteries Ø 1-2mm, pressió 60gmm2, longitud total 17 mm; 3 m m amplada, pes 0,12gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30034236	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø 1-2mm pressió 30gmm2, longitud total 17 mm, 3 mm am plada, pes 0,12gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30034237	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø 1-2mm pressió 30g mm2, longitud total 17 mm, 3 mm amplada, separació entre clamps 12,5mm, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30040048	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per arteries Ø de 2 fins a 4 mm, mides: longitud total 21,5 mm, pr essió 120 gr, 3,5 mm amplada pes 0,03gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30040050	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per venes Ø de 0,2-1 mm, mides: longitud total 11 mm, pressió 15 gr, 2,3 mm amplada, pes 0,03gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
8	Clamps plàstic/policarbonat	30040051	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per venes Ø de 0,2-1 mm, mides: longitud total 11 mm, pressió 15 gr, 2,3 mm amplada, separació entre clamps 8mm, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30051021	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina mides vasos: de Ø0,4 a 1.0mm, pressió de 13,5 a 20g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30051022	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de resina amb dents, mides vasos: de Ø0,4 a 1.0mm, pressió de 13,5 a 20g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
9	Clamps resina sintètica	30051023	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de resina amb dents ,mides vasos: de Ø0,6 a 1.5mm, pressió de 20 a 32,5 gmm2, longitud to tal 15,3 mm; 3 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062151	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 0,4 a 1.0mm, pressió de 8 a 15g mm2, longitud total 12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30051020	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de resina sintètica i acer,mides vasos: de Ø1 a 2.25mm, pressió de 45 a 60g mm2, longitud total 17 mm; 3.5 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062152	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 0,6 a 1.5mm, pressió de 15 a 25g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062153	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 30 a 50g mm2, longitud total 12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062154	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 50 a 75g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062155	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 0.6 a 1.5mm, pressió de 20 a 35.5g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062156	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 45 a 60g mm2, longitud total 12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062157	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 70 a 85g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062158	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 70 a 85g mm2, longitud total 12,6 mm; 2 .6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
9	Clamps resina sintètica	30062166	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia per vena, amb dents ,resina, mides vasos: de Ø 0,4 a 1.0mm, pressió de 8 a 15g mm2, longitud total 12,6mm; 2.6 mm amplada cada un, amplada total 16mm, amb color ,radioopacs, estèrils,	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062167	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, per vena, amb dents ,resina mides vasos: de Ø 0,6 a 1.5mm, pressió de 15 a 25g mm2, longitud tot al 15.3 mm; 2.6 mm amplada cada un, 20mm amplada total, amb color ,radioopacs, estèrils, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062168	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, per vena, amb dents ,resina, mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 30 a 50g mm2, longitud total 17,3mm; 3.5 mm amplada, ample total de 21mm, amb color, radioopacs, estèrils, un sol ús.	Lot Obligatori
9	Clamps resina sintètica	30062169	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, per vena, amb dents ,resina, mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 50 a 75g mm2, longitud total 20 mm; amplada indiv 3.5, 21 mm amplada total dels 2, amb color ,radioopacs estèrils, un sol ús.	Lot Obligatori
10	Clamps Bulldog	30031536	Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, recte, mida mitjana, pressió 75-80gr, color groc, radioopac, estèril, d'un sol ús.	Lot Obligatori
10	Clamps Bulldog	30031537	Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, angle 45º, mida mitjana, pressió 75-80gr, color groc, radioopac, estèril, d'un sol ús.	Lot Obligatori
10	Clamps Bulldog	30031538	Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, angle 45º, mida gran, pressió 165-175gr, color taronja, radioopac, estèril, d'un sol ús.	Lot Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30031703	Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm; Ø 5,7mm. Color blau. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30031704	Tubs protectors o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics petits, radioopacs, mida Ø2,6mm x11mm long .(12 protectors per blister), Color groc. Estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30031706	Protector/coixinet per clamp vascular amb malla i punts d'ancoratge, mida 45mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats. Per a adaptar als clamps Applied o equivalent.	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30032202	Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm; Ø 2,54mm. Color vermell. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30032203	Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 4,0 mm.Color blanc. Estèril,un sol ús, presentació 2 unitats	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30039717	Protector per clamp de pinces vasculares amb tres punts d'ancoratge, mida 30mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30051969	Tub protector silicona per a instruments quirúrgics,clamps,amb vores dentades longitudinalment a la cara interna,Ø5mm(0,20)+/-0,08mm ,llargària 13 cm+/-1cm,color blanc,estèril,un sol ús,envàs mínim 2 unitats	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30054109	Protector/coixinet per clamp vascular amb malla i punts d'ancoratge, mida 90mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent.	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30060697	Protector/coixinet per a clamp vascular,model piramidal, mida 86mm,de goma, lliure de làtex, estèril, un sol ús,2 unitats	Lot No Obligatori
11	Tubs protectors instrumental i clamps	30060698	Protector/coixinet per a clamp vascular,model piramidal, mida 86mm,de cautxú sintètic i silicona líquid,radiopac , lliure de làtex, estèril, uns ol ús,2 unitats.	Lot No Obligatori
12	Accesoris per a cirurgia	30032523	Caixa de plàstic amb escuma i imant per a la recollida de puntes punxants en la cirurgia,estèril,sol ús	Lot No Obligatori
12	Accesoris per a cirurgia	30032524	Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí, estèril. Lliure de làtex,un sol ús.	Lot No Obligatori
12	Accesoris per a cirurgia	30032528	Organitzador de sutures per cirurgia cardíaca,compost de tres tires adhesives,ranurades i numerades.22,5x3cm..Lliure de làtex,estèril,un sol ús	Lot No Obligatori
12	Accesoris per a cirurgia	30032786	Safata rodona de polipropilè amb topall interior,per a la manipulació de guies vasculares,graduada,capacitat 2500ml. Estèril un sol ús Lliure de làtex	Lot No Obligatori
12	Accesoris per a cirurgia	30043611	Dispositiu d'il·luminació LED adaptable i versàtil a qualsevol instrumental quirúrgic,consta de: lent i anell de silicona amb cable PVC 3,2 m,Ø int 8mm,de grau mèdic (300 minuts de llum), estèril, sol ús.Compatible o equivalent tecnologia LED FA	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051545	HVH-Equip Histerectomia amb/sense anexeotomia laparoscòpica amb segellador,compost per 7 elements. 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress,Ø2,1m mx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 2-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort,màneg trocar amb segellament auto ajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 1- Cànula Ø5mmx100 mm per tròcar abd òptic punta dilat sense full tallant Ø5mmx100,radiotransparent,bisell i amb estries fix,doble vàlvula integrada,màneg obturador,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzembraum,per a endoscòpia laparoscòpica,puntes corbesde 15-18mm llarg,Ø5mmx33-37cm de llargària,eix rotatori de 360º,màneg ergonòmic,totalment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22º per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm longitud ,topalls ceràmics,longitud segellament 20mm i 18mm de tall ,tall independent.Activació manual i pedal,màneg ergonòmic per a cirurgia tancada. 1-Placa de retorn REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.	Lot Obligatori
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051546	HVH Equip Anexeotomia complexa per laparoscopia amb segellador,compost per 7 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress,Ø2,1mmx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort,màneg trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2- Cànula Ø5mmx100mm per tròcar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100,radiotransparent,bisell i amb estries fix,doble vàlvula integrada,màneg obturador ,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzembraum,per a endoscòpia laparoscòpica,puntes corbes de 15-18mm llarg,Ø5mmx33-37cm de llargària,eix rotatori de 360º,màneg ergonòmic,to talment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Pinça dissecció roma per a sege llament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm de longitud,obertura 14,5mm,longitud segellament 19,5mm i 17,8mm de tall,obertura bilateral mandíbules ,activació manual i pedal amb fixació automàtica,tall independent del se gellat,per a cirurgia tancada. Rotació 180º.Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència 1- Placa de retorn tipus REM adult s/cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.	Lot Obligatori
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051547	HVH Equip Anexeotomia simple per laparoscopia sense segellador,compost p er 7 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress,Ø2,1mmx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx 100mm long ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort,màneg trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2- Cànula Ø5mmx100mm per tròcar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100,radiotr,bisel l i amb estries fix,doble vàlvula integrada,màneg obturador,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzembraum,per a endoscòpia laparoscòpica,puntes corbes de 15-18mm llarg,Ø5mmx3 3-37cm de llargària,eix rotatori de 360º,màneg ergonòmic,totalment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Bossa de recollida material per a endocirurgia laparoscòpica,per a trocars Ø10/11mm ,obertura ajustable,dispositiu introductor tipus caça-papallones ,capacitat de 225cc a 250cc. 1-Placa de tipus REM adult s/cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor. Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051548	<p>HVH-Equ Histerectomia amb linfadenectomia pèlvica bilateral laparoscòpica amb segellador compost per 8 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud ,ra diotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana lineal aguda protector de ressort ,màneg trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2- Cànula Ø5mmx100mm per trocar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, màneg obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzemaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360º, màneg ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça dissecció roma per a segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm de longitud , nano recobriment, obertura 14,5mm, longitud segellament 19,5mm i 17, 8mm de tall, obertura bilateral mandíbules, activació manual i pedal amb fixació automàtica, tall independent del segellat, per a cirurgia tancada. Rotació 180º. Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència. 1 -Electrobisturí bipolar punta plana roma, màneg control manual (tall-coagulació) placa interna seguretat, fix hexagonal seguretat estanca, acer, Ø2,4 mm connexió, cable siliconat s/memòria, mínim 3m. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.</p>	Lot Obligatori
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051550	<p>HVH-Equip linfadenectomia pèlvica bilateral i para-aòrtica i/o omentectomia laparoscòpica amb segellador compost per 13 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mm x100mm longitud , radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana lineal aguda protector de ressort, màneg trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2- Cànula Ø5mmx100mm per trocar abdòptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, màneg obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzemaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360º, màneg ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22º per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm longitud , topalls ceràmics, longitud segellament 20mm i 18mm de tall, tall independent. Activació manual i pedal. 4-Bossa de recollida de material per a endocirurgia laparoscòpica, per a trocars diàmetre 10/11/12 mm, sense sistema de tancament, precarregada dintre cànula introductora de diàmetre 10mm, capacitat 150cc a 200cc. 1-Electrobisturí bipolar punta plana roma, màneg control manual (tall-coagulació) placa interna seguretat, fix hexagonal seguretat estanca, acer, Ø2,4mm connexió, cable siliconat sense memòria, mínim 3m. 1- Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm, adhesiu conductor, lliure de làtex, estèril, un sol ús.</p>	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051551	HVH-Equ linfadenectomia para-aòrtica extraperitoneal laparoscòpica amb segellador compost per 11 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Vere ss,Ø2,1mmx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm long ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obturador amb punta de fulla plana lineal aguda protector de ressort,màneg trocar amb segellament auto ajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2- Cànula Ø5mm x100mm per tròcar abdòptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100 ,radiotransparent,bisell i amb estries fix,doble vàlvula integrada,màneg obturador,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació desinflatió. 1 -Tisora tipus Metzemaum,per a endoscòpia laparoscòpica,puntes corbes de 15-18mm llarg,Ø5mmx33-37cm de llargària,eix rotatori de 360º,màneg ergonòmic,totalment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 2 2º per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm long ,topalls ceràmics,long segellament 20mm i 18mm de tall,tall independent.Activació manual i pedal. 2-Bosses de recollida de material per a endocirurgia laparoscòpica,per a trocars Ø10/11/12mm,sense sistema de tancament,precarregada dintre cànula introductora de Ø 10mm ,capacitat 150cc a 200cc. 1 Electro bisturi bipolar punta plana roma,màneg control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4mm connexió,cable siliconat sense memòria,minim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturi. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.	Lot Obligatori
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051553	HVH-Equip laparotomia per cirurgia d'ovari amb segellador compost 7 elements: 1-Pinça roma de 23cm longitud,Ø5mm eix,19,5mm longitud segellat,17 ,8mm longitud tall,per a segellament vasos i teixits fins Ø<=7mm per rotació 180º,segellat independent del tall,antiadherent.Obertura bilateral ,topalls ceràmics,activació manual/pedal,màneg ergonòmic.Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència. 2-Hemostàtic absorbible (28 dies) pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó,trisilina i polietilenglicol.Mida 5x10cm. 1-Grapadora de sutura cutània,sutura lineal, recta,precarregada amb 35grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable mida aproximada grapa tancada ,5mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica. 1- Electro bisturi bipolar punta plana roma,màneg control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4m m connexió,cable siliconat sense memòria,minim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturi. 1-Placa de retorn tipus REM adults/ cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM,placa 182mmx115 mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.	Lot Obligatori
13	Equips per a cirurgia ginecològica	30051554	HVH-Equip cirurgia vulvar amb segellador compost 7 elements: 1- Dissector /segellador amb nano-recobriments antiadherent per segellar i tallar vasos i teixits fins Ø7mm,Longitud 21cm,mandíbula de 21,6mm angulada 40° ,ful la de tall a la zona mitja de les mandíbules.Ergonòmic ,sense rotació.Activació manual i amb pedal. 1-Hemostàtic absorbible(28 dies) pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó,trisilina i polietilenglicol. Mida 5x10cm. 1-Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada amb 35grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable,mida aprox grapa tancada,5mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica. 1-Electrobisturi bipolar punta plana roma,màneg control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4mm connexió,cable siliconat sense memòria,minim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturi. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM,placa 182mmx115mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.	Lot Obligatori
14	Equips per a cirurgia i ablació hemorroidal	30058572	Equip per a cirurgia hemorroidal THD compost per: 1anuscopi THD,6sutures absorbible a/agulla corba,1portaagulles metàl.líc,1sonda Doppler estèril i esponja hemostàtica absorbent.Compatible amb sistema THD Evolution o Revolutions o	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
14	Equips per a cirurgia i ablació hemorroidal	30061600	Equip per ablació d'hemorroides per radiofreqüència, d'un sol ús. Compost per: Catèter HPR45i i anoscopi amb llum led orientada. Mida cat: 1,9mmØx200mm llargària amb revestiment PTFE. Punta aguda de 50mm. Compat amb generador de RF	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30001442	Proctoscopi de plàstic transparent de mides aproximades 20mm de diàmetre i 80mm +/- 2mm de llargària, amb pas per a font de llum. Estèril d'un sol ús	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30001816	Anoscopi de plàstic transparent, mides aproximades diàmetre 20mm, llargària 85mm +/- 2mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb aparell HEINE o equivalent.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30001817	Rectoscopi de plàstic, diàmetre 20mm, llargària 250mm +/- 10mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb aparell HEINE o equivalent	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30002018	Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/màneg per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum 23 mm, llargària 55/88mm, punta bisellada, d'un sol ús. Lliure de làtex	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30004586	Lligador d'hemorroides per succió amb disparador mecànic, transparent, llargària 13cm +/- 2cm i diàmetre interior 10mm +/- 1mm, connector de succió universal, no estèril, d'un sol ús. Amb 3 anelles. Lligador lliure de latex, anelles de làtex.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30004815	Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/màneg per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum 18 mm, llargària 43/56mm, punta bisellada, d'un sol ús. Lliure de làtex	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30004816	Valva anal de plàstic transparent, amb màneg per introduir llapis o font de llum. Diàmetre: 22,4mm, longitud 98mm +/- 2mm. D'un sol ús. Lliure de làtex	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30007825	Anoscopi autoil·luminat operatiu, amb màneg per introduir llapis o font de llum, de plàstic, mides aproximades diàmetre interior 23 mm, llargària tub 65 mm, punta recte, d'un sol ús	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30008648	Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/màneg per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum int 18,5 mm, llargària operativa 65mm +/- 2mm, punta recta, d'un sol ús. Lliure de làtex	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30012877	Proctoscopi de plàstic transparent amb màneg per introduir llapis o font de llum. Mides: 20mm de diàmetre extern, 17mm de diàmetre intern i 130mm +/- 10mm de llargària, un sol ús	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30016497	Rectoscopi polivalent biòpsia i eco transrectal, a/màneg per introduir font de llum. Plàstic transparent, Ø intern 18mm, Ø extern 21mm, llarg gradu tub 220mm +/- 10mm, llarg total 235mm +/- 10mm, lliure de làtex. Estèril, un sol ús. Compat a/ transduct	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
15	Material cirurgia proctologica	30023293	Anoscopi autoil-luminat operatiu, amb mànec per introduir llapis o font de llum, fenestrat amb punta tancada i arrodonida, de plàstic transparent, mida diàmetre intern 32 mm, llargària 90mm +/-5mm. d'un sol ús. Lliure de làtex.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30027876	Equip rectoscopi format per tub milimetrat i mànec de mides: longitud útil 220mm +/-10mm i longitud total 235mm +/-10mm, diàmetre extern 21mm, obturador i finestra d'exploració. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductors B&K	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30035295	Equip anuscop de policarbonat, format per enfilador de sutures, predilatador anal amb revestiment intern, dilatador anal amb finestres de fixació i dilatador mil·limetrat de 34mm +/-1cm amb canal de treball. Lliure de làtex. Estèril. Un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30036041	Proctoscopi pediàtric diagnòstic, de plàstic, amb suport làmpara, diàmetre llum 15mm, llargària tub 63mm +/-2cm, punta rodona d'un sol ús	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30040756	Rectoscopi de plàstic transparent diàmetre 23mm, llargària 200mm +/-10mm, compost de: lupa (lent X4), llum integrada (LED) en el dispositiu, amb insuflador d'aire manual. Lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30040757	Pistola de succió amb dispositiu per lligadures de quatre bandes, un con introductor i un lliscant de càrrega. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30040758	Proctoscopi operatiu autoil-luminat, fenestrat, de plàstic transparent, a traumàtic, mides aproximades 24mm de diàmetre i 122mm +/- 10mm de llargària i finestra de 85x26 mm, amb llum integrada (LED) en el dispositiu. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30051962	Raspall de fístula per a cirurgia oberta en proctologia, per desbridar tracte fistulós, abans de posar el clip de proctologia, raspall Ø 4mm x 4cm llargària, Ø dels extrems de 2,2mm i 2,5mm, 30cm long total, d'acer, estèril, un sol ús. Compatible OTSC o equival.	Lot No Obligatori
15	Material cirurgia proctologica	30053230	Proctoscopi per anoscopies d'alta resolució amb sistema de connexió amb videocàmera amb funda protectora i llum integrada. Diàmetre extern 25mm, longitud operativa 66mm. Un sol ús	Lot No Obligatori
16	Llapis de calor per implants reabsorbibles	30014303	Llapis de calor/cauteri per a moldejar i tallar implants reabsorbibles. Compost per: 1 terminal de modelatge de malles reabsorbibles un cop col·locades i 1 terminal de tall per plaques i cargols. Bateria de liti estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
17	Bolígraf per marcar camp operatori	30032526	Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori, de punta estàndard/mitja, estèril.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386507/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Bolígraf per marcar camp operatori	30032525	Bolígraf cutani no tòxic,tinta violeta de genciana no irritant,punta fina,per a marcar camp operatori,amb regle,estèril.	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001442

Descripció tècnica:

Proctoscopi de plàstic transparent de mides aproximades 20mm de diàmetre i 80mm +/-2mm de llargària, amb pas per a font de llum. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001816

Descripció tècnica:

Anoscopi de plàstic transparent, mides aproximades diàmetre 20mm, llargària 85mm +/-2mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb aparell HEINE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001817

Descripció tècnica:

Rectoscopi de plàstic, diàmetre 20mm, llargària 250mm +/-10mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb aparell HEINE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002018

Descripció tècnica:

Anoscopi autoil·luminat operatiu, a mànec per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum 23 mm, llargària 55/88mm, punta bisellada, d'un sol ús. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002705

Descripció tècnica:

Pinça/clamp hemostàtica de 12 cm ± 1cm, tipus klemmer, material plàstic, lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30004022

Descripció tècnica:

Extractor de varius/fleboextractor de poliamida (PA) compost de tres olives: (Ø 9,5mm, 12,8mm i 15,4mm aprox), un mànec amb dos cables de 1,54/1,66 mm x 100 cm, estèril.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30004243

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø arteries < 1 mm pressió 40 gr mm2, longitud total 14,5 mm ; 2,5mm amplada, separació entre clamps 7,5mm, pes 0,13gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30004258

Descripció tècnica:

Pinça de dissecció per a cures, recta fina sense dents, mida 12+/-1 cm a prox, material de plàstic, lliure de làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30004586

Descripció tècnica:

Lligador d'hemorroides per succió amb disparador mecànic, transparent, llargària 13cm +/-2cm i diàmetre interior 10mm +/-1mm, connector de succió universal, no estèril, d'un sol ús. Amb 3 anelles. Lligador lliure de latex, anelles de làtex.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30004791

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte Fogarty de mandíbules paral·leles llargada 17mm±2mm, obertura màxima Ø6 mm, pressió suau uniforme, de plàstic amb ressort interior, per microcirurgia, radiopac. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30004815

Descripció tècnica:

Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/mànc per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum 18 mm, llargària 43/56mm, punt a bisellada, d'un sol ús. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30004816

Descripció tècnica:

Valva anal de plàstic transparent, amb mànc per introduir llapis o font de llum. Diàmetre: 22,4mm, longitud 98mm +/-2mm. D'un sol ús. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30004817

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø arteries < 1mm pressió 40g mm², longitud total 14,5 mm; 2,5mm amplada, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30004818

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de plàstic i acer, mides: Øarteries <1-2mm pressió 60g mm², longitud total 17 mm; 3mm amplada, separació entre clamps 12,5mm, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30004819

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø venes < 1 mm, longitud total 14,5 mm, pressió 20 gr, 2,5 mm amplada, separació entre clamps 7,5mm, pes 0,13gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30007825

Descripció tècnica:

Anoscopi autoil·luminat operatiu, amb mànc per introduir llapis o font de llum, de plàstic, mides aproximades diàmetre interior 23 mm, llargària tub 65 mm, punta recte, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30008648

Descripció tècnica:

Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/mànc per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum int 18,5 mm, llargària operati va 65mm +/-2mm, punta recta, d'un sol ús. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30010703

Descripció tècnica:

Pinça clamp hemostàtica de 12cm ±1cm, tipus klemmer, material plàstic, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Presentació envàs 50 unitats.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30012877

Descripció tècnica:

Proctoscopi de plàstic transparent amb mànc per introduir llapis o font de llum. Mides: 20mm de diàmetre extern, 17mm de diàmetre intern i 130m +/-10mm de llargària, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30014303

Descripció tècnica:

Llapis de calor/cauteri per a moldejar i tallar implants reabsorbibles .Compost per: 1 terminal de modelatge de malles reabsorbibles un cop col·locades i 1 terminal de tall per plaques i cargols. Bateria de liti ,estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30015564

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, Ø venes de 2 fins a 4 mm, mides: longitud total 21,5 mm, pressió 40 gr, 3,5 mm amplada, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30015631

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø fins 1 mm, longitud total 14,5 mm, pressió 20 gr, 2,5 mm amplada, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30016497

Descripció tècnica:

Rectoscopi polivalent biòpsia i eco transrectal, a/mànc per introduir font de llum. Plàstic transparent, Ø intern 18mm, Ø extern 21mm, llarg gradu tu 220mm +/-10mm, llarg total 235mm +/-10mm, lliure de làtex. Estèril, un sol ús. Compat a/ transduct B&K.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30018301

Descripció tècnica:

Pinça hemostasia d'acer inox, punta corba, sense dents, tipus Halsted. Mida 12,5 +/-1cm estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30019657

Descripció tècnica:

Ganxo per a separ/retractor en interv quirúrg , acer inox/silicona elàstica amb topalls a/punta semi roma 5 mm,(8unit), estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30020790

Descripció tècnica:

Separador elàstic quirúrgic 360° G 9-14cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30020791

Descripció tècnica:

Separador/retractor elàstic quirúrgic 360° M 5-9cm a/anell rígid auto-re tracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP,estèril 1 ,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30023293

Descripció tècnica:

Anoscopi autoil·luminat operatiu, amb mànec per introduir llapis o font de llum, fenestrat amb punta tancada i arrodonida, de plàstic transparent, mida diàmetre intern 32 mm, llargària 90mm +/-5mm. d'un sol ús. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30027876

Descripció tècnica:

Equip rectoscopi format per tub milimetrat i mànec de mides: longitud út il 220mm +/-10mm i longitud total 235mm +/-10mm,diàmetre extern 21mm ,obturador i finestra d'exploració. Estèril,d'un sol ús. Compatible amb transductors B&K 2050/2052/1850

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30028243

Descripció tècnica:

Separador /retractor elàstic quirúrgic 360° XL 11-17cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP ,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30030091

Descripció tècnica:

Separador /retractor elàstic quirúrgic 360° XXL 17-25cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP ,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30031536

Descripció tècnica:

Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, recte, mida mitjana, pre ssió 75-80gr, color groc, radioopac, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30031537

Descripció tècnica:

Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, angle 45°, mida mitjana, pressió 75-80gr, color groc, radiopac, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30031538

Descripció tècnica:

Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, angle 45°, mida gran, pressió 165-175gr, color taronja, radiopac, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30031539

Descripció tècnica:

Separador o retractor per intervencions quirúrgiques, material de resina, quadrat, mides: 14,1x14,1cm amb 4 frontisses lateral 20 obert perifèr. Un sol ús, estèril, lliure làtex. Compatible ganxos 30040195/30040196/30019657.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30031540

Descripció tècnica:

Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta roma de 12mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica sense topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539. (8unit)

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30031547

Descripció tècnica:

Pinça de dissecció de 13cm de plàstic, lliure de làtex, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30031682

Descripció tècnica:

Equip torniquet per a per canulació catèters, cànules i shunts en cirurgia cardiovascular, compost: 1 obturador, 2 cintes de fixació de 3,2mmx61cm +/-1cm, 2 beines amb tap de retenció. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30031683

Descripció tècnica:

Equip torniquet per a cirurgia cardiovascular per canulació de catèters o derivacions, compost de: 1 llaç mandrí metàl·lic, 6 tubs (2 blau, 1 vermell i 3 transparents) 14cm long +/-2cm. Estèril, un sol ús..

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30031684

Descripció tècnica:

Cinta de cotó per a retracció de vasos, urèters i nervis. Amplada 4 mm, llargària 75 cm, recobriment siliconat, color blanc. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30031685

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per identificació, retracció u oclusió vasos sanguinis i nervis Color vermell (arteries). Mida MINI: Ample 1.3mm, alt 0.9mm llargària 45 cm. lliure de làtex, Estèril, un sol ús .

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30031686

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per identificació, retracció u oclusió vasos sanguinis i nervis Color blava (venes). Mida MINI: Ample 1.3, alt 0.9mm, llargària 45cm. lliure de làtex, Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30031688

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per identificació, retracció u oclusió. Color blanc (nervis i tendons). Mida MINI : Ample 1.3, alt 0.9mm, llargària 45cm. lliure de làtex, Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30031689

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color vermell (artèries). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0; llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30031690

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color blau (venes). Mida GRAN : Ample 2,5; Alt 1,0; llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30031691

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color blanc (nervis i tendons). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0 ; llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30031692

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color groc (urèters). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0; Longitud 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30031693

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color groc (ureters). Mida MINI: Ample 1,3; Alt 0,9; Longitud 45cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30031694

Descripció tècnica:

Cinta cilíndrica suau i atraumàtica, elàstica i d'alta flexibilitat, de silicona per a subjectar artèries amb agulla corba de punta roma.Mida 18 G, 30+/-2cm long ,estèril,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30031703

Descripció tècnica:

Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 5,7mm.Color blau. Estèril,un sol ús ,presentació 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30031704

Descripció tècnica:

Tubs protectors o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics petits, radioopacs, mida Ø2,6mm x11mm long .(12 protectors per blister),Color groc. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30031706

Descripció tècnica:

Protector/coixinet#per clamp vascular amb malla i punts d'ancoratge, mida 45mm, lliure de làtex, estèril,2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30032200

Descripció tècnica:

Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color blau (venes).Mida EXTRA GRAN: Ample 5.0, Alt 1.3, llargària 45cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30032201

Descripció tècnica:

Cinta de cotó amb la malla impregnada de silicona i les vores arrodonides, identificació i retracció d'estructures nervioses,color blanc,amplada 8 m ,llargària 75cm+/-5cm. Estèril,lliure de làtex i SVHC.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30032202

Descripció tècnica:

Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 2,54mm.Color vermell. Estèril,un sol ús, presentació 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30032203

Descripció tècnica:

Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 4,0 mm.Color blanc. Estèril,un sol ús ,presentació 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30032523

Descripció tècnica:

Caixa de plàstic amb escuma i imant per a la recollida de puntes punxants en la cirurgia,estèril,sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30032524

Descripció tècnica:

Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí, estèril. Lliure de làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30032525

Descripció tècnica:

Bolígraf cutani no tòxic,tinta violeta de genciana no irritant,punta fina ,per a marcar camp operatori,amb regle,estèril.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30032526

Descripció tècnica:

Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori, de punta estàndard/mitja, estèril.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30032528

Descripció tècnica:

Organitzador de sutures per cirurgia cardíaca,compost de tres tires adhesives,ranurades i numerades.22,5x3cm..Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30032530

Descripció tècnica:

Separador/retract elàstic quirúrgic 360°,mida XL Ø 11-17 cm, auto-retractió per a laparotom i cesàries camp operatiu 227cm².Compost: cèrcol sup rígid, un de distensió, subjecció automàtic, membrana central transp/imper meab PUR.Lliure làtex/DHP,estèril

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30032531

Descripció tècnica:

Separ/retract elàstic quirúrgic 360° ,mida L ,9-14cm auto-retractió per a laparotom i cesàries Ø camp operatori 176 cm².Compost:cèrcol sup rígid ,un de distensió, subjecció automàtic,membra central transp/impermeab PUR.Lliure làtex,DHP,apirò,estèril

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30032786

Descripció tècnica:

Safata rodona de polipropilè amb topall interior,per a la manipulació de guies vasculars,graduada,capacitat 2500ml. Estèril,un sol ús,lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30034235

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: arteries Ø 1-2mm,pressió 60gmm2, longitud total 17 mm; 3 m m amplada,pes 0,12gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30034236

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venesØ 1-2mm pressió 30gmm2, longitud total 17 mm, 3 mm amplada,pes 0,12gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30034237

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venesØ 1-2mm pressió 30g mm2, longitud total 17 mm, 3 mm amplada,separació entre clamps 12,5mm,pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30034982

Descripció tècnica:

Espàtula cerebral atraumàtica,metà·lica amb revestiment de silicona ,plana,recte. Mida: diàmetre 7,5mm, llargària 200mm+/-5cm. Estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30034983

Descripció tècnica:

Espàtula cerebral atraumàtica,metà·lica amb revestiment de silicona ,plana,recte. Mida: diàmetre 10mm, llargària 200mm+/-5cm. Estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30034984

Descripció tècnica:

Espàtula cerebral atraumàtica,metà·lica amb revestiment de silicona ,plana,recte. Mida: diàmetre 12,5mm, llargària 200mm+/-5cm. Estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30035295

Descripció tècnica:

Equip anuscop de policarbonat,format per enfilador de sutures,predilatador anal amb revestiment intern,dilatador anal amb finestres de fixació i dilatador mil·límetrat de 34mm+/-1cm amb canal de treball. Lliure de làtex. Estèril.Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30036041

Descripció tècnica:

Proctoscopi pediàtric diagnòstic,de plàstic,amb suport làmpara,diàmetre llum 15mm, llargària tub 63mm+/-2cm, punta rodona,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30039717

Descripció tècnica:

Protector#per clamp de pinces vasculars amb tres punts d'ancoratge, mida 30mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30040048

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per arteries Ø de 2 fins a 4 mm, mides: longitud total 21,5 mm, pressió 120 gr, 3,5 mm amplada pes 0,03gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30040050

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per venes Ø de 0,2-1 mm, mides: longitud total 11 mm, pressió 15 gr, 2,3 mm amplada, pes 0,03gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30040051

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per venes Ø de 0,2-1 mm, mides: longitud total 11 mm, pressió 15 gr, 2,3 mm amplada, separació entre clamps 8mm, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30040196

Descripció tècnica:

Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta aguda de 5mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30040197

Descripció tècnica:

Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta aguda de 3mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539. (8unit)

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30040756

Descripció tècnica:

Rectoscopi de plàstic transparent diàmetre 23mm, llargària 200mm+/-10mm, compost de: lupa (lent X4), llum integrada (LED) en el dispositiu, amb insuflador d'aire manual. Lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30040757

Descripció tècnica:

Pistola de succió amb dispositiu per lligadures de quatre bandes, un con introductor i un lliscant de càrrega. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30040758

Descripció tècnica:

Proctoscopi operatiu autoil·luminat, fenestrat, de plàstic transparent, a traumàtic, mides aproximades 24mm de diàmetre i 122mm +/- 10mm de llargària i finestra de 85x26 mm, amb llum integrada(LED) en el dispositiu. Lliure de làtex,estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30041994

Descripció tècnica:

Separador o retractor per intervencions quirúrgiques,material de resina, forma doble circular asimètrica ,mides: 35,5x28,8x15,8x19cm amb 2frontisses laterals.Sol ús, estèril,lliure làtex.Compatible ganxos 30040196/3 00 40197/30019657/3001540.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30042562

Descripció tècnica:

Separador o retractor, tipus Roux o equivalent, longitud 170mm+/-5cm, mides distals: 1 retractor de 36mmx20mm i 1 retractor de 20mmx15mm+/-2mm, plàstic biocompatible,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30042563

Descripció tècnica:

Pinça de dissecció recta de 20cm ± 1cm, amb plataforma serrada, tipus Cush ing, de plàstic biocompatible.Lliure de làtex,estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30042564

Descripció tècnica:

Pinça tipus Pean,punta recta,20cm ±1cm, amb plataforma serrada, de plàstic biocompatible. Lliure de làtex,estèril,un sol ús,envàs individual .

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30043377

Descripció tècnica:

Torniquet de vasos en hemorràgia (severa) d'extremitats superiors i inferiors, tipus cremallera, corretja dentada de niló, resistència tracció mínima de 420kg/cm², 2 anelles de bloqueig, sivella trinquet. Mida desple g at 100cm +/-10cm,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30043611

Descripció tècnica:

Dispositiu d'il·luminació LED adaptable i versàtil a qualsevol instrumental quirúrgic, consta de: lent i anell de silicona amb cable PVC 3 ,2 m, Ø int 8mm, de grau mèdic (300 minuts de llum), estèril, sol ús.Compatible o equivalent tecnologia LED FA-RL01.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30051020

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de resina sintètica i acer, mides vasos: de Ø1 a 2.25mm, pressió de 45 a 60g mm², longitud total 17 mm; 3.5 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30051021

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina mides vasos: de Ø0,4 a 1.0mm, pressió de 13,5 a 20g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30051022

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de resina amb dents, mides vasos: de Ø0,4 a 1.0mm, pressió de 13,5 a 20g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30051023

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de resina amb dents, mides vasos: de Ø0,6 a 1.5mm, pressió de 20 a 32,5 gmm2, longitud total 15,3 mm; 3 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30051545

Descripció tècnica:

HVH-Equip Histerectomia amb/sense anexectomia laparoscòpica amb segellador, compost per 7 elements.
1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1m mx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable.
2-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament auto ajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 1-Cànula Ø5mmx100 mm per tròcar abd òptic punta dilat sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzemaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360°, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22° per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm longitud, topalls ceràmics, longitud segellament 20mm i 18mm de tall, tall independent. Activació manual i pedal, mànec ergonòmic per a cirurgia tancada.
1-Placa de retorn REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30051546

Descripció tècnica:

HVH Equip Anexectomia complexa per laparoscopia amb segellador, compost per 7 elements:
1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament auto ajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 2-Cànula Ø5mmx100mm per tròcar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzemaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360°, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar.
1-Pinça dissecció roma per a sege llament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm de longitud, obertura 14,5mm, longitud segellament 19,5mm i 17,8mm de tall, obertura bilateral mandíbules, activació manual i pedal amb fixació automàtica, tall independent del segellat, per a cirurgia tancada. Rotació 180°. Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència 1-Placa de retorn tipus REM adult s/cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30051547

Descripció tècnica:

HVH Equip Anexectomia simple per laparoscopia sense segellador, compost per 7 elements:
1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm long, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 2-Cànula Ø5mmx100mm per trocar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotr, bisel l i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzemb aum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx3 3-37cm de llargària, eix rotatori de 360°, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Bossa de recollida material per a endocirurgia laparoscòpica, per a trocars Ø10/11mm, obertura ajustable, dispositiu introductor tipus caça-papallones, capacitat de 225cc a 250cc. 1-Placa de tipus REM adult s/cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30051548

Descripció tècnica:

HVH-Equ Histerectomia amb linfadenectomia pèlvica bilateral laparoscòpica amb segellador compost per 8 elements:
1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 2-Cànula Ø5mmx100mm per trocar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzemb, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360°, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça dissecció roma per a segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm de longitud, nano recobriment, obertura 14,5mm, longitud segellament 19,5mm i 17, 8mm de tall, obertura bilateral mandíbules, activació manual i pedal amb fixació automàtica, tall independent del segellat, per a cirurgia tancada. Rotació 180°. Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència. 1 -Electrobisturí bipolar punta plana roma, mànec control manual (tall-coagulació) placa interna seguretat, fix hexagonal seguretat estanca, acer, Ø2,4 mm connexió, cable siliconat s/memòria, mínim 3m. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30051550

Descripció tècnica:

HVH-Equip linfadenectomia pèlvica bilateral i para-aòrtica i/o omentectomia laparoscòpica amb segellador compost per 13 elements:
1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 2-Cànula Ø5mmx100mm per trocar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzemb, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360°, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22° per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm longitud, topalls ceràmics, longitud segellament 20mm i 18mm de tall 1, tall independent. Activació manual i pedal. 4-Bossa de recollida de material per a endocirurgia laparoscòpica, per a trocars diàmetre 10/11/12 mm, sense sistema de tancament, precarregada dintre cànula introductora de diàmetre 10mm, capacitat 150cc a 200cc.

1-Electrobisturí bipolar punta p lana roma,mà nec control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat, fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4mm connex,cable siliconat sense memòria,mínim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor,lliure de làtex ,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30051551

Descripció tècnica:

HVH-Equ linfadenectomia para-aòrtica extraperitoneal laparoscòpica amb segellador compost per 11 elements:

1-Agulla de pneumoperitoneu o de Vere ss,Ø2,1mmx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm long ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obtu rador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort,mà nec trocar amb segellament auto ajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2-Cànula Ø5mm x100mm per trócar abdòptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100 ,radiotransparent ,bisell i amb estries fix,doble vàlvula integrada,mà nec obturador,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació desinflatió.

1 -Tisora tipus Metzembaum,per a endoscòpia laparoscòpica,puntes corbes de 15-18mm llarg,Ø5mmx33-37cm de llargària,eix rotatori de 360°,mà nec ergonòmic,totalment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 2 2° per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm long,topalls ceràmics,long segellament 20mm i 18mm de tall,tall independent.Activació manua l i pedal. 2-Bosses de recollida de material per a endocirurgia laparoscòpica,per a trocars Ø10/11/12mm,sense sistema de tancament,precarregada dintre cànula introductora de Ø 10mm,capacitat 150cc a 200cc. 1-Electro bisturí bipolar punta plana roma,mà nec control

manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4mm connexió,cable siliconat sense memòria,mínim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30051553

Descripció tècnica:

HVH-Equip laparotomia per cirurgia d'ovari amb segellador compost 7 elements:

1-Pinça roma de 23cm longitud,Ø5mm eix,19,5mm longitud segellat,17 ,8mm longitud tall,per a segellament vasos i teixits fins Ø</=7mm per rotació 180°,segellat independent del tall,antiadherent.Obertura bilateral ,topalls ceràmics,activació manual/pedal,mà nec ergonòmic.Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència. 2-Hemostàtic absorbible (28 dies) pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó,trisilina i polietilenglicol.Mida 5x10cm. 1-Grapadora de sutura cutània,sutura lineal, recta,precarregada amb 35grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable mida aproximada grapa tancada ,5mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica.

1- Electrobisturí bipolar punta plana roma,mà nec control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4m m connexió,cable siliconat sense memòria,mínim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn tipus REM adults/ cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM,placa 182mmx115 mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30051554

Descripció tècnica:

HVH-Equip cirurgia vulvar amb segellador compost 7 elements: 1-Dissector /segellador amb nano-recobriment antiadherent per segellar i tallar vasos i teixits fins Ø7mm,longitud 21cm,mandíbula de 21,6mm angulada 40°,ful la de tall a la zona mitja de les mandíbules.Ergonòmic ,sense rotació.Activació manual i amb pedal. 1-Hemostàtic absorbible(28 dies) pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó,trisilina i polietilenglicol. Mida 5x10cm. 1-Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada amb 35grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable,mida aprox grapa tancada,5mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica. 1-Electrobisturí bipolar punta plana roma,mà nec control manual(tall-coagulació) placa interna s eguretat ,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4mm connexió,cable siliconat sense memòria,mínim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM,placa 182mmx115mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex

,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30051962

Descripció tècnica:

Raspall de fistula per a cirurgia oberta en proctologia,per desbridar tracte fistulós, abans de posar el clip de proctologia ,raspal 1 Ø 4mmx4cm llargària,Ø dels extrems de 2,2mm i 2,5mm,30cm long total,d'acer,estèri 1,un sol ús.Compatible OTSC o equival.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30051969

Descripció tècnica:

Tub protector silicona per a instruments quirúrgics,clamps,amb vores dentades longitudinalment a la cara interna,Ø5mm(0,20)+/-0,08mm, llargària 13 cm+/-1cm,color blanc,estèril,un sol ús,envàs mínim 2 unitats

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30052786

Descripció tècnica:

Separador o retractor per intervencions quirúrgiques pediàtriques,material de resina,forma circular asimètrica,mides: 15x10x11,5cm+/-1cm amb 2 frontisses laterals.1ús,estèril,lliure làtex.Compatible ganxos 30040196/30040197/30019657/30031540

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30053230

Descripció tècnica:

Proctoscopi per anoscopies d'alta resolució amb sistema de connexió amb videocàmara amb funda protectora i llum integrada. Diàmetre extern 25mm,1 ongitud operativa 66mm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30054109

Descripció tècnica:

Protector/coixinet#per clamp vascular amb malla i punts d'ancoratge, mida #90mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30054464

Descripció tècnica:

Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta roma de 5mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30058572

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia hemorroidal THD compost per: 1 anuscopi THD,6 sutures absorbible a/agulla corba,1 portaagulles metàl.lic,1 sonda Doppler estèri i esponja hemostàtica absorbent.Compatible amb sistema THD Evolution o Revolutions o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30060697

Descripció tècnica:

Protector/coixinet#per a clamp vascular,model piramidal, mida 86mm,de goma, lliure de làtex, estèril, un sol ús,2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30060698

Descripció tècnica:

Protector/coixinet#per a clamp vascular,model piramidal, mida 86mm,de cautxú sintètic i silicona líquid ,radiopac ,lliure de làtex, estèril, uns
ol ús,2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30061600

Descripció tècnica:

Equip per ablació d'hemorroides per radiofreqüència, d'un sol ús. Compost per:Catèter HPR45i i anoscopi amb llum led orientada.Mida cat:1,9mmØx2
00mm llargària amb revestiment PTFE.Punta aguda de 50mm.Compat amb generador de RF Rafaelo o equiv

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30061839

Descripció tècnica:

Fixador-fixador per penis, pediàtric per cirurgies d'hipospàdia i altres IQ uretrals.Placa de polietilè, llisa i dura amb escotadura ,orificis i
ranures per passar els fils.Mida 150x88x2 mm.Estèr,1 ús

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30062151

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 0,4 a 1.0mm, pressió de 8 a 15g mm2, longitud total
12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30062152

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 0,6 a 1.5mm, pressió de 15 a 25g mm2, longitud total
12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30062153

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 30 a 50g mm2, longitud total
12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30062154

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 50 a 75g mm2, longitud total 12,6
mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30062155

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 0.6 a 1.5mm, pressió de 20 a 35.5g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30062156

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 45 a 60g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30062157

Descripció tècnica:

Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 70 a 85g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30062158

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 70 a 85g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30062166

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia per vena, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 0,4 a 1.0mm, pressió de 8 a 15g mm2, longitud total 12,6mm; 2.6 mm amplada cada un, amplada total 16mm, amb color, radioopacs, estèrils, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30062167

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, per vena, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 0,6 a 1.5mm, pressió de 15 a 25g mm2, longitud total 15,3 mm; 2.6 mm amplada cada un, 20mm amplada total, amb color, radioopacs, estèrils, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30062168

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, per vena, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 30 a 50g mm2, longitud total 17,3mm; 3.5 mm amplada, ample total de 21mm, amb color, radioopacs, estèrils, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386507 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30062169

Descripció tècnica:

Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, per vena, amb dents, resina, mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 50 a 75g mm2, longitud total 20 mm; amplada indiv 3.5, 21 mm amplada total dels 2, amb color, radioopacs estèrils, un sol ús.

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX - D3 - Fitxa Requisites Obligat compliment

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
1	30004022	Extractor de varius/fleboextractor de poliamida (PA) compost de tres olives:(Ø 9,5mm, 12,8mm i 15,4mm aprox),un mànec amb dos cables de 1 ,54/ 1 ,66 mm x 100 cm,estèril.		
2	30020790	Separador elàstic quirúrgic 360º G 9-14cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP,estèril,sol ús.		
2	30020791	Separador/retractor elàstic quirúrgic 360º M 5-9cm a/anell rígid auto-re tracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP,estèril ,sol ús.		
2	30028243	Separador /retractor elàstic quirúrgic 360º XL 11-17cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP ,estèril,sol ús.		
2	30030091	Separador /retractor elàstic quirúrgic 360º XXL 17-25cm a/anell rígid auto-retracc subjecc auto transp/imperm PUR mèdic 100%.Lliure làtex/DHP ,estèril,sol ús.		
2	30032530	Separador/retract elàstic quirúr 360º,mida XL Ø 11-17 cm, auto-retracció per a laparotom i cesàries camp operatiu 227cm².Compost: cercol sup rí gid, un de distensió, subjecció automàtic, membrana central transp/imper meab PUR.Lliure làtex/DHP,estèril		
2	30032531	Separ/retract elàstic quirúrgic 360º ,mida L ,9-14cm auto-retracció per a laparotom i cesàries Ø camp operatori 176 cm².Compost:cercol sup rígid ,un de distensió, subjecció automàtic,membra central transp/impermeab PUR.Lliure làtex,DHP,apirò,estèril		
3	30019657	Ganxo per a separ/retractor en interv quirúrg , acer inox/silicona elàstica amb topalls a/punta semi roma 5 mm,(8unit), estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.		
3	30031539	Separador o retractor per intervencions quirúrgiques,material de resina, quadrat, mides:14,1x14,1cm amb 4 frontisses lateral 20 obert perifèr.Un sol ús, estèril,lliure làtex.Compatible ganxos 30040195/30040196/30019657.		
3	30031540	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta roma de 12mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica sense topalls, estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.(8unit)		
3	30040196	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta aguda de 5mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539.		
3	30040197	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb punta aguda de 3mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús.Compatible SAP 30031539.(8unit)		
3	30041994	Separador o retractor per intervencions quirúrgiques,material de resina, forma doble circular asimètrica ,mides: 35,5x28,8x15,8x19cm amb 2frontisses laterals.Sol ús, estèril,lliure làtex.Compatible ganxos 30040196/3 00 40197/30019657/3001540.		
3	30042562	Separador o retractor,tipus Roux o equivalent,longitud 170mm+/-5cm,mides distals: 1 retractor de 36mmx20mm i 1 retractor de 20mmx15mm+/-2mm,plàs tic biocompatible,estèril,sol ús.		
3	30052786	Separador o retractor per intervencions quirúrgiques pediàtriques ,material de resina,forma circular asimètrica,mides: 15x10x11,5cm+/-1cm amb 2 frontisses laterals.1ús,estèril,lliure làtex.Compatible ganxos 30040196/30040197/30019657/30031540		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
3	30054464	Ganxo per a separador/retractor en intervencions quirúrgiques amb puntar oma de 5mm, d'acer inoxidable i cos de silicona elàstica amb topalls, estèril, un sol ús. Compatible SAP 30031539.		
4	30034982	Espàtula cerebral atraumàtica,metàl·lica amb revestiment de silicona ,plana,recte. Mida: diàmetre 7,5mm,llargària 200mm+/-5cm. Estèril,un sol ús		
4	30034983	Espàtula cerebral atraumàtica,metàl·lica amb revestiment de silicona ,plana,recte. Mida: diàmetre 10mm,llargària 200mm+/-5cm. Estèril,un sol ús		
4	30034984	Espàtula cerebral atraumàtica,metàl·lica amb revestiment de silicona ,plana,recte. Mida: diàmetre 12,5mm,llargària 200mm+/-5cm. Estèril,un sol ús		
5	30061839	Fixador-fixador per penis, pediàtric per cirurgies d'hipospàdia i altres IQ uretrals.Placa de polietilè, llisa i dura amb escotadura ,orificis i ranures per passar els fils.Mida 150x88x2 mm.Estèr. 1 ús		
6	30002705	Pinça/clamp hemostàtica de 12 cm ± 1cm,tipus klemmer,material plàstic,lliure de làtex,estèril,un sol ús,envàs individual.		
6	30004258	Pinça de dissecció per a cures,recta fina sense dents, mida 12+/-1 cm a prox, material de plàstic, lliure de làtex, estèril. envàs individual. un sol ús.		
6	30010703	Pinça clamp hemostàtica de 12cm ±1cm,tipus klemmer,material plàstic ,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Presentació envàs 50 unitats.		
6	30018301	Pinça hemostasia d'acer inox,punta corba, sense dents, tipus Halsted. Mida 12,5+/-1cm estèril,envàs individual,un sol ús.		
6	30031547	Pinça de dissecció de 13cm de plàstic,lliure de làtex,no estèril,un sol ús		
6	30042563	Pinça de dissecció recta de 20cm ± 1cm,amb plataforma serrada,tipus Cush ing,de plàstic biocompatible.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.		
6	30042564	Pinça tipus Pean,punta recta,20cm ±1cm,amb plataforma serrada,de plàstic biocompatible. Lliure de làtex,estèril,un sol ús,envàs individual .		
7	30031683	Equip torniquet per a cirurgia cardiovascular per canulació de catèters o derivacions,compost de: 1llaç mandrí metàl·lic,6 tubs(2 blau,1 vermell i 3 transparents)14cm long+/-2cm. Estèril.un sol ús..		
7	30031684	Cinta de cotó per a retracció de vasos, urèters i nervis. Amplada 4 mm, llargària 75 cm,recobrimnt siliconat,color blanc. Estèril.		
7	30031685	Cinta identificadora de silicona radioopaca,per identificació,retracció u oclusió vasos sanguínis i nervis Color vermell(arteries).Mida MINI: Ample 1.3mm,alt 0.9mm llargària 45 cm.Lliure de làtex, Estèril, un sol ús .		
7	30031686	Cinta identificadora de silicona radioopaca,per identificació,retracció u oclusió vasos sanguínis i nervis Color blava(venes).Mida MINI:Ample 1. 3,alt 0.9mm, llargària 45cm.Lliure de làtex, Estèril, un sol ús		
7	30031688	Cinta identificadora de silicona radioopaca,per identificació,retracció u oclusió. Color blanc(nervis i tendons).Mida MINI :Ample 1.3,alt 0.9mm ,llargària 45cm.Lliure de làtex. Estèril. un sol ús		
7	30031689	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color vermell (artèries).Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0;llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
7	30031690	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color blau (venes).Mida GRAN : Ample 2,5; Alt 1,0;llargària 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
7	30031691	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió.Color blanc(nervis i tendons).Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1, 0 ;llargària 45 cm. Lliure de làtex. estèril. d'un sol ús.		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
7	30031692	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color groc (urèters). Mida GRAN: Ample 2,5; Alt 1,0; Longitud 45 cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
7	30031693	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió. Color groc (urèters). Mida MINI: Ample 1,3; Alt 0,9; Longitud 45cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
7	30031694	Cinta cilíndrica suau i atraumàtica, elàstica i d'alta flexibilitat, de silicona per a subjectar artèries amb agulla corba de punta roma. Mida 18 G, 30+/-2cm long, estèril, d'un sol ús.		
7	30032200	Cinta identificadora de silicona radioopaca, per a identificació, retracció o oclusió de vasos sanguinis i nervis. Color blau (venes). Mida EXTRA GRAN: Ample 5.0, Alt 1.3, llargària 45cm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
7	30043377	Torniquet de vasos en hemorràgia (severa) d'extremitats superiors i inferiors, tipus cremallera, corretja dentada de niló, resistència tracció mínima de 420kg/cm ² , 2 anelles de bloqueig, sivella trinquet. Mida desplegat 100cm +/- 10cm, estèril, un sol ús.		
7	30031682	Equip torniquet per a per canulació catèters, cànules i shunts en cirurgia cardiovascular, compost: 1 obturador, 2 cintes de fixació de 3,2mmx61cm +/- 1cm, 2 beines amb tap de retenció. Estèril, un sol ús.		
7	30032201	Cinta de cotó amb la malla impregnada de silicona i les vores arrodonides, identificació i retracció d'estructures nervioses, color blanc, amplada 8 mm, llargària 75cm +/- 5cm. Estèril, lliure de làtex i SVHC.		
8	30004243	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø artèries < 1 mm pressió 40 gr mm ² , longitud total 14,5 mm; 2,5mm amplada, separació entre clamps 7,5mm, pes 0,13gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30004791	Clamp senzill recte Fogarty de mandíbules paral·leles llargada 17mm±2mm, obertura màxima Ø6 mm, pressió suau uniforme, de plàstic amb ressort interior, per microcirurgia, radiopac. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
8	30004817	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø artèries < 1mm pressió 40g mm ² , longitud total 14,5 mm; 2,5mm amplada, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30004818	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de plàstic i acer, mides: Ø artèries < 1-2mm pressió 60g mm ² , longitud total 17 mm; 3mm amplada, separació entre clamps 12,5mm, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30004819	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: Ø venes < 1 mm, longitud total 14,5 mm, pressió 20 gr, 2,5 mm amplada, separació entre clamps 7,5mm, pes 0,13gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30015564	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, Ø venes de 2 fins a 4 mm, mides: longitud total 21,5 mm, pressió 40 gr, 3,5 mm amplada, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30015631	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø fins 1 mm, longitud total 14,5 mm, pressió 20 gr, 2,5 mm amplada, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
8	30034235	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: arteries Ø 1-2mm, pressió 60gmm2, longitud total 17 mm; 3 m m amplada, pes 0,12gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30034236	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø 1-2mm pressió 30gmm2, longitud total 17 mm, 3 mm am plada, pes 0,12gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30034237	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer, mides: venes Ø 1-2mm pressió 30g mm2, longitud total 17 mm, 3 mm amplada, separació entre clamps 12,5mm, pes 0,25gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30040048	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per arteries Ø de 2 fins a 4 mm, mides: longitud total 21,5 mm, pr essió 120 gr, 3,5 mm amplada pes 0,03gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30040050	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per venes Ø de 0,2-1 mm, mides: longitud total 11 mm, pressió 15 g r, 2,3 mm amplada, pes 0,03gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
8	30040051	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de policarbonat i acer per venes Ø de 0,2-1 mm, mides: longitud total 11 mm, pressió 15 gr, 2,3 mm amplada, separació entre clamps 8mm, pes 0,06gr, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30051021	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina mides vasos: de Ø0,4 a 1.0mm, pressió de 13,5 a 20g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30051022	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de resina amb dents, mides vasos: de Ø0,4 a 1.0mm, pressió de 13,5 a 20g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30051023	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, de resina amb dents ,mides vasos: de Ø0,6 a 1.5mm, pressió de 20 a 32,5 gmm2, longitud to tal 15,3 mm; 3 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30062151	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina ,mides vasos: de Ø 0,4 a 1.0mm, pressió de 8 a 15g mm2, longitud total 12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30051020	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia, de resina sintètica i acer, mides vasos: de Ø1 a 2.25mm, pressió de 45 a 60g mm2, longitud total 17 mm; 3.5 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30062152	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina ,mides vasos: de Ø 0,6 a 1.5mm, pressió de 15 a 25g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30062153	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina ,mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 30 a 50g mm2, longitud total 12,6m m; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		
9	30062154	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia, amb dents, resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 50 a 75g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color, radioopac, estèril, un sol ús.		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
9	30062155	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 0.6 a 1.5mm, pressió de 20 a 35.5g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.		
9	30062156	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 45 a 60g mm2, longitud total 12,6 m; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.		
9	30062157	Clamp senzill recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 70 a 85g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.		
9	30062158	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,amb dents,resina ,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 70 a 85g mm2, longitud total 12,6 mm; 2.6 mm amplada, amb color,radiopac, estèril, un sol ús.		
9	30062166	Clamp doble recte per anastomosis en microcirugiaper vena,amb dents ,resina,mides vasos: de Ø 0,4 a 1.0mm, pressió de 8 a 15g mm2, longitud tota l 12,6mm; 2.6 mm amplada cada un, amplada total 16mm,amb color ,radiopacs, estèrils, un sol ús.		
9	30062167	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,per vena,amb dents ,resina mides vasos: de Ø 0,6 a 1.5mm, pressió de 15 a 25g mm2, longitud tot al 15.3 mm; 2.6 mm amplada cada un,20mm amplada total, amb color ,radiopacs, estèrils, un sol ús.		
9	30062168	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,per vena,amb dents ,resina,mides vasos: de Ø 1 a 2.25mm, pressió de 30 a 50g mm2, longitud tota l 17,3mm; 3.5 mm amplada,ample total de 21mm, amb color,radiopacs, estèrils, un sol ús.		
9	30062169	Clamp doble recte per anastomosis en microcirurgia,per vena,amb dents ,resina,mides vasos: de Ø 2 a 4mm, pressió de 50 a 75g mm2, longitud total 20 mm; amplada indiv 3.5,21 mm amplada total dels 2, amb color ,radiopacs estèrils, un sol ús.		
10	30031536	Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, recte, mida mitjana, pressió 75-80gr, color groc, radiopac, estèril, d'un sol ús.		
10	30031537	Clamp senzill de plàstic per a vasos, Bulldog, angle 45º, mida mitjana, pressió 75-80gr, color groc, radiopac, estèril, d'un sol ús.		
10	30031538	Clamp senzill de plàstic per a vasos,Bulldog,angle 45º,mida gran,pressió 165-175gr,color taronja,radiopac,estèril,d'un sol ús.		
11	30031703	Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 5,7mm.Color blau. Estèril,un sol ús,presentació 2 unitats.		
11	30031704	Tubs protectors o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics petits, radiopacs, mida Ø2,6mm x11mm long .(12 protectors per blister),Color groc. Estèril. un sol ús.		
11	30031706	Protector/coixinet per clamp vascular amb malla i punts d'ancoratge, mida 45mm, lliure de làtex, estèril,2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent.		
11	30032202	Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 2,54mm.Color vermell. Estèril,un sol ús, presentació 2 unitats		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
11	30032203	Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm; Ø 4,0 mm.Color blanc. Estèril,un sol ús,presentació 2 unitats.		
11	30039717	Protector per clamp de pinces vasculares amb tres punts d'ancoratge, mida 30mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent		
11	30051969	Tub protector silicona per a instruments quirúrgics,clamps,amb vores dentades longitudinalment a la cara interna,Ø5mm(0,20)+/-0,08mm ,llargària 13 cm+/-1cm,color blanc,estèril,un sol ús,envàs mínim 2 unitats		
11	30054109	Protector/coixinet per clamp vascular amb malla i punts d'ancoratge, mida 90mm, lliure de làtex, estèril, 2 unitats.Per a adaptar als clamps Applied o equivalent.		
11	30060697	Protector/coixinet per a clamp vascular,model piramidal, mida 86mm,de goma, lliure de làtex, estèril, un sol ús,2 unitats.		
11	30060698	Protector/coixinet per a clamp vascular,model piramidal, mida 86mm,de cautxú sintètic i silicona líquid,radiopac , lliure de làtex, estèril, uns ol ús,2 unitats.		
12	30032523	Caixa de plàstic amb escuma i imant per a la recollida de puntes punxants en la cirurgia,estèril,sol ús		
12	30032524	Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí, estèril. Lliure de làtex,un sol ús.		
12	30032528	Organitzador de sutures per cirurgia cardíaca,compost de tres tires adhesives,ranurades i numerades.22,5x3cm..Lliure de làtex,estèril,un sol ús.		
12	30032786	Safata rodona de polipropilè amb topall interior,per a la manipulació de guies vasculares,graduada,capacitat 2500ml. Estèril,un sol ús,lliure de làtex.		
12	30043611	Dispositiu d'il·luminació LED adaptable i versàtil a qualsevol instrumental quirúrgic, consta de: lent i anell de silicona amb cable PVC 3,2 m,Ø int 8mm,de grau mèdic (300 minuts de llum), estèril, sol ús.Compatible o equivalent tecnologia LED FA-BL01		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
13	30051545	<p>HVH-Equip Histerectomia amb/sense anexectomia laparoscòpica amb segellador, compost per 7 elements. 1- Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mm x120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 2-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud ,radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament auto ajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 1-Cànula Ø5mmx100 mm per tròcar abd òptic punta dilat sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzemaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360º, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22º per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm longitud ,topalls ceràmics, longitud segellament 20mm i 18mm de tall ,tall independent. Activació manual i pedal, mànec ergonòmic per a cirurgia tancada. 1-Placa de retorn REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.</p>		
13	30051546	<p>HVH Equip Anexectomia complexa per laparoscopia amb segellador, compost per 7 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud ,radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2-Cànula Ø5mmx100mm per tròcar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador ,capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació i desinflatió. 1-Tisora tipus Metzemaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360º, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça dissecció roma per a segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm de longitud, obertura 14,5mm, longitud segellament 19,5mm i 17,8mm de tall, obertura bilateral mandíbules , activació manual i pedal amb fixació automàtica, tall independent del segellat, per a cirurgia tancada. Rotació 180º. Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència 1-Placa de retorn tipus REM adult s/cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm, adhesiu conductor. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.</p>		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
13	30051547	<p>HVH Equip Anexeetomia simple per laparoscopia sense segellador,compost p er 7 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress,Ø2,1mmx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx 100mm long ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort,mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 2-Cànula Ø5mmx100mm per tròcar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100,radiotr,bisel l i amb estries fix,doble vàlvula integrada,mànec obturador,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzembaum,per a endoscòpia laparoscòpica,puntes corbes de 15-18mm llarg,Ø5mmx3 3-37cm de llargària,eix rotatori de 360º,mànec ergonòmic,totalment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Bossa de recollida material per a endocirurgia laparoscòpica,per a trocars Ø10/11mm ,obertura ajustable,dispositiu introductor tipus caça-papallones ,capacitat de 225cc a 250cc. 1-Placa de tipus REM adult s/cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM. placa 182mmx115mm,adhesiu conductor. Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.</p>		
13	30051548	<p>HVH-Equ Histerectomiamb linfadenectomia pèlvica bilateral laparoscòpica amb segellador compost per 8 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress,Ø2,1mmx120mm de llargària,amb mecanisme de seguretat,d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal,full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm longitud ,radiotransparent,acoplable a instruments de 5mm,amb vàlvula,reductor integrat,obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort ,mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu;clau de pas L-L per a insuflació i desinflació. 2-Cànula Ø5mmx100mm per tròcar abdominal òptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100,radiotransparent,bisel l i amb estries fix,doble vàlvula integrada,mànec obturador,capçal baix perfil,clau pas L-L per insuflació i desinflació. 1-Tisora tipus Metzembbaum,per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg,Ø5mmx33-37cm de llargària,eix rotatori de 360º,mànec ergonòmic,totalment aïllada,adaptador a monopolar. 1-Pinça dissecció roma per a segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm de longitud ,nano recobriment,obertura 14,5mm,longitud segellament 19,5mm i 17, 8mm de tall,obertura bilateral mandíbules,activació manual i pedal amb fixació automàtica,tall independent del segellat,per a cirurgia tancada.Rotació 180º.Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència. 1 -Electrobisturí bipolar punta plana roma,mànec control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4 mm connexió,cable siliconat s/memòria,mínim 3m. 1-Placa de</p>		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
13	30051550	<p>HVH-Equip linfoadenectomia pèlvica bilateral i para-aòrtica i/o omentectomia laparoscòpica amb segellador compost per 13 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mm x100mm longitud, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2-Cànula Ø5mmx100mm per trocar abdòptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació desinflatió. 1-Tisora tipus Metzbaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360º, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22º per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm longitud, topalls ceràmics, longitud segellament 20mm i 18mm de tall, tall independent. Activació manual i pedal. 4-Bossa de recollida de material per a endocirurgia laparoscòpica, per a trocars diàmetre 10/11/12 mm, sense sistema de tancament, precarregada dintre cànula introductora de diàmetre 10mm, capacitat 150cc a 200cc. 1-Electrobisturi bipolar punta plana roma, mànec control manual (tall-coagulació) placa interna seguretat, fix hexagonal seguretat estanca, acer, Ø2,4mm connexió, cable</p>		
13	30051551	<p>HVH-Equip linfoadenectomia para-aòrtica extraperitoneal laparoscòpica amb segellador compost per 11 elements: 1-Agulla de pneumoperitoneu o de Veress, Ø2,1mmx120mm de llargària, amb mecanisme de seguretat, d'acer inoxidable. 1-Trocars abdominal, full tallant/ganiveta Ø5mmx100mm long, radiotransparent, acoplable a instruments de 5mm, amb vàlvula, reductor integrat, obturador amb punta de fulla plana linial aguda protector de ressort, mànec trocar amb segellament autoajustable intern per a evitar pèrdua de pneumoperitoneu; clau de pas L-L per a insuflació i desinflatió. 2-Cànula Ø5mm x100mm per trocar abdòptic punta dilatadora sense full tallant Ø5mmx100, radiotransparent, bisell i amb estries fix, doble vàlvula integrada, mànec obturador, capçal baix perfil, clau pas L-L per insuflació desinflatió. 1-Tisora tipus Metzbaum, per a endoscòpia laparoscòpica, puntes corbes de 15-18mm llarg, Ø5mmx33-37cm de llargària, eix rotatori de 360º, mànec ergonòmic, totalment aïllada, adaptador a monopolar. 1-Pinça mandíbula corba 22º per segellament vasos i teixits fins Ø7mm de 37cm long, topalls ceràmics, long segellament 20mm i 18mm de tall, tall independent. Activació manual i pedal. 2-Bosses de recollida de material per a endocirurgia laparoscòpica, per a trocars Ø10/11/12mm, sense sistema de tancament, precarregada dintre cànula introductora de Ø10mm, capacitat 150cc a 200cc. 1-Electrobisturi bipolar punta plana roma, mànec control manual (tall-coagulació) placa interna seguretat, fix hexagonal seguretat estanca, acer, Ø2,4mm connexió, cable siliconat sense</p>		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
13	30051553	HVH-Equip laparotomia per cirurgia d'ovari amb segellador compost 7 elements: 1-Pinça roma de 23cm longitud,Ø5mm eix,19,5mm longitud segellat,17,8mm longitud tall,per a segellament vasos i teixits fins Ø</=7mm per rotació 180º,segellat independent del tall,antiadherent.Obertura bilateral ,topalls ceràmics,activació manual/pedal,mànec ergonòmic.Compatible unitat electroquirúrgica digital alta potència. 2-Hemostàtic absorbible (28 dias) pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó,trisilina i polietilenglicol.Mida 5x10cm. 1-Grapadora de sutura cutània,sutura lineal, recta,precarregada amb 35grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable mida aproximada grapa tancada ,5mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica. 1- Electro bisturí bipolar punta plana roma,mànec control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4m m connexió,cable siliconat sense memòria,mínim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn tipus REM adults/ cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM,placa 182mmx115 mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.		
13	30051554	HVH-Equip cirurgia vulvar amb segellador compost 7 elements: 1-Dissector /segellador amb nano-recobriment antiadherent per segellar i tallar vasos i teixits fins Ø7mm,longitud 21cm,mandíbula de 21,6mm angulada 40° ,ful la de tall a la zona mitja de les mandíbules.Ergonòmic ,sense rotació.Activació manual i amb pedal. 1-Hemostàtic absorbible(28 dias) pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó,trisilina i polietilenglicol. Mida 5x10cm. 1-Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada amb 35grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable,mida aprox grapa tancada,5mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica. 1- Electro bisturí bipolar punta plana roma,mànec control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal seguretat estanca,acer,Ø2,4mm connexió,cable siliconat sense memòria,mínim 3m. 1-Netejador/rascador per a punta terminal electrobisturí. 1-Placa de retorn tipus REM adult sense cable per electrocirurgia monopolar amb generador no REM,placa 182mmx115mm,adhesiu conductor.Lliure de làtex ,estèril,un sol ús.		
14	30058572	Equip per a cirurgia hemorroidal THD compost per: 1anuscopi THD,6sutures absorbible a/agulla corba,1portaagulles metàl.lic,1sonda Doppler estèril i esponja hemostàtica absorbent.Compatible amb sistema THD.Evolution o Revolutions o equival		
14	30061600	Equip per ablació d'hemorroides per radiofreqüència, d'un sol us. Compost per:Catèter HPR45i i anoscopi amb llum led orientada.Mida cat:1,9mmØx2 00mm llargària amb revestiment PTFE.Punta aguda de 50mm.Compat amb generador de RF Rafaelo o equiv		
15	30001442	Proctoscopi de plàstic transparent de mides aproximades 20mm de diàmetre i 80mm +/-2mm de llargària,amb pas per a font de llum. Estèril,d'un sol ús.		
15	30001816	Anoscopi de plàstic transparent,mides aproximades diàmetre 20mm ,llargària 85mm +/-2mm,estèril,d'un sol ús,compatible amb aparell HEINE o equivalent.		
15	30001817	Rectoscopi de plàstic,diàmetre 20mm,llargària 250mm +/-10mm, estèril,d' un sol ús,compatible amb aparell HEINE o equivalent.		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
15	30002018	Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/màneg per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum 23 mm, llargària 55/88mm, punta bisellada, d'un sol ús. <u>Lliure de làtex</u>		
15	30004586	Lligador d'hemorroides per succió amb disparador mecànic, transparent, llargària 13cm +/-2cm i diàmetre interior 10mm +/-1mm, connector de succió universal, no estèril, d'un sol ús. Amb 3 anelles. Lligador lliure de latex, <u>anelles de làtex</u>		
15	30004815	Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/màneg per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum 18 mm, llargària 43/56mm, punt a bisellada, d'un sol ús. <u>Lliure de làtex</u>		
15	30004816	Valva anal de plàstic transparent, amb màneg per introduir llapis o font de llum. Diàmetre: 22,4mm, longitud 98mm +/-2mm. D'un sol ús. <u>Lliure de làtex</u>		
15	30007825	Anoscopi autoil·luminat operatiu, amb màneg per introduir llapis o font de llum, de plàstic, mides aproximades diàmetre interior 23 mm, llargària tub 65 mm, punta recte, d'un sol ús.		
15	30008648	Anoscopi autoil·luminat operatiu, a/màneg per introduir font de llum, de plàstic, transparent, mida diàmetre llum int 18,5 mm, llargària operati va 65mm +/-2mm, punta recta, d'un sol ús. <u>Lliure de làtex</u>		
15	30012877	Proctoscopi de plàstic transparent amb màneg per introduir llapis o font de llum. Mides: 20mm de diàmetre extern, 17mm de diàmetre intern i 130m m +/-10mm de llargària, un sol ús.		
15	30016497	Rectoscopi polivalent biòpsia i eco transrectal, a/màneg per introduir font de llum. Plàstic transparent, Ø intern 18mm, Ø extern 21mm, llarg gradu tub 220mm +/-10mm, llarg total 235mm +/-10mm, lliure de làtex. Estèril, un sol ús. Compat a/ transduct B&K.		
15	30023293	Anoscopi autoil·luminat operatiu, amb màneg per introduir llapis o font de llum, fenestrat amb punta tancada i arrodonida, de plàstic transparent, mida diàmetre intern 32 mm, llargària 90mm +/-5mm. d'un sol ús. <u>Lliure de làtex</u>		
15	30027876	Equip rectoscopi format per tub milimetrat i màneg de mides: longitud út il 220mm +/-10mm i longitud total 235mm +/-10mm, diàmetre extern 21mm, obturador i finestra d'exploració. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductors B&K 2050/2052/1850		
15	30035295	Equip anuscop de policarbonat, format per enfilador de sutures, predilatador anal amb revestiment intern, dilatador anal amb finestres de fixació i dilatador mil·limetrat de 34mm +/-1cm amb canal de treball. <u>Lliure de làtex. Estèril Un sol ús.</u>		
15	30036041	Proctoscopi pediàtric diagnòstic, de plàstic, amb suport làmpara, diàmetre llum 15mm, llargària tub 63mm +/-2cm, punta rodona, d'un sol ús.		
15	30040756	Rectoscopi de plàstic transparent diàmetre 23mm, llargària 200mm +/-10mm, compost de: lupa (lent X4), llum integrada (LED) en el dispositiu, amb insuflador d'aire manual. <u>Lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús.</u>		
15	30040757	Pistola de succió amb dispositiu per lligadures de quatre bandes, un con introductor i un lliscant de càrrega. <u>Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.</u>		
15	30040758	Proctoscopi operatiu autoil·luminat, fenestrat, de plàstic transparent, a traumàtic, mides aproximades 24mm de diàmetre i 122mm +/- 10mm de llargària i finestra de 85x26 mm, amb llum integrada (LED) en el dispositiu. <u>Lliure de làtex estèril d'un sol ús.</u>		
15	30051962	Raspall de fístula per a cirurgia oberta en proctologia, per desbridat tracte fistulós, abans de posar el clip de proctologia, raspall l Ø 4mmx4cm llargària, Ø dels extrems de 2,2mm i 2,5mm, 30cm long total, d'acer, estèril, un sol ús. Compatible OTSC o equival.		

ANNEX D3_Fitxa Requisites Obligat compliment
Identificació de l'empresa:

 Nom

 NIF

Lot	Codi Sap	Desc. Material	Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018	
			SI	NO
15	30053230	Proctoscopi per anoscopies d'alta resolució amb sistema de connexió amb videocàmera amb funda protectora i llum integrada. Diàmetre extern 25mm ,l ongitud operativa 66mm. Un sol ús.		
16	30014303	Llapis de calor/cauteri per a moldejar i tallar implants reabsorbibles .Compost per: 1 terminal de modelatge de malles reabsorbibles un cop col.locades i 1 terminal de tall per plaques i cargols. Bateria de liti ,estèril,un sol ús.		
17	30032526	Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori, de punta estàndard/mitja, estèril.		
17	30032525	Bolígraf cutani no tòxic,tinta violeta de genciana no irritant,punta fina,per a marcar camp operatori,amb regle,estèril.		

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

*(No hi ha Excel per omplir, hi ha que presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex 4 =
Criteris puntuables del PCAP)*

ANNEX – E – Fitxa Tècnica Individual Fotogràfica

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

Identificació del producte:

Codi de producte ICS	
Referència fabricant	
Referència distribuïdor	
Marca comercial	

Lot:

Codi sap


Denominació general del producte:

Especificacions tècniques

Composició

Mesures

Fotografia del producte:

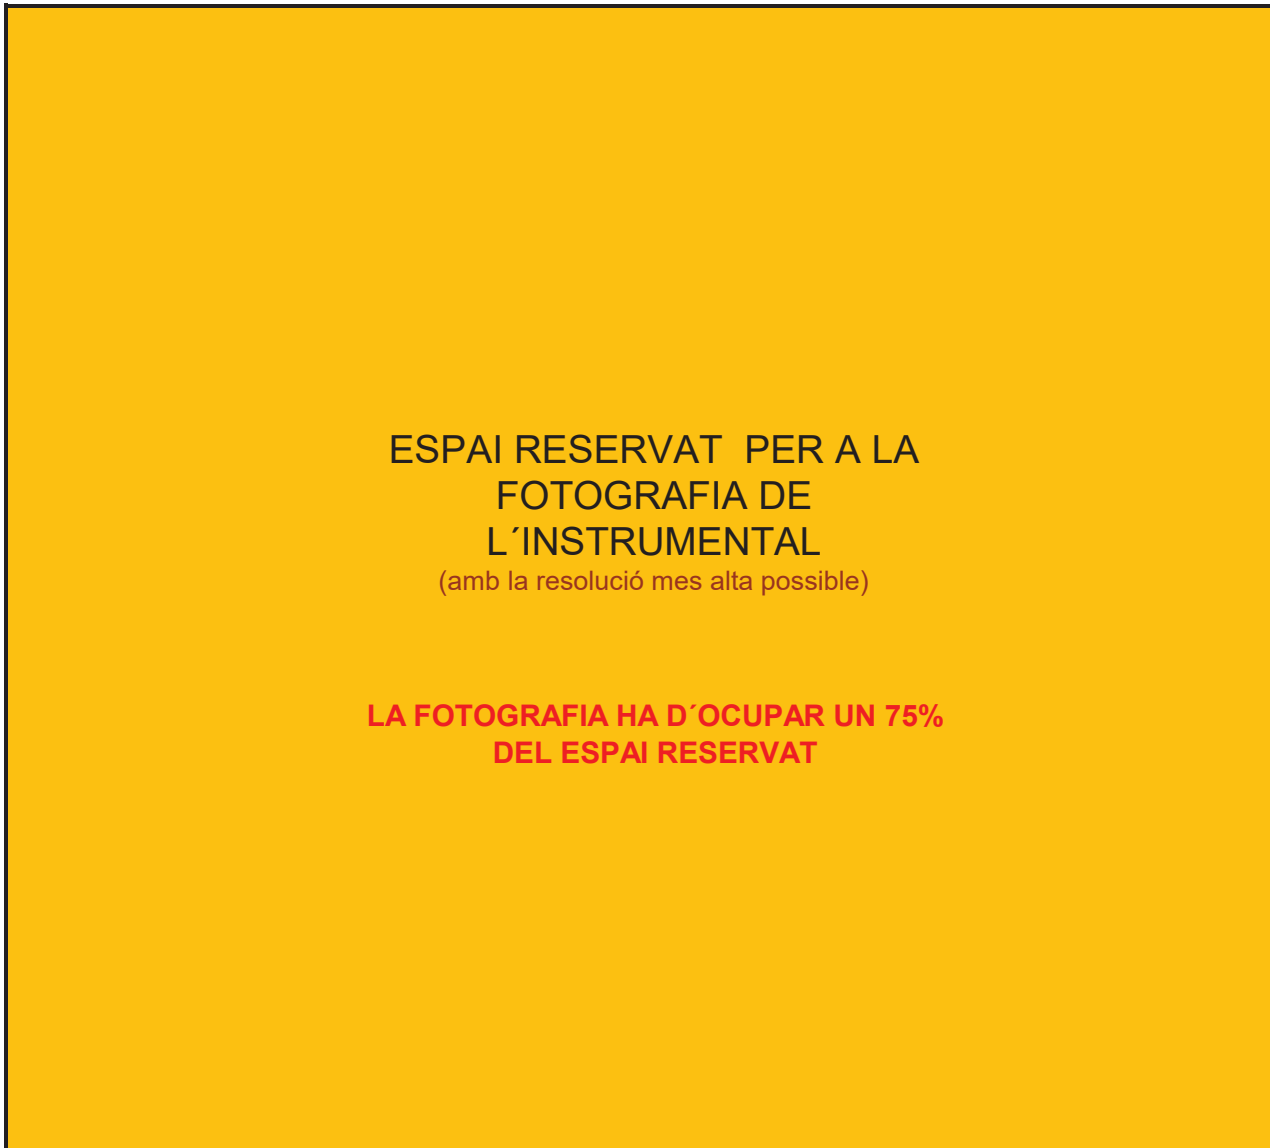

ANNEX F

Presentació de mostres obligatòria.

Relació de codis SAP afectats

ANNEX F - RELACIÓ DE CODIS amb presentació de mostra obligatòria

Lot	Codi Material	Descripció	Nombre de mostres
17	30032525	Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori, de punta estàndard/mitja, estèril.	5
17	30032526	Bolígraf cutani no tòxic,tinta violeta de genciana no irritant,punta fina,per a marcar camp operatori,amb regle,estèril.	5