

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIONISME CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIONISME CORONARI
PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

1. Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és el subministrament de guies per a intervenció coronari per a la unitat d'Hemodinàmica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

2. Característiques bàsiques. (documentació a incloure al SOBRE 2)

Criteris tècnics no puntuables: Requisits mínims obligatoris: En cas de no complir els següents requisits quedaran exclosos de la licitació.

Valoració Guia intervenció coronari – model 1

- Guia coronària per passar lesions amb resistència moderada
- Control del torque 1:1
- Mida: 0,014"
- Llargada: rang entre 180 i 200 cm
- Recobriment hidrofílic

Valoració Guia intervenció coronari – model 2

- Guia coronària per taps durs amb capçal proximal ambigu i resistència severa
- Control del torque 1:1
- Mida: 0,014"
- Llargada : rang entre 180 i 200 cm
- Recobriment hidrofílic

Cal incloure al sobre 2 la fitxa tècnica del producte i omplir el model d'oferta tècnica inclòs al PCAP.

3. Requeriments contractuals obligatoris

3.1 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari gestionar el fi de la vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per part de l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus i les indicacions de l'ARC (*Agència de Residus de Catalunya*)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques

3.2 Marcat CE i etiquetat

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Obligatorieta de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.

3.3 Requeriments de subministrament

Pel que fa al lloc de lliurament del material serà al magatzem de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta o si s'ha especificat així, al de l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE..

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi el centre. La recepció del material s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

El lliurament del material vindrà acompanyat de l'albarà corresponent i tota la documentació tècnica permetent que permeti relacionar cada material amb l'abast d'aquest plec abans de desembalar cap paquet.

El termini de lliurament del material és de 3 dies hàbils des de la data de formalització del contracte.

4. Import de licitació

Material	Ref. proveïdor	IVA	Unitats previstes	Preu Unitari sense IVA	Total sense IVA	Preu Unitari amb IVA	Total amb IVA
30069474 Guia per a intervenció coronari per a procediments de CTO (oclusions cròniques), de 0,014"x190cm - Model 1 – Lesions amb resistència moderada.		21%	20	250,00 €	5.000,00 €	302,50€	6.050,00 €
30069474 Guia intervenció coronari procediments de CTO, de 0,014"x190cm- Model 2 – Lesions amb resistència severa		21%	12	250,00 €	3.000,00 €	302,50€	3.630,00 €
Total					8.000,00 €		9.680,00 €

La previsió de consum anual són les unitats indicades a la taula anterior.

L'import de licitació, corresponent al consum de 12 mesos, és de 8.000,00 euros sense IVA (9.680,00 euros IVA inclòs).

Aquesta quantitat es podrà modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats, sense que l'empresa adjudicatària tingui dret a percebre cap indemnització per la variació.

No hi ha import mínim de comanda. L'import de la comanda dependrà de les necessitats del servei.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

El pagament es farà per comanda, un cop lliurat el material.

5. Criteris de valoració.

Aquesta licitació no es divideix en lots, hi haurà un sol adjudicatari per ambdós articles licitats. L'adjudicatari serà el que obtingui major puntuació en la suma total dels criteris a valorar.

5.1.1 Oferta econòmica (60 punts):

5.1.1.1 Valoració Guia intervencionisme coronari – model 1. Puntuació màxima 30 punts (Documentació a incloure al SOBRE 3)

Els licitadors hauran de presentar l'oferta en el model d'oferta econòmica que consta al PCAP.

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació (1,30)

5.1.1.2 Oferta econòmica Valoració Guia intervencionisme coronari – model 2. Puntuació màxima 30 punts (Documentació a incloure al SOBRE 3)

Els licitadors hauran de presentar l'oferta en el model d'oferta econòmica que consta al PCAP.

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

VP= Valor de ponderació (1,30)

5.2 Criteris sotmesos a judici de valor (Documentació a incloure al SOBRE 2 bis). Puntuació màxima de 40 punts:

Per tal de poder efectuar una correcta valoració del material ofertat, els licitadors hauran de lliurar obligatòriament material de mostra per valorar, amb les mateixes característiques de l'ofertat.

El material s'haurà de lliurar al Magatzem General de l'Hospital (Avda. França, s/n 17007 Girona) abans de la data de finalització del termini de presentació d'ofertes. (Horari: de 08:00 a 15:00 hores dies laborables)

L'incompliment del lliurament del material dins el termini establert serà motiu d'exclusió.

Els licitadors hauran d'incloure al sobre 2 bis l'albarà o comprovant de lliurament de l'equip.

En aplicació de la Directriu 1-2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta contractació en la que s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en el punt 4. s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteris subjectius a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2
Puntuació màxima del criteri	20 punts	20 punts

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIONISME CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
--	--

Llindar mínim de puntuació	11 punts	11 punts
----------------------------	----------	----------

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà l'obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 25 punts de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades i excloses de la licitació.

Es valoraran les següents característiques:

Valoració Guia intervencionisme coronari – model 1

- **Puntuació màxima de 20 punts:**
 - **Facilitat de pas per tortuositats: 7 punts**
 - **Facilitat de pas per oclusions de morfologia ambigua: 10 punts**
 - **Possibilitat d'avançament per microcanals: 3 punt**

Valoració Guia intervencionisme coronari – model 2

- **Puntuació màxima de 20 punts:**
 - **Disposar de suficient suport per penetrar taps durs, zones fibròtiques o calcificades: 10 punts**
 - **Disposar de força per penetrar taps durs, zones fibròtiques o calcificades: 10 punts**

6. Durada del contracte

La durada del contracte serà des de la data de formalització fins al 31 de desembre de 2025. Podrà ser prorrogat anualment fins a una durada total del contracte de 48 mesos.

7. Condicions de l'operador logístic-

Aquestes condicions s'aplicaran en el cas que les comandes es gestionin mitjançant l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES
PER A INTERVENCIÓ CORONÀRIA PER A LA UNITAT
D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP
TRUETA**


Plec de prescripcions tècniques

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retràctils
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

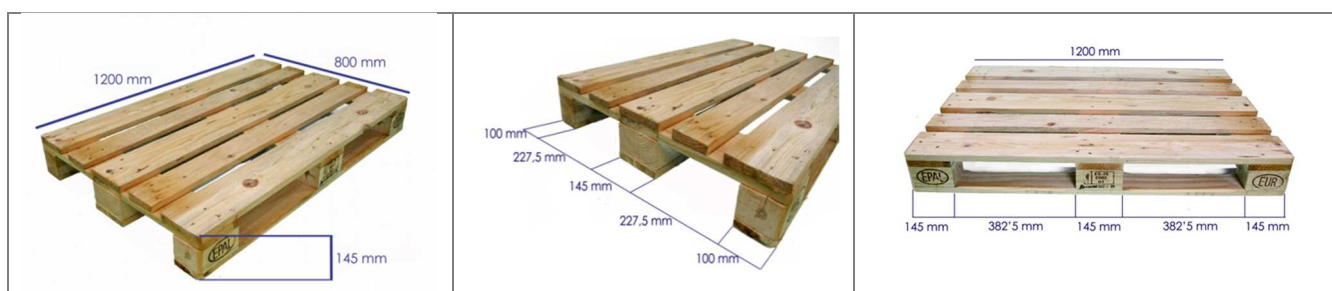

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

7.1.1. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

7.1.2 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

7.1.3 Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
--	--

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

7.1.4 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIONISME CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
--	--

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE GUIES PER A INTERVENCIÓ CORONARI PER A LA UNITAT D'HEMODINÀMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Tenim establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb :

Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

El pagament s'ha de satisfer amb el lliurament previ de la corresponent factura, en la que s'expressarà el concepte i detall del servei realitzat.

La factura s'haurà d'enviar electrònicament a través de la plataforma del consorci de l'Administració Oberta de Catalunya: www.aoc.cat, fent constar el número d'expedient - comanda així com la descripció de l'objecte del contracte.

DIR3				
DIVISIO ICS	OFICINA COMPTABLE UNITAT TRAMITADORA	ÒRGAN GESTOR	CARRER, NUM	POBLACIÓ
AH04	A09006710	A09006693	Carrer Santa Clara, 35	17007 GIRONA

Girona, maig de 2025

Dr. Victor Hugo Agudelo Montañez
Cap de la Unitat d'Hemodinàmica
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta