

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC01101434775/26/AMUP

IMPLANTS QUIRÚRGICS NEUROLÒGICS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'implants quirúrgics neurològics per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per a aquesta licitació no s'especifiquen requisits obligatoris addicionals. No s'annexa ANNEX D3 per a emplenar.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

Pel que fa a les actualitzacions del material en cessió, serà de caràcter obligatori la seva substitució per motius d'innovació tecnològica, sense repercutir cap cost econòmic als centres ICS.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101434775_2bis**

- **Annex D6 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor** (*document informatiu*)

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Guia i Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, detallats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració", del plec administratiu, "Plantilla Puntuació PCAP".
- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: *ProductData*

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Es necessària la presentació de mostra del material informat a l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101434775/26/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

Cada paquet ha de contenir el nombre de mostres per cada referència presentada que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a Gerència de compres, a l'atenció de **Vanesa García Barriocanal**, a l'adreça següent:

*Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA*

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'ANNEX E, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenició de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenició de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa

Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008

- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

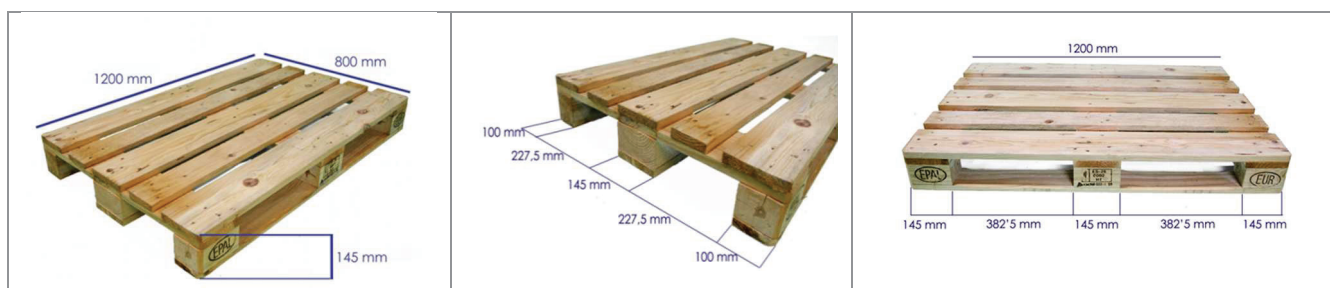

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris

ANNEX D4 - Guia per emplenar annex

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

ANNEX D5 - Product data material ofert

ANNEX D6 - Fitxa-resum, Criteris addicionals de judici de valor

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101434775/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	LOTS I CODIS OBLIGATORIS
1	EQUIPS DE DREANTGE NEUROLÒGIC INTERN I ACCESSORIS PER A EQUIPS PROGRAV 2.0, M.BLUE, GAV 2.0 O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
2	EQUIPS DE DREANTGE NEUROLÒGIC INTERN / EXTERN I ACCESSORIS PER A EQUIPS STRATA O EQUIVALENT	TANCAT - Obligatori
3	EQUIPS DE DREANTGE NEUROLÒGIC INTERN / EXTERN I ACCESSORIS PER A EQUIPS POLARIS, HAKIM, CERTAS, INTEGRA, SPTZLER O EQUIVALENT	TANCAT - Obligatori
4	EQUIPS DE DREANTGE NEUROLÒGIC EXTERN I ACCESSORIS PER A EQUIPS VENTREX, VENTREX COMPLETE O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
5	ESTIMULACIÓ CEREBRAL COMPATIBLE AMB GENERADORS AMB CONTROL DE CORRENT INDEPENDENT A ALLIBERAR A CADA UN DELS 16 POLS D'ESTIMULACIÓ O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
6	ESTIMULACIÓ CEREBRAL COMPATIBLE AMB GENERADORS COMPATIBLES AMB RESONÀNCIA MAGNÈTICA DE COS SENSER I PREVIA PROGRAMACIÓ O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
7	ESTIMULACIÓ CEREBRAL COMPATIBLE AMB GENERADORS ESTIMILACUÓ DIRECCIONAL O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
8	ESTIMULACIÓ MEDULAR COMPATIBLE AMB GENERADORS AMB CONTROL DE CORRENT INDEPENDENT A ALLIBERAR A CADA UN DELS POLS D'ESTIMULACIÓ O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
9	ESTIMULACIÓ MEDULAR COMPATIBLE AMB GENERADORS PER A DOLOR CRÒNIC REFLECTARI DE TRONC I EXTREMITATS FINS 16 POLS O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
10	ESTIMULACIÓ MEDULAR COMPATIBLE AMB GENERADORS I ELECTRÒDES COMPATIBLES AMB RESONÀNCIA MAGNÈTICA DE COS SENCER O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
11	ESTIMULACIÓ MEDULAR COMPATIBLE AMB GENERADORS DE CORRENT CONSTANT O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
12	ESTIMULACIÓ COMPATIBLE AMB GENERADORS NO IMPLANTABLE PER DOLOR NEUROPÀTIC PERIFÈRIC CRÒNIC COMPATIBLES AMB RESONÀNCIA MAGNÈTICA O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
13	ESTIMULACIÓ MEDULAR PERIFÈRICA COMPATIBLE AMB GENERADORS D'IMPULSOS TETRAPOLARS O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
14	ESTIMULACIÓ COMPATIBLE AMB GENERADORS PER AL TRACTAMENT DE TRASTORNS DEL SÓL PÈLVIC I GÀSTRICS O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
15	ESTIMULACIÓ GANCLI D'ARRELL DORSAL COMPATIBLE AMB GENERADORS DE CORRENT CONSTANT O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
16	ESTIMULACIÓ NERVI VAGUE COMPATIBLE AMB GENERADORS DE DESCÀRREGA EL·LÈCTRICA PROGRAMABLE AMB CONTROL D'INTENSITAT I TEMPS O EQUIVALENTS	TANCAT - Obligatori
17	SISTEMA DE CIRURGIA SEEG INVASIVA COMPATIBLE AMB ALCIS O EQUIVALENT	TANCAT - Obligatori
18	SISTEMA DE REGISTRE ACTIVITAT CEREBRAL PREVI A IMPLANT COMPATIBLE AMB SISTEMA INOMED O EQUIVALENT	TANCAT - Obligatori
19	IMPLANTS BIOLÒGICS PER A LA DURAMÀTER PER A SUTURAR	OBERT - No obligatori
20	IMPLANTS BIOLÒGICS PER A LA DURAMÀTER PER A POSICIONAR	OBERT - No obligatori
21	CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS RAUMEDIC O EQUIVALNET	TANCAT - Obligatori
22	CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS LICOX O EQUIVALNET	TANCAT - Obligatori
23	CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS EXPRESS O EQUIVALNET	TANCAT - Obligatori
24	CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS CERELINK O EQUIVALENT	TANCAT - Obligatori
25	CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS LIQUOGUARD O EQUIVALNET	TANCAT - Obligatori
26	ALTRES IMPLANTS, ACCESSORIS I COMPLEMENTES NEUROLÒGICS	OBERT - No obligatori
27	NEUROMODULACIÓ QUÍMICA	TANCAT - Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 20000017

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I altament purificat. Mida 5,0 x 6,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Lyoplant o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 20000018

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I altament purificat. Mida 6,0 x 14,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Lyoplant o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 20000019

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 20000562

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 20000637

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge intern sense tròcar i estilet, longitud 23cm +/-2cm. Diàmetre intern de 1,3 mm i extern 2,5mm.ext rem distal 1,6c amb 4 files de 8 forats/fila. marques C/5cm des de extrem proximal. Clip amb angle recte. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 20000651

Descripció llarga:

Connector recte de titani, connexió tipus luer, diàmetre 1,9mm a connector catèter, DE 2,5mm; DI 1,2mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 20000666

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern no programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó, inclou vàlvula de pressió media de 70 mm de H2O +/- 10mm. Reservori en línia. Catèter ventricular 14 cm i distal 120 cm, preconnectat. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 20000667

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern no programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó, inclou vàlvula de pressió baixa de 40 mm de H2O +/- 10mm. Reservori en línia. Catèter ventricular 14 cm i distal 120 cm, preconnectat. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 20000678

Descripció llarga:

Reservori drenatge intern LCR amb sortida lateral, acoblable a trèpan 14mm. Consta: reservori silicona, catèter ventricular de bari, connector recte de plàstic. Mida 14mm, estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 20000682

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern no programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó, inclou vàlvula de pressió alta de 130 mm de H2O +/- 10mm. Reservori en línea. Catèter ventricular 14 cm i distal 120 cm, preconnectat. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 20000685

Descripció llarga:

Accessori drenatge intern LCR sensible a pressió hidrostàtica, dispositiu anti - sifó per a vàlvula de drenatge intern LCR longitud 9mm, amplada 3 ,9mm, DI 1,2mm, DE 2,2mm, estèril. D'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 20000693

Descripció llarga:

Catèter peritoneal per a drenatge intern LCR per hidrocefàlia, de sulfat de bari, elastòmer de silicona, radioopac, transparent: 90 cm+/-2cm de longitud; DI 1,3mm - DE 2,5mm; 12 obertures tipus fenedura a extrem distal. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 20000702

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern LCR programable, sense sistema antisifó, compost per:vàlvula plana, 5posicions: 30/200mm H2O.Reservorio en línea. Cateter ventricular 23cm i distal 110cm, preconnectat. Tipus Polaris o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 20000704

Descripció llarga:

Bomba infusió implantable-programable titani/silicona, gruix 26mm-pes 175/215gr-volum 121ml, reservori intern 40ml, volum residual 1 ,4ml, volum fàbrica 37,5ml, bomba parada 0,03ml/dia, mínim 0,048ml/dia, màxim 24ml/dia, mínim manteniment 0,006ml/dia.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 20000761

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge intern LCR de silicona impregnat en bari: tipus angle recte de 5cmx4cm de llargària; DI 1,3mm-DE 2,5mm; extrem distal 1,6cm amb 4 files de 8 forats/fila i estilet d'acer inox. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 20000763

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge intern sense tròcar i estilet, longitud 23cm +/-2cm. Diàmetre intern de 1,2 mm i extern 2,1mm.ext rem distal 1,6c amb 4 files de 8 forats/fila. marques c/5cm des de extrem proximal. Clip amb angle recte. Estèril.

SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	170	MATERIAL:	20001527
Descripció llarga:					
Equip drenatge intern LCR programable, amb sistema anti-sifó; vàlvula(18 rangs de pressió, de 30mm H2O a 200mm H2O i reservori en línia. Equip format per una vàlvula, connectors i adaptador cebador. Tipus Hakim o equiv. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	180	MATERIAL:	20001529
Descripció llarga:					
Equip drenatge intern LCR no programable, sense sistema anti-sifó, compost per: vàlvula cilíndrica amb avantcambra i reservori. Pressió alta 100mm de H2O +/- 10mm. Cat distal 120cm, adaptador/cebador i accessoris. Tipus Hakim o equiv. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	190	MATERIAL:	20019821
Descripció llarga:					
Equip drenatge intern LCR no programable, sense sistema anti-sifó, compost per: vàlvula cilíndrica amb avantcambra i reservori. Pressió 40mm de H2O +/- 10mm. Cat distal 120cm, adaptador/cebador i accessoris. Tipus Hakim o equiv. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	200	MATERIAL:	20019822
Descripció llarga:					
Equip drenatge intern LCR programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó format per vàlvula de 18 rangs de 30mm H2O a 200mm H2O, cilíndrica amb avant-càmera, catèter ventricular 14cm, distal 120cm i accessoris. Tipus Hakim o equiv. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	210	MATERIAL:	20019840
Descripció llarga:					
Equip drenatge intern LCR no programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó, compost per: vàlvula cilíndrica amb avantcambra i reservori. Pressió alta , de 10mm de H2O +/- 2mm. Catèter distal 120cm, adaptador/cebador i accessoris. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	220	MATERIAL:	20020160
Descripció llarga:					
Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramater, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I. Mida 1,5 x 2,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	230	MATERIAL:	20020161
Descripció llarga:					
Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramater, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.					
SOL.COMANDA:	1101434775	POSICIÓ:	240	MATERIAL:	20022684
Descripció llarga:					
Connector en Y per a vàlvula d'hidrocefàlia, Ø extern 1,9mm, Ø intern 1mm, acer inoxidable. Accesoris per a cirurgia de recanvi de sistema valvular de derivació de líquid cefaloraquídi, ventricle-peritoneal o ventricle-atrial.					

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 20022880

Descripció llarga:

Connector recte de material plàstic, ranurat, Øinterior 1,0mm / Øexterior 1,9mm, longitud 17mm ±2mm, amb extrems bisellats, radioopa c, estèril, un sol ús, compatible amb sistema de vàlvules hidrocefàlia

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 20023124

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern LCR no programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó, nadó, compost per: minivàlvula amb reservori 2mm; pressió mitja, catèter peritoneal extrem obert ; tunelitzador; guia i connector de polipropilè. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 20023133

Descripció llarga:

Implant col.lagen biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de teixit epitelial d'origen boví, compost 99% de col·là gen pur no desnaturalitzat. Totalment biocompatible, mida 10x12,5cm: doble envoltori. Lyoplant Onlay o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 20024191

Descripció llarga:

Bomba d'infusió implantable i multipogramable de titani i silicoma. Gruix 19,5mm,pes185gr,reservori intern 20ml,portal directe d'acc és al catèter 0 ,14ml, freqüència d'infusió màxima 24ml/dia i mínima 0,048ml

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 20025851

Descripció llarga:

Cable connexió de l'extrem distal elèctrode a l'extrem proximal neuroestimulador, llargària 60cm, per tractar el dolor amb estimulac ió medul·lar elèctrica. Compatible amb generadors RESTORE i RESTORE ADVANCED o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 20026645

Descripció llarga:

Sistema antigravitatori/assistent de derivació de titani de 5,75x25,4 que s'obrirà quan la pressió arribi a 35cm d'aigua en bipedest ació. Sistema per a afeigir a vàlvules d'hidrocefàlia ja implantades: Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 20027222

Descripció llarga:

Equip drenatge intern, lumbo-peritoneal, sense sistema antisifó, catèter mida 84cm amb punta oberta peritoneal, agulla touhy 14Gi ag ulla 20G pel cebat. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 20028360

Descripció llarga:

Generador per a electroestimulació d'arrels sacres no recarregable límits d'amplitud 0,0-8,5 V,frecuència 2,1-130impuls/segon, multi polar, pes 22 gr. Mida: 44x51x7,7mm, carcassa de titani. Interstim II o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 20028602

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I. Mida 12,0 x 16,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 20030389

Descripció llarga:

Extensió per a elèctrode octopolar long 40cm, Ø2,8mm. Extrem distal(elèctrode): con/octopolar, D.I. 1,3mm, D.E. 4,7mm. Extrem proxim al (neuroestimulador): con/octopolar en línia, diàmetre 1,3mm. Compatible amb generadors ADVANCE i INTELLIS o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 20036831

Descripció llarga:

Generador/neuroestimulador d'impulsos per estimulació cerebral profunda a traves de 1-2electrodes, multiprogramable,no recarregable, de doble canal, compatible amb ressonància magnètica de cos sencer de 1,5T. ACTIVA PC 37601

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 20037122

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fib res de col·làgen 100%. Mida 2,5 x 2,5 cm. Duragen ID o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 20037215

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fib res de col·làgen 100%. Mida 5 x 5 cm. Duragen ID o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 20037216

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fib res de col·làgen Tipus I altament purificada. Mida: 7,5 x 7,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 20051467

Descripció llarga:

Elèctrode del generador d'impulsos per a estimulació nervi vague. Dispositiu de transmissió d' impulsos elèctrics,desde el generador d'estimulació cerebral al nervi vague.Compatible amb generador M102 i M302 i equivalents.Tractament Depressions i epilèps

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 20052804

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina c ompacta de col·làgen. Mida: 6 x 8 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 20052805

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina c ompacta de col·làgen. Mida: 8 x 14 cm., gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 20052806

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina c ompacta de col·làgen. Mida: 10 x 16 cm., gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 20052848

Descripció llarga:

Catèter distal/auricular impregmat de bari de 48cm amb 2segments,per a vàlvula de derivació ventriculo-atrial,pel drenatge intern de LCR a l'uricula,implantable,Mides:segment gros:1,2/2,5mm x 24cm,segment petit: 8/1,3mm x 24cm i 48cm llarg total.Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 20054602

Descripció llarga:

Catèter peritoneal per a drenatge intern LCR, F7, translúcid: 91 cm de longitud; DI 1,1 mm - DE 2,3 mm; radioopac. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 20054603

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge intern LCR: longitud 14cm+/-2cm; DI 1,4 mm - DE 2,7 mm; connector i guia d'angle recte.Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 20057560

Descripció llarga:

Neuroestimulador implantable recarregable per estimulació cerebral profunda, conn octopolar en línia i distància pols 2,8mm. Inclou: neuroestimulador, clau dinamomètrica, compatible amb ressonància magnètica de cos sencer 1,5T. Activa RC o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 20059726

Descripció llarga:

Electrode percutani de 8 contactes, de 50 cm. Longitud de contacte de 3mm i separació entre contactes de 1 mm. Ref: M365SC2218500. E stèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 20059727

Descripció llarga:

Extensió de 8 contactes, per a generador recarregable. Longitud de 35 cm. Compatible amb generador Precision o equivalent. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 20064129

Descripció llarga:

Reservori ventricular de drenatge intern de 12mm amb catèter ventricular petit (DI 1.2 mm, DO 2.1 mm) de longitud 23cm+/-2cm. Estèri l

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 20065740

Descripció llarga:

Generador d'impulsos implantable d'un sòl canal, per a tractament del dolor cronic intratable del tronc, extremitats, malaltia vascu lar
periferica.Comaptible amb extensions 7489 i equivalents

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 20065891

Descripció llarga:

Electrode implantable, tetrapolar,d'iridi-platí,amb sistema d'autoanclatge per a estimulació del nervi sacre,Ø1,27mm, llargària:28cm, longitud del
born:3mm. Compatible amb INTERSTIM II.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 20067908

Descripció llarga:

Cable apantallat per connectar elèctrodes de microregistre, 5 canals, compatible amb sistema INOMED o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 20067909

Descripció llarga:

Tub/cànula d'inserció d'acer inox per a microelèctrodes amb estilet.Mides:Ø ext 1,65 mm i Ø int 1,0 mm.Per a esimulació cerebral pro
fona. Compatible amb el sistema INOMED de microrregistre o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 20067911

Descripció llarga:

Electrode microregistre 0,6mm amb topall de profunditat, registre bipolar, estimulació monopolar, longitud 300mm. Compatible amb sis tema INOMED o
equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 20069203

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge intern de LCR pel tractament d'hidrocefàlia, de silicona cobert de bari. Inclou: Catèter de longi tud
35cm+/-2cm; DI 1,9mm - DE 3,3mm; estilet acer inox; catèter connectors angulats. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 20069830

Descripció llarga:

Valvula de drenatge intern de LCR programable, no gravitacional, sense sistema antisifó, compost per: vàlvula plana, de policarbona t cobert
silicona, sense reservori, amb 5 posicions: rang30/200mm H2O.Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 20069831

Descripció llarga:

Vàlvula de drenatge intern de LCR programable, no gravitacional, sense sistema antisifó, compost per: vàlvula plana, de policarbona t cobert silicona, amb reservori pla, amb 5 posicions: 30/200mm H2O i reservori. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 20073500

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR no programable, sense sistema anti-sifó, inclou vàlvula cilíndrica amb avantcambra i reservori de pressió media-alta de 100 mm de H2O +/- 10mm. Cat ventricular 14 cm i distal 120 cm, preconnectat. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 20074327

Descripció llarga:

Cable connexió per proves multipolar a múltiples elèctrodes d'estimulació medul·lar (16 pols) possibil config (2x8,4x4,1x8 + 2x4) t apa transparent . Compatible amb tots els electrodos i generadors de proba.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 20074457

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·l àgen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 20074471

Descripció llarga:

Catèter peritoneal per a drenatge intern LCR, Øintern 1mm, Øextern 2,2mm, llargària 120 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 20079948

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 5 contactess de plati-ridi, diamtre distal 0,8mm, proximal 1,5 llarga ria util 16mm, compatible amb ALCIS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 20079949

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 15 contactes de plati-ridi, diametre distal 0,8mm, proximal 1,5 llarg aria util 51mm, log mín.implant. 61mm. Compatible amb ALCIS 2069 EPC o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 20082298

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 8 contactess de plati-ridi, diamtre distal 0,8mm, proximal 1,5 llarga ria util 26,5mm, compatible amb ALCIS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 20082299

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 10 contactess de plati-ridi, diambtre distal 0,8mm, proximal 1,5 llarg aria util 33,5mm, compatible amb ALCIS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 20090257

Descripció llarga:

Equip d'accessoris per tunelització de sistemes de neuroestimulació medular. Revestiment de poliuretà, tunelitzador d'acer inox, obt urador de polipropilè i punta de polipopilè amb sulfat de bari.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 20097801

Descripció llarga:

Sistema de tencament de trepà i fixació de l'elèctrode. Compatible amb trepà de 14mm de diàmetre, de perfil baix. Amb anell extern d e fixació amb 4 punts independents de sujecció de l'elèctrode.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 20099551

Descripció llarga:

Extensió electrode de 55 cm. Diàmetre 1,3mm. Aislament de poliuretà i silicona. Per connexió d'electrode compatible amb Generador d'i mpulsos VERCISE GENUS P16 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 20099552

Descripció llarga:

Electrode direccional per estimulació cerebral profunda. Longitud 45cm, diàmetre 1,3mm, 8 pols, superfície 1,5mm. Compatible amb Gen erador d'impulsos VERCISE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 20100477

Descripció llarga:

Electrode percutani de 16 contactes, de 50 cm. Longitud de contacte de 3mm i separació entre contactes de 1 mm. Compatible amb siste ma Precision o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 20104607

Descripció llarga:

Vàlvula de drenatge intern de LCR programable, no gravitacional, sense sistema antisifó, compost per: vàlvula plana, de policarbona t cobert silicona, amb 5 posicions: 10/140mm H2O i reservori. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 20104614

Descripció llarga:

Catèter peritoneal per a drenatge intern LCR pel tractament d'hidrocefàlia, de sulfat de bari, 90 cm+/-5cm de longitud; DI 1,3mm - D E 2,5mm.; 4 obertures tipus fenedura a extrem distal; 3 marques cada 10cm des de extrem distal. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 20104618

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR no programable, sense sistema anti-sifó, compost per: vàlvula cilíndrica amb avantcambra i reservori. Pres sió 130mm de H2 +/- 10mm. Cat distal 120cm, adaptador/cebador i accessoris. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 20104690

Descripció llarga:

Catèter peritoneal per a drenatge intern LCR pel tractament d'hidrocefàlia, de sulfat de bari, 120 cm+/-5cm de longitud; DI 1,3mm - DE 2,5mm.; 4 obertures tipus fenedura a extrem distal; 3 marques cada 10cm desde extrem distal. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 20106092

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó format per vàlvula de 18 rangs de 30mm H2O a 200mm H2O, catèter ventricular 14cm, distal 120cm i accessoris. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 20107900

Descripció llarga:

Neuroestimulador extern programable fins a 3 programes, de 1 a 4 pols, Amp:0-12,5mA; freqüència 3-130Hz, Pes 53,9g, mida 58x43mm. Co mpatible generador Interstim II o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 20108313

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó format per vàlvula amb reservori en línea, 8 rangs de pressió, 2 catèters integrats (ventricular preconnectado+distal). Estèril. Tipus Certas Plus o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 20111461

Descripció llarga:

Generador d'impulsos per a estimulació cerebral mitjançant l'estimulació del nervi vague. Implantació subcutània, programable, per a l tractament de epilèpsia en pacients farmacoresistents. SENTIVA 1000 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 20113186

Descripció llarga:

Sistema de fixació 4x0,61cm de titani amb recobriment de silicona, guia interior de poliuretà termoplàstic, un sol ús. Click X Ancho r o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 20113387

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR programable, no gravitacional, amb sistema anti-sifó format per vàlvula de 18 rangs de 30mm H2O a 200mm H2 O, catèter ventricular 14cm, distal 120cm preconnectado i accessoris. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 20113609

Descripció llarga:

Vàlvula de drenatge intern LCR, programable amb sistema antisifó, amb reservori, mida 35mm x 13mm, gruix 4-7mm. 5 posicions de progr amació. Tipus STRATA o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 20113610

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern LCR programable, no gravitacional, sense sistema antisifó, compost per: vàlvula lumbar programable, catèter r lumbar 80cm i catèter peritoneal integrat 120cm. Tipus STRATA NSC LP o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 20113611

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge intern LCR, impregnat de Rifampicinai Clidamicina, amb estilet d'acer inox, clip angle recte, lon gitud 23cm +/-2cm, DI 1,3mm DE 2,5mm. No requereix cadena de fred. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 20114995

Descripció llarga:

Elèctrode octopolar percutani en línea, diàmetre 1,3mm, distància entre els pols 1mm, longitud 70cm.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 20115804

Descripció llarga:

Generador implantable no-recarregable. Suport 1-2 electrodes de 16contactes, 16 programes amb 4 àrees per programa. Generador amb co ntrolde corrent independent. Amplada de pols fins a 1000 microsegons. Freqüència fins a 1200Hz.Connexió Bluetooth, estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 20115805

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 18 contactes de plati-ridi, diàmetre distal 0,8mm, proximal 1,5 llarg aria util 70mm, log min.implant. 80mm. Compatible amb ALCIS 2069 EPC o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 20115806

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 12 contactes de plati-Iridi, diàmetre distal 0,8mm, proximal 1,5, lla rgària útil 40,5mm, compatible amb ALCIS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 20116613

Descripció llarga:

Elèctrode octopolar en línia Ø1,3mmx60cm;extrem dist:forma pol cilíndric 3 ,0mm,espai pols 4mm i espai elèctr 6,0mm;extrem prox:long contacte 1 ,5mm,long mànec fiador 29,0mm;resistè elèct 16¿/cm.Comp a/neuroestimuladors SureScan MRI,Advanced i Itrel 4 o eq

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 20116614

Descripció llarga:

Neuroestimulador/generador extern inhalàmbric de 16 pols per programa, 3grups programes en 4 programes màxim per grup, funcionamnet a piles no recargables. Freqüència de 40 a 1200Hz. Mida 79x74x20mm. WENS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 20116757

Descripció llarga:

Electrode tetrapolar percutani per generador estimulació ganglis arrel dorsal, diàmetre 1mm, longitud 50cm, longitud de contacte 1,2 5mm. Compatible amb generador Proclaim DRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 20116758

Descripció llarga:

Cable connexió electrode-generador estimulació ganglis arrel dorsal, extensió derivació 50cm amb clau dinamomètrica, compatible amb Proclaim DRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 20117179

Descripció llarga:

Elèctrode tetrapolar percutani per generador estimulació ganglis arrel dorsal, diàmetre 1mm, longitud 90cm, longitud de contacte 1,2 5mm. Compatible amb generador Proclaim DRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 20117749

Descripció llarga:

Elèctrode percutani estimulació medul.lar de 8 contactes, espai entre de contactes de 5mm, longitud 70cm, compatible a Nevro o equiv alent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 20117750

Descripció llarga:

Cable extensió impantable, 35cm de longitud compatible amb Nevro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 20117751

Descripció llarga:

Connector de 8 contactes, diàmetre 1,3mm i longitud 15cm +/-0,5cm, compatible amb neuroestimulador Vercise o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 20117969

Descripció llarga:

Generador implantable estimul.lació medul.lar, Estimulació tònica i ràfagas, 16 pols.Tecnologia Bluetooth, Software actualizable Bat eria 5 ,3Ah. Mida: 55x49,5x13,4mm. ProclaimTM XR5 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 20117970

Descripció llarga:

Generador implantable estimul.lació medul.lar, Estimulació tònica i ràfagas, 16 pols, Bluetooth, Software actualizable Bateria 7,5Ah . Mida: 66,8x50,2x13,5mm. ProclaimTM XR7 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 20117972

Descripció llarga:

Generador bilateral implantable estimul.lació cerebral profunda, 8 pols per canal, estimul.lació corrent constant, no recarregable. V olum: 38,6 cm³. Mida 66,8x50,2x13,5mm. Bateria de 7,5 Ah. Conn/ Bluetooth. INFINITY 7 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 20117974

Descripció llarga:

Generador implantable estimul.lació gangli arrel dorsal, 16 pols (4 per canal), Fx: 4-80Hz, Amplitud: 0-6mA Amp Impols: 40-1000µs Mida 61x49 ,5x13,4mm. Conn/ Bluetooth. Proclaim TM DRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 20117976

Descripció llarga:

Elèctrode quirúrgic per estimul.lació medul.lar penta, 16 pols (5 columnes de 4 contactes), contactes: 4mm, distancia entre pols 3m m, longitud 60cm. Lamitrode Penta o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 20117978

Descripció llarga:

Elèctrode percutani octopolar per neuroestimulació 8 pols en línia independents, camp actiu: 52mm contactes: 3mm, distancia entre pols 4mm, diàmetre: 1,4mm,longitud 30cm. Octrode o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 20117979

Descripció llarga:

Elèctrode percutani octopolar per neuroestimulació 8 pols en línia independents, camp actiu: 52mm, contactes: 3mm, distancia entre pols 4mm, diàmetre: 1,37mm, longitud 60cm. Compatible amb RM. Octrode o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 20117981

Descripció llarga:

Elèctrode octopolar direccional per estimulació cerebral profunda, 8pols, contactes: 1,5mm, distància entre pols 0,5mm, longitud 40cm . Diametre 1 ,29mm compatible amb generadors Infinity o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 20117982

Descripció llarga:

Extensió d'adaptador de 8 pols individuals, longitud 30cm, compatible amb generadors d'estimul.lació cerebral profunda Infinity o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 20117984

Descripció llarga:

Extensió octopolar per elèctrodes de neuroestimulació medul.lar, 8 pols en línia, longitud 30cm. Diàmetre: 1,37mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 20117985

Descripció llarga:

Extensió octopolar per elèctrodes de neuroestimulació medul.lar, 8 pols en línia, longitud 60cm. Diàmetre: 1,37mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 20117987

Descripció llarga:

Cable connexió elàstica octopolar per neuroestimulador d'estimul.lació cerebral profunda, 8pols, contactes: Extensible fins 10% longitud. Longitud: 90cm, amb tunelitzador no acodable, compatible amb generadors Infinity o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 20117990

Descripció llarga:

Anclatge per elèctrodes de neuroestimulació amb bloqueig mecànic, amplada 0,5cm, longitud 4,2cm, material: silicona amb sulfat de bari, PEEK i acer inoxidable, compatible amb els elèctrodes ANS. Swift-Lock o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 20117992

Descripció llarga:

Sistema de tancament de forats de trepanació per millorar la fixació del electrode de l'estimulació cerebral profunda, adaptable a la curvatura del crani i forats de 14 a 17mm, inclou base, pinça, tapa i accessoris. Guardian o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 20117993

Descripció llarga:

Equip capçal per implant d'electrodes d'estimul.lació medul.lar amb 16 contactes (8 per canal) dos canals/connexions, amb piles tipus botó CR2450

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 20117994

Descripció llarga:

Equip capçal per generador d'impulsos externs per estimulació ganglis arrel dorsal (GRD). Compatible amb elèctrodes i extensions DRG o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 20119108

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR equip vàlvula d'hidrocefàlia, no programable, gravitacional ajustable (sistema anti-sifó), implantable, pe diàtric. Compost per: vàlvula gravitacional i unitat de pressió diferencial 0 cm/H2O. M.Blue o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 20119255

Descripció llarga:

Vàlvula d'hidrocefàlia, no programable, gravitacional ajustable (sistema anti-sifó), implantable. M.Blue o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 20119442

Descripció llarga:

Electrode 8pols en línia per estimulació cerebral profunda. Longitud 45cm, diàmetre 1,3mm, superfície 1,5mm. Compatible amb Generado r d'impulsos VERCISE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 20119619

Descripció llarga:

Sistema antisifò implantable de forma independent o compatible amb vàlvules programables Codman i Hakim, SiphonGuard o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 20129581

Descripció llarga:

Extensió per a elèctrode octopolar extrem proximal Ø1.3mm longitud 60cm, espai entre contactes 2,8mm.Extrem distal (elèctrode): cone ctor tetrapolar en línia, D.I. 1,5mm, D.E.3,8mm.Extrem proximal (neuroestimulador),sistema DBS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 20129750

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/20cmH2O, compost: vàlvula cilíndric a titani 4,2x13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 25cm; estilet i deflector 10mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 20129752

Descripció llarga:

Sistema antigravitatori/assistent de derivació de titani 4,2x12 que s'obrirà quan la pressió arribi a 25cm d'aigua en bipedestació.S istema per a afeigir a vàlvules d'hidrocefàlia ja implantades.Per drenatge int LCR. SHUNTASSISTANT 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 20129753

Descripció llarga:

Sistema antigravitatori/assistent de derivació de titani 4,2x12 que s'obrirà quan la pressió arribi a 30cm d'aigua en bipedestació.S istema per a afeigir a vàlvules d'hidrocefàlia ja implantades.Per drenatge int LCR. SHUNTASSISTANT 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 20129754

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/30cmH2O, compost: vàlvula cilíndric a titani 4,2x13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 25cm; estilet i deflector 16mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 20129755

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/35cmH2O, compost: vàlvula cilíndric a titani 4,2x13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 25cm; estilet i deflector 16mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 20129757

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 10/30cmH2O, compost: vàlvula cilíndri ca titani 4,2x13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 18cm; estilet i deflector 16mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 20129758

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 10/25cmH2O, compost: vàlvula cilíndri ca titani 4,2x13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 18cm; estilet i deflector 16mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 20129760

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/25cmH2O, Eq:vàlvula cilíndrica 4,2x 13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 25cm; estilet, deflector 10mm i reservori 13mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 20129761

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern LCR(equip vàlvula d'hidrocefàlia)amb valvula programable titani 0/20cmH2O+unitat gravitacional de20cmH2O. S ist.antisifó, resev.ped.L14mm, per implantació occipital. Tipus PROGAV 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 20129763

Descripció llarga:

Sistema antigravitatori/assistent de derivació de titani 4,2x12 que s'obrirà quan la pressió arribi a 20cm d'aigua en bipedestació.S istema per a afeigir a vàlvules d'hidrocefàlia ja implantades.Per drenatge int LCR. SHUNTASSISTANT 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 20129764

Descripció llarga:

Sistema antigravitatori/assistent de derivació de titani 4,2x12 que s'obrirà quan la pressió arribi a 10cm d'aigua en bipedestació.S istema per a afeigir a vàlvules d'hidrocefàlia ja implantades.Per drenatge int LCR. SHUNTASSISTANT 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 20129804

Descripció llarga:

Equip de cargol de fixació dues vies per a sist de monitorització de la pressió d'oxigen tissular en el cervell; broca a/ topall de seguretat 5 ,3mm. Clau allen. Punta perforadora Dura. Cos del cargol a/ales.Compat amb Licox CC1.SB o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 20129805

Descripció llarga:

Sensor per a control de la pressió O2 tissular, àrea de medició 18mm², Ø 0,8mm (en la zona de medició), Ø 1,3mm (a la resta del sensor), llargària 150 mm, a/agulla d'inserció o amb cargols cranials. Compatible amb monitor Licox o equivalent. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 20129806

Descripció llarga:

Sensor/sonda combinada per a mesuratge SpO2 i temperatura 15cm +/-2cm, compatible amb monitor LICOX o equivalent. REF: CC1P1

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 20130002

Descripció llarga:

Equip electrode Interstim MRI no recargable de 28 cm. longitud, compatibles amb RM SureScan (4.32mm). Compatible amb Generadors Interstim II i Interstim X o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 20130003

Descripció llarga:

Equip electrode Interstim MRI no recargable de 33 cm. longitud, compatibles amb RM SureScan (4.32mm). Ref.978B133

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 20130004

Descripció llarga:

Equip electrode Interstim MRI no recargable de 41 cm. longitud, compatibles amb RM SureScan (4.32mm). Ref.978B141

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 20130005

Descripció llarga:

Extensió percutànea per electrode de 2.16, sistema neuromodulació sacre. Compatible amb InterStim MICRO o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 20130006

Descripció llarga:

Extensió percutànea per electrode de 4.32, sistema neuromodulació sacre. Compatible amb InterStim II i InterStim X o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 20130007

Descripció llarga:

Equip electrode d'estimulació bàsica o prova per teràpia neuroestimulació sacre. Format per electrode unipolar de diàmetre 0,86mm x 30cm, cable d'estimulació prova, 2 agulles de 8,8cm i una agulla de 12,6cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 20130245

Descripció llarga:

Neuroestimulador/generador de 2 a 16 pols, implantable, programable, recargable i compatible amb resonància magnètica. Per tractament de dolor crònic i estimulació PNS. INTELLIS o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 20130254

Descripció llarga:

Generador implantable i recarregable, suport de 2 electrodes de 8 contactes ,4programes indep amb 4 àrees per programa.Generador amb c ontrol de corrent indep.Amplada pols fins 450 microsegons.Freqüència de fins a 255Hz.VERCISE GENUS R16 o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 20130255

Descripció llarga:

Extensió electrode de 95cm. Diàmetre 1,3mm. Aislament de poliuretà i silicona, amb 8 pols de contacte. Per connexió d'electrode compa tible amb Generador d'impulsos VERCISE GENUS R16 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 20131385

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/30cmH2O, Eq:vàlvula cilíndrica 4,2x 13,4mm, cat distal 120cm; cat ventricular 25cm; estilet, deflector 10mm i reservori 13mm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 20131776

Descripció llarga:

Generador implantable no recarregable, suport de 2 electrodes de 8 contactes,4programes indep amb 4 àrees per programa.Generador amb control de corrent indep.Amplada pols fins 450 microsegons.Freqüència de fins a 255Hz.VERCISE GENUS P16 o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 20131801

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern LCR (equip vàlvula d´hidrocefàlia) amb valvulaprogramable titani perfil baix 0/20cmH2O+unitat gravitacional de 20cmH2O. Sist.antisifó, resev.ped.L14mm. Tipus PROGAV 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 20131802

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern LCR (equip vàlvula d´hidrocefàlia) amb valvulaprogramable titani perfil baix 0/20cmH2O+unitat gravitacional de 25cmH2O. Sist.antisifó, resev.ped.L14mm. Tipus PROGAV 2.0. o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 20133435

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fib res de col·làgen 100%. Mida 7,5 x 7,5 cm. Duragen ID o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 20133612

Descripció llarga:

Neuroestimulador/generador d'impulsos per a estimulacio nervi perifèric, implantable, programable, indicat per neuropaties perifèriq ues, centrals o espinals. Light Pulse 100, Ref: NSLP100L

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 20133613

Descripció llarga:

Cable adaptador per generador extern, compatible amb Light Pulse 100. Ref: TL300ADA

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 20133614

Descripció llarga:

Elèctrode implantable tetrapolar, longitud 30 cm 4 mm inter elèctrode FIXLINE 30-4, compatible amb LightPulse100. Ref: ECNFX304

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 20136279

Descripció llarga:

Elèctrode percutani estimulació medul.lar de 8 contactes, espai entre de contactes de 5mm, longitud 50cm, compatible a Nevro o equiv alent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 20136672

Descripció llarga:

Accessori drenatge intern LCR, per compensar la gravetat, montat per combatre l' efecte sífó de la pressió hidrostàtica quan el paci ent es posa de peu fins a 200mmH2O en posició vertical, estèril. D'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 20136884

Descripció llarga:

Generador d'impulsos implantable, fins a 16 electrodes, amplitud 0-15mA. Frecuencia de 2 a 100Hz. Mides 58x47,5x11,5mm per a el trac tament del dolor crònic del tronc iles extremitats. Compatible RMN 1,5T i 3T. Nevro Senzall o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 20137387

Descripció llarga:

Catèter peritoneal impregnat amb antibiòtic (Rifampicina i Clidamicina) amb marques numèriques de profunditat, diàmetre intern 1,3mm , diàmetre extern 2,5mm. Llargària 120cm. No requereix cadena de fred. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 20137396

Descripció llarga:

Elèctrode intercerebral per a estimulació cerebral profunda amb 18 contactes de plati-ridi, diametre distal 0,8mm, proximal 1,5 llarg aria util 61,5mm, log mín.implant. 71,5mm. Compatible amb ALCIS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 20137627

Descripció llarga:

Generador d'impuls implantable 16 canals per a neuroestimulació medular, amb font d'energia recarregable, bastidor de titani, capçal d'epoxi, protector de silicona, comandament pacient, mida: 51,3x46x10,7mm (20 ,1cm3), ALPHA 16 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 20137878

Descripció llarga:

Generador per a electroestimulació d'arrels sacres programable límits d'amplitud 0,0-12,5 V, freqüència 3-130 impuls/segon, multipol ar, pes 7 ,3gr, mida: 47x17x5mm, carcassa de titani. Ref: Interstim Micro 97810

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 20139385

Descripció llarga:

Electrode percutani de 16 contactes, de 70 cm. Longitud de contacte de 3mm i separació entre contactes de 1 mm. Compatible amb siste ma Precision o equivalent. Estèril.Ref,M365SC8216700

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 20139516

Descripció llarga:

Adhesiu conductor d'impulsos, mida 11,34 cm2, compatible amb generador Stimrouter o equivalent, Ref: ST2-7001

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 20142630

Descripció llarga:

Generador per a estimulació medul.lar de 8 grups, 32 programes, implantable, de doble canal de 2-16 pols, freqüència de 40 a 130 Hz. VANTA AdaptifStim o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 20142852

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR no programable, no gravitacional, amb sistema anti-sifó, inclou vàlvula de pressió molt baixa de 10 mm de H2O +/- 10mm. Reservoiri en línea. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 20143375

Descripció llarga:

Reservoiri neonatal de silicona de diàmetre 10mm , alçada 4mm, volum de fluid 0,1ml, forat trèpan amb connector de diàmetre intern 1, 2mm i diàmetre extern 2,1mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 20145250

Descripció llarga:

Reservoiri drenatge intern LCR estàndart, esfèric de 1,5cm . Consta: de reservori silicona i catèter ventricular, estèril. OMMAYA o e quivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 20146252

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 10/30cmH2O, Eq:vàlvula cilíndrica 4,2 x13,4mm i catèter distal. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 20148070

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fib res de col·làgen Tipus I altament purificada. Mida: 10 x 12,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 20148112

Descripció llarga:

Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, compost de fibres de col·làgen, vàlid per ambes cares. Mida 5 x 5cm. DURAGEN PLUS DP-1022-I. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 20148520

Descripció llarga:

Cable extensió 50cm longitud, diàmetre 1,2mm, compatible amb generador Lighpulse 100L oequivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 20149323

Descripció llarga:

Cable extensió impantable, 60cm de longitud compatible amb Nevro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 20149704

Descripció llarga:

Neuroestimulador inhalàmbric perifèric no implantable, amb un electrode implantable de 4 pols variable, transmissor extern, antena i carregador USB. Freedom StimQ o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 20150192

Descripció llarga:

Connector 4 pols en línea, diàmetre 1,3mm longitud 55cm. Compatible ambelectrodes quirúrgics del sistema Precision M1. Ref: M365SC9 004550

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 20150642

Descripció llarga:

Electrode tetrapolar de 60cm de longitud, 4 pols de 6mm interespaiats de 12mm, punta radioopaca, per al tractament de cefaleas en ra ïm cròniques. No comp amb resonància magnètica. ANKERSTIM o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 20154181

Descripció llarga:

Generador per a electroestimulació darrels sacres programable límits d'amplitud 0,0-12,5 mA, freqüència 2,1-130 Hz, un electrode tet rapolar, pes 22gr, mida: 44x51x7,7mm, carcassa de titani. Interstim X o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 20154330

Descripció llarga:

Reservori ventricular LCR drenatge intern de 11mm. Diàmetre 6mm, alçada 4 mm, profunditat superficial 0,5mm, volum de fluid 0,10ml. Amb connector recte long. 1,5cm, diàmetre int. 1mm, diàmetre ext. 1,9mm. Amb tap. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 20154538

Descripció llarga:

Elèctrode percutani estimulació medul.lar de 16 contactes, dues files, espai entre files 1mm, espai entre de contactes de 4,25mm, longitud 50cm. Compatible a Nevro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 20155192

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/30cmH2O, Eq:vàlvula cilíndrica i ca tèter distal. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 20155281

Descripció llarga:

Elèctrode quirúrgic pla per estimul.lació medul.lar, 16 pols (2 files de 8 acabalcades), Longitud de la matriu 56mm, distancia entr e pols 1mm ,longitud 79cm. Lamitrode 88 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 20155573

Descripció llarga:

Generador implantable recarregable estimul.lació medular, estimul.lació tonica i ráfaga. Volum 13,79cm³. Pes: 26,4gr Mida: 38x48x9m m. Compatible condicional RM. Eterna o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 20157098

Descripció llarga:

Vàlvula d'hidrocefàlia no programable, gravitacional, implantable 5/20cm H2O; suport lumboperitoneal. Tipus GAV 2.0 LUMBAR. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 20157099

Descripció llarga:

Vàlvula d'hidrocefàlia no programable, gravitacional, implantable 5/25cm H2O; suport lumboperitoneal. Tipus GAV 2.0 LUMBAR. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 20157100

Descripció llarga:

Catèter lumbo-peritoneal per a drenatge intern LCR punta tancada, longitud 80cm +/-2cm; DI 1,85mm - DE 2,20mm; suport i guia. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 20157101

Descripció llarga:

Catèter lumbo-peritoneal per a drenatge intern LCR punta oberta, longitud 80cm +/-2cm; DI 1,85mm - DE 2,20mm; suport i guia. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 20157387

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR (eq vàlvula hidrocefàlia) no programable, gravitacional, implantable 5/15cmH2O, Eq:vàlvula cilíndrica i ca tèter distal 90cm. Tipus GAV 2.0 o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 20158023

Descripció llarga:

Electrode quirúrgic 16 pols per tractament de dolor crònic, longitud 65cm. Amb tres files, espai entre pols 4,5mm compatible amb Spe cify Surescan MRI o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 20158025

Descripció llarga:

Bomba infusió implant i progra titani+silic,gruix 19,6mm,pes 146/166gr ,volum desplaç 88ml,Ø87,5mm,volum 20ml,volum residual 1,4ml,vo lum fàbrica17,5ml,freq inf:parada 0,030ml/dia,mín 0,048ml/dia,màx 24ml/dia,mín mant0,006ml/dia,ref:8667-20.SynchromedIII

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 20158026

Descripció llarga:

Bomba infusió implant i progr titani+silic,gruix 26,1mm,pes 152/192gr ,volum desplaç 118ml,Ø87,5mm,volum 40ml,volum residual 1,4ml,vo lum fàbrica37,5ml,freq inf:parada 0,030ml/dia,mín 0,048ml/dia,màx 24ml/dia,mín mant 0,006ml/dia,ref:8667-40.SynchromedIII

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 20164981

Descripció llarga:

Elèctrode percutani octopolar per neuroestimulació 8 pols en línia independents, camp actiu: 52mm, contactes: 3mm, distancia entre p ols 4mm, diàmetre: 1,37mm, longitud 90cm. Octrode o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 20164984

Descripció llarga:

Generador implantable recarregable estimul.lació cerebral profona, 16 pols (8 per canal), estimul.lació elèctrica contínua cíclica. Volum 13,6cm³. Pes:26,4gr Mida:38x48x9mm. Liberta RC o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 20167090

Descripció llarga:

Neuroestimulador/generador recargable. Trifasic/bifasic, 2 canals i 24 contactes. Amplitud de 0 a 50mA. Programable 10/1500Hz. Ampla da pols de 20/1000microseg. Bateria Ion/litio.MRI1,5T cos complert i 3T en cap i genoll. EVOKE G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 20167091

Descripció llarga:

Elèctrode percutani dodepolar (12 pols) per neuroestimulació de 60cm delongitud, camp actiu, mida pols 3mm i 4mm distancia entre pol s, diàmetre del elèctrode 1,3mm, compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 20167092

Descripció llarga:

Elèctrode percutani dodepolar (12 pols) per neuroestimulació de 90cm delongitud, camp actiu, mida pols 3mm i 4mm distancia entre pol s, diàmetre del elèctrode 1,3mm, compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 20167093

Descripció llarga:

Extensió d'entrada en línia per elèctrode de 12 pols i 1,3mm de diàmetre. Baix perfil. Longitud: 55 cm. Compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 20167094

Descripció llarga:

Cable adaptador per connexió intraoperatòria de 1 a 2 elèctrodes o extensions, compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 20167162

Descripció llarga:

Equip drenatge intern LCR equip vàlvula d'hidrocefàlia, no programable ,gravitacional ajustable (sistema anti-sifó), implantable, ped iàtric. Compost per: vàlvula gravitacional i unitat de pressió diferencial 5 cm/H2O. M.Blue o equiv. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 20167163

Descripció llarga:

Equip de drenatge intern no programable, no gravitacional, sense sistema anti-sifó, inclou vàlvula de pressió alta de 100 mm de H2O +/- 10mm. Reservori en línia. Catèter ventricular 14 cm i distal 120 cm, preconnectat. Tipus Hakim o equiv. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30001535

Descripció llarga:

Equip catèter epidural 6F amb sensor per a monitoratge de pressió intracranial PIC a l'espai epidural amb sensor de fibra òptica, compatible amb equip Raumedic o equivalent, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30002527

Descripció llarga:

Catèter lumbar d'elastòmer de silicona radioopac amb punta tancada i marcadors, diàmetre 5Fr i llargària 80cm +/-5cm, Øintern 0,7mm, Øextern 1,5mm, connector luer-lock, fixador 5Fr saturable, agulla touhy 14G i Guia. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30002530

Descripció llarga:

Equip drenatge ventricular extern, línia de pacient amb connector giratori, càmera graduada de 100ml, tub de sortida amb bossa recol·lectora graduada de 700ml amb filtre hidròfob 0,2 µm i port per sensor PIC amb clau de 3 vies. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30003415

Descripció llarga:

Equip d'implantació catèter subdural 8Fx25cm +/-2cm compost per: broca amb topall ajustable diam. ext. 5mm, clau allen, passador sub cutanil.Comp a/recipient drenatge quirúrg aspiració buit. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30003484

Descripció llarga:

Catèter ventricular, sense bossa, per a drenatge LCR, calibre 9F, llargària 30cm+/-2cm, marques penetració, amb tròcar, guia, connector i pinça, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30007116

Descripció llarga:

Perforador manual de material plàstic, d'un sol ús, per a procediments neurològics, s/broca. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30007802

Descripció llarga:

Bossa per a drenatge extern ventricular cerebral (líquid cefalorraquidi) PVC/vinil, graduada increments 50ml, vàlvula atmosfèrica, c apacitat 700ml, connexió mascle. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30009185

Descripció llarga:

Equip de reompliment dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 22G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenest rada, xeringa 20cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchromed o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30013213

Descripció llarga:

Equip catèter intraventricular 9F, monitoratge pressió intracranial "PIC" amb sensor de fibra òptica d'implantació temporal per mesurar PIC, funció drenatge LCR; 1cargol l'òs i tornavís; 1perforador 6s CH9 i estilet. Comp amb monitor Raumedic o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30013414

Descripció llarga:

Equip revisió d'estimulació d'arrels sacres compost: introductor amb dilatador, tunelitzador, punta de tunelització i tub, placa no estèril, clau, cable per l'estimulació, guia i dos cargols, estèril, un sol ús. Compatible amb INTERSTIM o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30013465

Descripció llarga:

Catèter peritoneal de silicona radioopaca. Mides: 900mm de longitud,1,2 mm de diàmetre intern i 2,5 mm diàmetre extern. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30014223

Descripció llarga:

Equip drenatge extern ventricular sense catèter, amb línia de pacient, càmara graduada 50ml, filtre hidrofòbic, taula per mesurar i controlar la pressió intracraneal, clau tres passos i bossa 700ml. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30019495

Descripció llarga:

Catèter ventricular antimicrobià, sense bossa, per a drenatge LCR, calibre: 10F, llargària 30cm+/-2cm, radioopac, marques penetració , tròcar, estilet, connector, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30027881

Descripció llarga:

Equip catèter 5F intraparenquimatós amb sensor per a la medicació de PIC (-40 a 400mmHg) . Cateter 5Fx55cm+/-2cm i kit de fixació. Comp atible amb monitor MPR2 Raumedic o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30028697

Descripció llarga:

Equip carregador pacient compost per carregador, base de carregador i font d'alimentació, compatible amb carregador Alpha M365SC1216 0.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30029581

Descripció llarga:

Catèter intratec 2 peces, silicona radioopaca, Llarg total 114,3cm: catèter intraes 4Fr, fixació. Catèter bomba 4Fr connex bomba s/suturats, ØI conn cat 0,3m. 1 agulla introd 16Gx11,4cm. Comptble bomba SYNCHROMED II, o equivalent. Catèter intratec ASCENDA.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30031769

Descripció llarga:

Passador cutani rebutjable, 60cm longitud, DI 3,3mm i DE 4,8mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30031800

Descripció llarga:

Passador per a catèter peritoneal drenatge LCR, acer inox flexible, mànec en Tde plàstic. Mida 55cm, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30031954

Descripció llarga:

Passador per a catèter peritoneal drenatge LCR, acer inox flexible, mànec en T de plàstic. Mida: 36cm, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30032657

Descripció llarga:

Equip de drenatge extern LCR, compost per: bossa de 500 ml, línia de pacient d'una sola peça de 200 cm amb vàlvula anti-reflux/cambra de goteig i escala de pressió. Sense làtex. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30033818

Descripció llarga:

Estilet amb topall, d'acer inoxidable, per a implantació d'elèctrodes profunds de registre i coagulació, Øextern 0,8mm, longitud útil mínima 120cm, estèril, un sol ús, compatible amb sistema ALCIS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30033820

Descripció llarga:

Cargol guia per a la implantació d'elèctrodes intercerebrales profunds de registre, titani, diàmetre 25mm, estèril, un sol ús, compatible amb sistema ALCIS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30035294

Descripció llarga:

Catèter lumbar per a drenatge extern LCR, silicona 100%radiopaca, 4,5F, llarg 80cm+/-2cm, multipeforat, marques profunditat, connector, fiador metàl·lic a/recobriment hidrofílic i tap, agulla 14G, guia hidrofílica, lliure làtex. Estèril. 1ús

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30039143

Descripció llarga:

Microsensor per a monitoratge de pressió intercranial (PIC), amb cargol cranial 2mm, per a utilitzar amb broca trepant de 2,7 mm. Estèril, un sol ús. Compatible amb monitors Codman ICP EXPRESS (ICP) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30039961

Descripció llarga:

Catèter ventricular antimicrobià (Rifampicina i Clindamicina), per drenatge extern, radiopac de silicona de DI 1,5mm, llargària 35cm +/-2cm, amb marques profunditat, estilet, tròcar i connector. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30039962

Descripció llarga:

Catèter ventricular antimicrobià (Rifampicina i Clindamicina), per drenatge extern, radiopac de silicona de DI 1,9mm, llargària 35cm +/-2cm, amb marques profunditat, estilet, tròcar i connector. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30039963

Descripció llarga:

Equip de dos catèters antimicrobians per a drenatge intern de LCR de silicona impregnada en antibiòtic (Rifampicina i Clindamicina). Catèter ventricular DE 2,7mm x 14cm +/-2cm i catèter peritoneal DE 2,2mm x 120 +/-5cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30039968

Descripció llarga:

Equip drenatge extern ventricular amb catèter 9F i 35cm+/-5cm longitud, connector luer lock i collaret fixació amb tròcar, càmara gr aduada 120ml+/-20ml i bossa de 700ml amb vàlvula antireflux. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30039970

Descripció llarga:

Equip de drenatge extern LCR sense catèter, amb panel de medició de 33cm(H2O) i mm(Hg); cambra graduada 100ml amb vàlvula anti-reflu x a la línia del pacient; bossa drenatge 700ml i accessoris. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30039972

Descripció llarga:

Equip de drenatge extern LCR, compost per: bossa de 700 ml, línia de pacient d'una sola peça de 100 cm amb vàlvula anti-reflux/cambr a de goteig i escala de pressió. Sense làtex. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30039979

Descripció llarga:

Catèter ventricular antimicrobià (Rifampicina i Clindamicina), radiopac de silicona de DI 1,4mm, DE 2,7mm, llargària 14cm+/-2cm, amb marques profunditat, estilet, tròcar i connector. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30039981

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge de LCR per a neonats de 6F, de poliuretà radioopac amb plata. Inclou: Catèter de longitud 27cm+/-2cm; DI 1,0mm - DE 2,0mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30039982

Descripció llarga:

Catèter ventricular per a drenatge temporal extern de LCR, de poliuretà amb recobriment antibacterià de partícules d'argent iònic. Mides:Øint 1,6mm, Øext 2,8mm (8F), llargària 30cm, amb mandril, tocar, pallona i connector per a cateters. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30039984

Descripció llarga:

Catèter peritoneal antimicrobià (Rifampicina i Clindamicina) per a drenatge intern LCR, Øintern 1mm, Øextern 2,2mm, llargària 120 cm +/-2cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30041993

Descripció llarga:

Tunelitzador per a generador d'estimulació nervi vague compatible amb generador ASPIRE HC i ASPIRE RC

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30043017

Descripció llarga:

Equip catèter 5F intraparenquimatós amb sensor per a la medició de PIC (-40 a 400mmHg), la temp cerebral i la pressió parcial d'oxig en tissular al cervell (0-200mmHg). Cateter 5Fx55cm+/-2cm i kit de fixació. Compatible amb monitor MPR2 Raumedic o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30051236

Descripció llarga:

Programador de pacient per a neuroestimulador d'arrels sacres. Connexió per Bluetooth. Genera informes, tutorial ús. Compatible amb generadors INTERSTIM o equivalents

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30051267

Descripció llarga:

Tunelitzador per a generador d'estimulació gangli arrel dorsal compatible amb generador Proclaim DRG mod 3664 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30051426

Descripció llarga:

Tunelitzador en mànec en T,35cm de llargària,punta roma, punta tròcar i protector punta,d'acer inox i FEP(Etilè i Propilè fluorinat) Compatible amb sistema Nevro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30051451

Descripció llarga:

Cable per a prova multicontacte, connexió coaxial multipolar tancada, llargària 74cm, amb extensió 91cm, compatible amb elèctrodes tetrapolars i octopolars de ANS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30051454

Descripció llarga:

Carregador extern per generador d'impulsos implantable, recarregable, fins a una profunditat de implant de 2,5cm. Compatible amb gen eradors Eterna/Liberta o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30051458

Descripció llarga:

Programador pacient extern per neuroestimulador, seleccionar programa, modifica amplitud(dintre dels marges mèdics), inalàmbric, blu etooth, compatible amb generadors Eterna, Proclaim o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30052789

Descripció llarga:

Cinturó sistema de recàrrega per a neuroestimulador Interstim talla L. Ref. FP9000

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30054146

Descripció llarga:

Equip programador pacient amb tecnologia Bluetooth format per programador, funda del programador i font d'alimentació, compatible amb b Generador d'impulsos VERCISE GENUSR16 M365DB12160. Ref: M365DB55721A0

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30054147

Descripció llarga:

Equip programador pacient per radiofreqüència format per programador, funda del programador i font d'alimentació, compatible amb Gen erador d'impulsos VERCISE GII

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30054148

Descripció llarga:

Equip carregador pacient amb cinturó de càrrega format per carregador, base de carregador i font d'alimentació, compatible amb Gener ador d'impulsos VERCISE GENUS R16 M365DB12160 implantació abdominal. Ref : M365DB641260

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30054149

Descripció llarga:

Equip carregador pacient amb coll de càrrega format per carregador, base de carregador i font d'alimentació, compatible amb Generado r d'impulsos VERCISE GENUS R16 M365DB12160 implantació pectoral. Ref : M365DB641250

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30054150

Descripció llarga:

Programador de pacient compatible amb generadors Vanta o equivalents.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30054151

Descripció llarga:

Programador de pacient compatible amb generadors de la família INTELLIS o equivalents.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30054152

Descripció llarga:

Sistema extern de recarrega amb sensor de temperatura, carregador amb bateria autònoma, medicació constant del nivell de càrrega. Comp atible amb els generadors recarregables de la família INTELLIS o equivalents. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30054153

Descripció llarga:

Equip recarregador d'estimulació cerebral profunda, compatible amb neuroestimulador implantable Activa RC i equivalents

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30054173

Descripció llarga:

Equip recarregador d'estimulació arrels sacres, amb carregador i estació de connexió, compatible amb neuroestimulador implantable IN TERSTIM Micro i equivalents. Ref: RS5200

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30057686

Descripció llarga:

Sensor/impl temporal intraparen s/temp p/monit PIC/pressió tisular O2, desv 0,6mmHg als 5 dies(PIC), compatibilitat RM en procediments 1,5T i 3,0T, sensibilitat al oxigen 22m2, comp amb catèter microdialisi. 5Fx15 ,5-16cm. Long total cat 55cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30060056

Descripció llarga:

Sensor per a monitoratge pressió intracranial PIC y la PTD en parènquima cerebral,transductor punta 3F, catèter flexible 100cm, carg ol metàlic amb topall de compressió, broca 2,7mm, clau hexagonal. CERELINK o equivalen

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30060057

Descripció llarga:

Sensor intraventricular per a monitoratge pressió intracranial PIC y la PTD, transductor punta 3F, catèter flexible 100cm, catèter a ccès ventricular 38cm, tròcar 7G, clip anclatge. CERELINK o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30061522

Descripció llarga:

Equip de tubs per a drenatge extern de líquid cefalo-raquidi, longitud 1600mm compatible amb sistema de mesura de pressió intracrani al PIC
Liquoguard 7 o equivalent, estèril, un sol ús, ref: MOL3497

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30061523

Descripció llarga:

Equip de tubs per a drenatge extern de líquid cefalo-raquidi, longitud 2000mm compatible amb sistema de mesura de pressió intracrani al PIC
Liquoguard 7 o equivalent, estèril, un sol ús, ref: MOL3501

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30062098

Descripció llarga:

Equip catèter 9F intraparenquimatós amb sensor per a la medició de PIC (-40 a 400mmHg) i amb funció drenatge del LCR. Cateter 9Fx38c m+/-2cm i kit de fixació. Compatible amb monitor MPR2 Raumedic o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30062372

Descripció llarga:

Programador pacient extern per neuroestimulador, seleccionar programa, modifica amplitud(dintre dels marges mèdics), inalàmbric, blu etooth, compatible amb generadors Infinity/Liberta o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30062407

Descripció llarga:

Equip tubs PVC test d'infusió. Inclou tub 1,6m amb perforador i claus 2vies L-L, agulla touhy, adhesiu. Compatible amb monitor Liquo Guard 7 o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30063841

Descripció llarga:

Programador de pacient per a neuroestimulador d'arrels sacres. Recarregable. Compatible amb generador INTERSTIM X o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30065918

Descripció llarga:

Catèter intratecal 2 peces, silicona, radioopaca, llargària 140+/-1cm: catèter intraespinal 4Fr, aleta fix, catèter bomba 4Fr conne xió bomba s/sutura, Øintern conn cat 0,3mm. 1 agulla introd 16Gx11+/-1cm. Compatible bomba SYNCHROMED II o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30065954

Descripció llarga:

Sistema de fixació electròdes estimulació medul.la espinal, titani, compatible amb neuroestimulador Nevro o equivalent. Ref ACCK5300

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30065955

Descripció llarga:

Sistema de fixació electròdes estimulació a extensions, electròdes al generador, compatible amb neuroestimulador Nevro o equivalent. Ref ACCK6006

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30066876

Descripció llarga:

Sensor per a monitoratge pressió intracranial PIC y la PTD, parènquima cerebral,transductor punta 3F, catèter flexible 100cm, cargol craneal de plàstic, conex luer, adult/pediàtric, anell espaiador, adaptador i mànec d'inserció cargol. CERELINK o equiv

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30068113

Descripció llarga:

Tunelitzador estàndart per a vàlvula hidrocefàlia, mida 300mm, recta, flexible. Estèril, lliure de làtex. FX005SU

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30068381

Descripció llarga:

Sistema tancat per drenatge d'hematoma subdural crònic o subagut, mínimament invasiu, pressió negativa inferior a 2,5cmH2O. Estèril

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30069574

Descripció llarga:

Programador de pacient per a generador d'impuls/neuroestimulador per estimulació cerebral profunda, compatible amb generadors de la família ACTIVA i equivalents.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30069575

Descripció llarga:

Carregador bateria, compatible amb Nevro Senzall NIPG2500, OMNIA o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30069576

Descripció llarga:

Programador de pacient per a generador d'impuls/neuroestimulador per estimulació medul·lar espinal, compatible amb generador Nevro, OMNIA TRIAL o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30069577

Descripció llarga:

Programador de pacient per a generador d'impuls/neuroestimulador per estimulació medul·lar espinal, compatible amb generador Nevro Senzall NIPG2500, OMNIA o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30069669

Descripció llarga:

Equip de reompliment dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 25G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenestrada, xeringa 10cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchromed o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30069759

Descripció llarga:

Programador de pacient sense cables amb rang de comunicació fins a 100cm, compatible amb generadors de la família EVOKE o equivalents.

SOL.COMANDA: 1101434775 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30069760

Descripció llarga:

Equip de recarrega compost per carregador sense cables amb sensor de temperatura i accessoris, compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2660	MATERIAL: 30069761
Descripció llarga: Equip fixació elèctrodes de 12 contactes, compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2670	MATERIAL: 30069762
Descripció llarga: Equip tunelitzador compatible amb neuroestimulador EVOKE o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2680	MATERIAL: 70003464
Descripció llarga: Cable trençat de connexió de 18 electrodes profunds intercerebral, conector aislat de 1,5 mm de diametro distania minima de connexio 5 mm, longitud 150cm.Compatible amb ALCIS 2069 EPC o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2690	MATERIAL: 70003465
Descripció llarga: Cable trençat de connexió de 15 electrodes profunds intercerebral, conector aislat de 1,5 mm de diametro distania minima de connexio 5 mm, longitud 150cm. Compatible amb ALCIS 2069 EPC o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2700	MATERIAL: 70003498
Descripció llarga: Cable per sonda/elevador Stimulus,amb possibilitat d'estimulació monopolar nerviosa integrada,274cm+/-10cm,reutilitzable,connexió com patible ambneuroestimulador Nim o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2710	MATERIAL: 70003682
Descripció llarga: Cable trençat de connexió de 10 electrodes profunds intercerebral, conector aislat de 1,5 mm de diametro distania minima de connexio 5 mm, longitud 150cm. Compatible amb ALCIS 2069 EPC o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2720	MATERIAL: 70003720
Descripció llarga: Comandament a distància portàtil per a pacient, per a neuroestimulació perifèrica, compatible amb generador Lighpulse o equivalent. No estèril.		
SOL.COMANDA: 1101434775	POSICIÓ: 2730	MATERIAL: 70003780
Descripció llarga: Cable trençat de connexió de 12 electrodes profunds intercerebral, conector aislat de 1,5 mm de diametro distania minima de connexio 5 mm, longitud 150cm. Compatible amb ALCIS 2069 EPC o equivalent		

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el Excel **Licitació 1101434775_2bis**.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

...

4

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofert
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofert. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofert. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofert	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101434775/26/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE IMPLANTS QUIRÚRGICS NEUROLÒGICS	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador		
Identificació de l'empresa		
NIF	Nom	Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor		Material de fabricació *	
Referència fabricant		Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència
	(IMATGE OBLIGATÒRIA)

Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC		
Marcat CE/Tipus de classe		
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	(SI/NO)	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material		
Altres acreditacions i/o auto certificació		

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació			Codi SAP
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101434775/26/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE IMPLANTS QUIRÚRGICS NEUROLÒGICS		
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta

Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF		Nom	
		Fabricant	
		Fabricant	(SI / NO)
		Distribuïdor	(SI / NO)

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

Annex D3 - Llistat-resum Requeriments Obligatoris

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'excel **ANNEX_D4_1101434775**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	OBLIGATORI
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	OBLIGATORI
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	OBLIGATORI
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI /NO, <u>no es pot deixar en blanc</u>	OBLIGATORI
-----------------	---	-------------------

SI PRESENTA OFERTA = SI

TOTS els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb el compliment definit informat (desplegable).

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

Si l'arxiu no està degudament complimentat pot suposar la no comptabilització del criteri.

SI PRESENTA OFERTA = NO

Els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SÍ/NO	3 punts SÍ/NO	5 punts SÍ/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Sí	Sí	Sí	No

Per aquesta licitació no hi ha requeriments obligatoris.

Annex D5 – Fitxa tècnica material ofert Product Data

(format lliure)

Annex D6 – Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor

FITXE-RESUM CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (CRITERIS SUBJECTIUS)

ANNEX D6 CS/CC00/1101434775/26/AMUP

(annex informatiu)

LOT 19 IMPLANTS BIOLÒGICS PER A LA DURAMÀTER PER A SUTURAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Estanqueïetat sense fuga de líquids
Resistència a la pressió (esquinçaments)
Adaptabilitat (rigidesa de la plàstia)
Elasticitat

(No existeix un model del document a presentar per acreditar el compliment del criteri. L'empresa licitadora decidirà el format a presentar)

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques sol·licitades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

IANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra obligatoria

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
19	20148070	Implant bio 10x12,5cm Duramatrix CDSLM45	2	
19	20052806	Implant bio no abs 10x16cm/0,4 Duraguard	2	
19	20028602	Implant duramàter bio 12x16cm Tutopath	2	
19	20000018	Implant duramàter bio 6x14cm Lyoplant	2	
20	20023133	Impl durama bio 10x12,5cm Lyoplant Onlay	2	
20	20133435	Implant bio 7,5x7,5cm DURAGEN ID-3301-I	2	