

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101452078/26/AMUP

CATÈTERS I RECIPIENTS DE DRENATGE TORÀCIC,
PLEURAL I BRONQUIAL

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de catèters i recipients de drenatge toràctic, pleural i bronquial, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits d'obligat compliment per aquesta licitació

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101452078_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**.

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

Detallats al document "*ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració*", del plec administratiu, "*Plantilla Puntuació PCAP*".

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "*Annex D4 - Guia per emplenar annex*".

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data. ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació

complementària a la Product Data”. La no presentació d’aquest certificat podrà ser motiu d’exclusió.

Dins d’aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d’anomenar-se d’aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

No es requereix presentació de mostra a la fase de presentació d’oferta.

L’òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d’avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s’indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s’indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l’Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l’ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI

- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

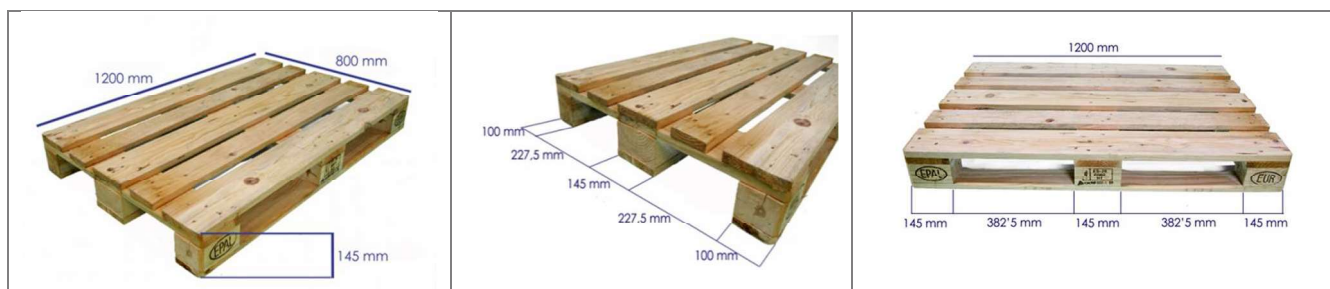

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris

ANNEX D4 - Guia per emplenar annex

ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

ANNEX D5 - Product data material ofert

ANNEX E - Mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101452078/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Catèter recte i obert sense tròcar per a drenatge toràcic	Obligatori
2	Catèter termo-sensible punta oberta i arrodonida amb tròcar per a drenatge toràcic	Obligatori
3	Catèter punta atraumàtica i tancada amb tròcar per a drenatge toràcic	No obligatori
4	Catèter punta aguda i oberta amb tròcar per a drenatge toràcic	Obligatori
5	Catèter amb sistema preventiu d'obstruccions per a drenatge toràcic	No obligatori
6	Catèter telescòpic per a recollida mostra bronquial sense fibroscop	No obligatori
7	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb agulla introductora	Obligatori
8	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb agulla introductora i port lateral	No obligatori
9	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural i/o pneumo-pericàrdic amb agulla introductora	No obligatori
10	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger amb maneguet integral compatible amb teràpia domiciliària i accessoris	Obligatori
11	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta recta	No obligatori
12	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta recta i agulla ecogènica	Obligatori
13	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta pigtail i agulla no ecogènica	Obligatori
14	Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta pigtail i agulla ecogènica	No obligatori
15	Recipient per a drenatge toràcic sec per gravetat/aspiració	No obligatori
16	Recipient per a drenatge toràcic sec per gravetat	No obligatori
17	Recipient per a drenatge toràcic humit per gravetat/aspiració	No obligatori
18	Accessoris i recanvis per a sistemes de drenatge toràcic digital i portàtil sistema Thopaz o equivalent	Obligatori
19	Tubs, vàlvules i connectors	No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001200

Descripció llarga:

Cat drenatge pleural adult percut,catèter 8Fx50 (+/-1) cm PE,punta recta i multiperforat, radioo, marq prof, agulla introductora eco gènica 10Gx 7 ,7(+/-0,5)cm BSA, con cònic p/drenat, clau de 3 vies, codi colors, lliure de làtex i DEHP, estèril, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001202

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic PVC transp, 20Fr 50(+/-1)cm, recte, radioop, marq profunditat, extrem distal punta oberta i orificis latera ls atraumàtics, 5 forats mínim, extrem proximal biselat per a connexió sistema drenatge, lliure de làtex, estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001203

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic PVC transp, 24Fr 50(+/-1)cm, recte, radioop, marq profunditat, extrem distal punta oberta i orificis latera ls atraumàtics, 6 forats mínim, extrem proximal biselat per a connexió sistema drenatge, lliure de làtex, estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001204

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic PVC transp, 28Fr 50(+/-1)cm, recte, radioop, marq profunditat, extrem distal punta oberta i orificis latera ls atraumàtics, 6 forats mínim, extrem proximal biselat per a connexió sistema drenatge, lliure de làtex, estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001205

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic PVC transp, 32Fr 50(+/-1)cm, recte, radioop, marq profunditat, extrem distal punta oberta i orificis latera ls atraumàtics, 6 forats mínim, extrem proximal biselat per a connexió sistema drenatge, lliure de làtex, estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001206

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic PVC transp, 36Fr 50(+/-1)cm, recte, radioop, marq profunditat, extrem distal punta oberta i orificis latera ls atraumàtics, 6 forats mínim, extrem proximal biselat per a connexió sistema drenatge, lliure de làtex, estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001208

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC)transp, Ø10CHx22 (+/-1)cm recte, línia radioo, marq posicio, extr dist punta atraum i tancada, orif lat atraum, extr pro conn forma cònica conn drenatge, premuntat en trôcar recobert(PU) lliure làtex,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001209

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC)termosensible transp, 12Fx23(+/- 1)cm recte, línia radioo, marq prof, extr dist punta oberta arrodon, ori f lat atraum, extr prox cònica conn drenat, premuntat en trôcar quirúrgic acer punta aguda, lliure làtex, estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001211

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC) transparent, Ø16CHx42(+/-1)cm recte, lín radioo, marq posicio, extr dist punta aguda i oberta, orifici s lat atraum, ext prox conn cònica conn sist drenatge, premuntat en tròcar recobert(PU), lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001213

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC) transparent, Ø20CHx42(+/-1)cm recte, lín radioo, marq posicio, extr dist punta aguda i oberta, orifici s lat atraum, ext prox conn cònica conn sist drenatge, premuntat en tròcar recobert(PU), lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001214

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC) transparent, Ø24CHx42(+/-1)cm recte, lín radioo, marq posicio, extr dist punta aguda i oberta, orifici s lat atraum, ext prox conn cònica conn sist drenatge, premuntat en tròcar recobert(PU), lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001215

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC)termosensible transp, 28Fx40(+/- 1)cm recte, línia radioo, marq prof, extr dist punta oberta arrodonada, ori f lat atraum, extr prox cònica conn drenat, premuntat en tròcar quirúrgic acer punta aguda, lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001219

Descripció llarga:

Recip drenat torà humit grav o aspir contr 3cambres(recol·lectora 2000 grad, seg d'aigua color blau i de control aspir -5 a -25) vàlv v alliber pres pos i neg, port mostr, ganx suport i nansa, tub paci conn cònica, desmont conn bloq i clamp. Est,s/làtx,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001844

Descripció llarga:

Recipient drenatge toràcic humit gravetat o aspir contr pediàtric, cambra recol·lectora grad 40ml i seg aigua blau integr, regulador aspiració, tub del pacient amb connexió de bloqueig i cònica, ganx de suport/penjar. Estèril, lliure de làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30002661

Descripció llarga:

drenat pleural neonatal percut, cat 6Fx30(+/-1)cm de PE, punta recta i multiperforat, radioo, marq prof, agulla introductora ecogèni ca 13Gx 5,7(+/-0,5)cm BSA, con cònic p/drenat, clau de 3 vies, codi colors, lliure de làtex i DEHP, estèril, 1sol ús#"

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30003170

Descripció llarga:

Recipient drenatge toràcic en sec gravetat o aspiració control, cambra recol·l grad capacitat 2500, vàlvula control pressió neg, regulador aspir -10 a -40 cm/H2O, suport peu, ganxos suport/penjar i nansa ergonòmica. Estèril, lliure làtex i DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30003373

Descripció llarga:

Cat drenatge pleural adult percut,cat 10Fx50(+/-2)cm de PE,punta recta i multiperforat, radioo, marq prof, sistema antiacodament, ag ul introd ecog 8Gx 7,7(+/-0,5)cm BSA con cònic p/drenat, Clau 3vies, codi colors, lliure de làtex i DEHP, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30003381

Descripció llarga:

Catèter telescòpic recollida mostra bronquial tècnica mini rentat peri-alveolar a cegues(s/fibroscopi)amb beina manipulació; catèter extern polietilè Ø2,7mmx 60(+/-1)cm; catèter intern PTFE Ø1,7mmx 65(+/-1)cm, s/làtex,estèril,lús codificació de colors

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30003406

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte 10Fx20(+/-1)cm PVC transp, 3-4 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla in tro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí n° 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30003407

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte 8Fx18(+/-1)cm PVC transp, 3-4 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla int ro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí n° 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30003408

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte12Fx22(+/-1)cm PVC transp, 3-4 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla int ro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí n° 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30003409

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte 16Fx41(+/-1)cm PVC transp, 4-5 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla in tro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí n° 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30003410

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte 20Fx41(+/-1)cm PVC transp, 4-5 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla in tro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí n° 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30004014

Descripció llarga:

Recipient drenatge toràcic a gravetat per a pneumonectomies 3 cambres(recol·lectora 2000 grad, de pres pos amb segell hidràulic aigu a color blau, pres neg -13cmH2O aigu color vermell), tub pac a/conn cònica, ganxos de suport /penjar. Est, s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30004015

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte14Fx41(+/-1)cm PVC transp, 4-5 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla int ro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí nº 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30004992

Descripció llarga:

Eg catèter toràcic drenatge pleural via percutània:cat PVC transp recte ,12Fx30-32cm,línia radiop,marq profund,extr distal punta roma a/orificis laterals,agulla percut,dilatador,guia "J"50cm +/-2cm,bistur,xeringa, clau 4 pas,con luer-lock,estèr,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30006906

Descripció llarga:

Recipient drenatge toràcic humit per gravetat o aspiració controlada, una cambra recol·lectora graduada amb capacitat 2000 (+/-100) mL, tub per a connexió a catèter toràcic i tub per a aspiració, suport per al terra. Estèril, lliure de làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30012400

Descripció llarga:

"Drenatge pleural Seldinger, catèter punta pigtail 5Fx15(+/-1)cm PUR, 5-6 orificis lat, lín radioo, marq prof, agulla 18G,guia extra rrígida J" 0 ,028" x 40(+/- 2)cm, dilatador, conn bos drenat, clau 3 vies, bisturí nº 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30012401

Descripció llarga:

"Drenatge pleural Seldinger, catèter punta pigtail 6Fx15(+/-1)cm PUR, 5-6 orificis lat, lín radioo, marq prof, agulla 18G,guia extra rrígida J" 0 ,028" x 40(+/- 2)cm, dilatador, conn bos drenat, clau 3 vies, bisturí nº 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30014213

Descripció llarga:

Vàlvula drenat toràcic sec tract ambulat, bulb recol·lecció grad 100 mL silic re-expans i bossa de 2000(+/-100)ml, segell aigua, vàl v antirreflux, pinç subjec, port mostr, conn/adapt cònic comp drenat percut Único o eq a/conn univer, est, s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30015940

Descripció llarga:

Recipient recanvi drenatge toràcic(PP) 300 mL, amb doble cambra recol·lecció amb cambra seguretat, vàlvula alliberam pressió, filtre hidrof antibac, graduació mL i tap. Estèril, lliure de làtex,lús. Comp drenatge toràcic portàtil tipus Thopaz o eq

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30015941

Descripció llarga:

Recipient recanvi drenatge toràcic(PP) 800 mL, amb doble cambra recol·lecció amb cambra seguretat, vàlvula alliberam pressió, filtre hidrof antibac, graduació mL i tap. Estèril, lliure de làtex,lús. Comp drenatge toràcic portàtil tipus Thopaz o eq

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30015942

Descripció llarga:

Tub (PVC) drenatge toràcic, 1,5 (+/-0,2)m xØ5mm, connexió estàndard Ø9,5mm o 19Fr de doble lumen filtre hidrofòbic antibac i clamp, port per a mostres, estèril, s/làtex, lús. Comp codi SAP 30015940 i 30015941 drenatge toràcic portàtil Thopaz o equiv

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30015943

Descripció llarga:

Tub (PVC) drenatge toràcic, 1,5 (+/-0,2)m xØ5mm, connexió estàndard doble Ø9,5mm o 19Fr de doble lumen filtre hidrofòbic antibac i c lamp, port mostres, estèril, s/làtex, lús. Comp codi SAP 30015940 i 30015941 drenatge toràcic portàtil Thopaz o equiv

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30017539

Descripció llarga:

Equip recipient drenat torà sec domiciliari intermit buit, recipient plàstic bulb 1000 mL tub extensió, roda reg vel, tap protec vàl vula catèter, guants, clamp, coixinet, 4gases, apò transp adh, toval desinf, Est, s/làt-DEHP, lús.Comp cat PleurX o eq

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30017561

Descripció llarga:

Tub per a drenatge pleural amb roda reguladora de velocitat de dèbit toràcic, llargària 60(+/-0,5) cm. Estèril, lliure de làtex i DE HP, d'un sol ús.Compatible amb catèter PleurX, PeritX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30032319

Descripció llarga:

Dren pleural Seldinger, cat punta pigtail 14Fr x 29(PUR), for lat, radioop, agul 18G ecog, agul introd 19G x 9, guia metàl, dilat 14F rx13, obtur a/espac, Vàlv tor unidirec, Tub con PVC, Bisturí nº11 s/BS, clau 3 vies, Rec portaagul, s/làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30032535

Descripció llarga:

"Drenatge pleural Seldinger, catèter punta pigtail 8,5Fx15(+/-1)cm PUR, 5-6 orificis lat, lín radioo, marq prof, agulla 18G,guia ext rarrígida J"" 0,028"" x 40(+/- 2)cm, dilatador, conn bos drenat, clau 3 vies, bisturí nº 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30033685

Descripció llarga:

Vàlvula unidireccional tipus Heimlich (PVC) connexió amb el drenatge pleural o toràcic. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30038845

Descripció llarga:

Eq catèter toràcic drenatge pleural i/o pneumopericàrdic percut, catèter 14G x 7,4(+/- 0,5)cm de PE, punta recta perfor, radioo, agu 1 introd 17Ga x 135 (+/-10)mm, acer, clau integrda, conn L-L, xeringa luer-lock, lliure de làtex i DHEP, estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30038923

Descripció llarga:

Tub (PVC) drenatge toràcic, 1,5 (+/-0,2)m xØ5mm, connexió estàndard doble i fi, Ø4mm o 12Fr doble lumen filtre hidrofòbic antibac i clamp, port mostres, estèril, s/làtex, lús. Comp codi SAP 30015940 i 30015941 drenatge toràcic portàtil Thopaz o equiv

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30040675

Descripció llarga:

Eg drenat pleural Seldinger, cat recte18Fx41(+/-1)cm PVC transp, 4-5 orific lat, lín radioop, extrem dist rom, marq prof, agulla int ro ecog 18G, guia extrarrí" J" 0,038", dilatad 3 tam, posic cat coaxial, bisturí nº 11 s/BS, s/làtex, estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30041409

Descripció llarga:

Rec dren tor sec per grav o aspir 3cambr(recol·l grad 1000,aspir i seg), 2punts mostr,tub sil anti-acoda,punt inj medic,rodet muny,b ulb aspir re-expans,indic aspir,reg i vàlv allib pres,vàlv unidir,vàlv contr pres a/3conn,clau-bos buid,ganx,est, s/là,lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30041498

Descripció llarga:

Tub (PVC) drenatge toràcic, 1,5 (+/-0,2)m xØ5mm, connexió estàndard i fi, Ø4mm o 12Fr doble lumen filtre hidrofòbic antibac i clamp, port mostres, estèril, s/làtex, lús. Comp codi SAP 30015940 i 30015941 drenatge toràcic portàtil Thopaz o equiv

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30042611

Descripció llarga:

Vàlvula unidireccional tipus Heimlich (PVC) connexió amb el drenatge pleural o toràcic i bossa recol·lectora graduada amb capacitat de 2000(+/-100)mL (PVC). Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30059871

Descripció llarga:

Eg cat torà drenat pleur Seld ambulat i ecog,cat retall 15,5F silic flex ,radio,orif lat,vàlv unidir,maneg int,agul 18-17G,intro pel 16F,gui,tunel,xer L-L,clavaa, lín dren 6l regul flux,adapt 5/1,tap vàlv unid,gas,eq est,s/làt-DEHP,est,lús,comp PleuX o eq

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30061185

Descripció llarga:

Conn luer-lock mascle-xeringa gran de material plàstic, Ø8mm, per a (sonda nutrició pediàtrica, vàlvula doble per a drenatge toràcic /drenatge pleural nen nounat i vàlvules tipus Heimlich), lliure de làtex, estèril, lús, compatible amb núm. 30071129

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30066804

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic compost per sonda toràcica silicona, Ø32Fx10 ,2(+/-1)cm longitud efectiva, radioopaca, orificis laterals + s onda guia amb corredera magnètica, extrem proximal connexió a/PleuraFlow o equivalent, n/làtex, DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30068390

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC)termosensible transp, 16Fx25(+/- 1)cm recte, línia radioo, marq prof, extr dist punta oberta arrodonida, ori f lat atraum, extr prox cònica conn drenat, premuntat en tròcar quirúrgic acer punta aguda, lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30068391

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC)termosensible transp, 20Fx40(+/- 1)cm recte, línia radioo, marq prof, extr dist punta oberta arrodonida, ori f lat atraum, extr prox cònica conn drenat, premuntat en tròcar quirúrgic acer punta aguda, lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30068392

Descripció llarga:

Catèter drenatge toràcic(PVC)termosensible transp, 24Fx40(+/- 1)cm recte, línia radioo, marq prof, extr dist punta oberta arrodonida, ori f lat atraum, extr prox cònica conn drenat, premuntat en tròcar quirúrgic acer punta aguda, lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30069997

Descripció llarga:

Sist evacuació d'aire i fluids toràcic, consta: cambra separació aire-liquid, vàlv antirefluxe, vàlv unidireccional, vàlv suplem, dipòsit colecció 300ml, botó per transf fluids a bossa, tub goma 500mm, connectors 24-32CH i 15-21CH, luer lock macho. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101452078 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30071153

Descripció llarga:

Drenatge pleural percut, catèter 14G x85(+/-5)mm de PE, punta recta i perforada, radioo, port lat, agulla introductora 8Gx 7,7(+/-0, 5)cm BSA, tub extensió, connector per a sistema de drenatge, Clau de 3 vies, lliure de làtex, estèril, 1sol ús

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	CS/CC00/1101452078/26/AMUP
Descripció expedient	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CATÈTERS I RECIPIENTS DE DRENATGE TORÀCIC, PLEURAL I BRONQUIAL

Dades del licitador

Identificació de l'empresa	
NIF	
Nom	

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulaci3n prod sanitarios (SI/NO)
1	30001202	Catèter toràcic recte PVC 20Fx50cm obert							
1	30001203	Catèter toràcic recte PVC 24Fx50cm obert							
1	30001204	Catèter toràcic recte PVC 28Fx50cm obert							
1	30001205	Catèter toràcic recte PVC 32Fx50cm obert							
1	30001206	Catèter toràcic recte PVC 36Fx50cm obert							
2	30001209	Cat torà PVC 12Fx23cm+tròcar punta aguda							
2	30001215	Cat torà PVC 28Fx40cm obert+tròcar afil							
2	30068390	Cat torà PVC 16Fx25cm obert+tròcar afil							
2	30068391	Cat torà PVC 20Fx40cm obert+tròcar aguda							
2	30068392	Cat torà PVC 24Fx40cm+tròcar punta aguda							
3	30001208	Cat torà PVC 10x22cm+tròcar punta atrau							
4	30001211	Cat torà PVC 16x27cm+tròcar punta aguda							
4	30001213	Cat torà PVC 20x42cm+tròcar punta aguda							
4	30001214	Cat torà PVC 24x42cm+tròcar punta aguda							
5	30066804	Cat dren tor 32x10,2 corredera magnètica							
6	30003381	Catèter mostra bronq s/fibros 2,7mm 60cm							
7	30001200	Cat drenatge pleural PE+ag integ 8Fx50cm							
7	30002661	Cat drenatge pleural PE+ag integ 6Fx30cm							
7	30003373	Cat drenatge pleural PE+ag integ10Fx50cm							
8	30071153	Drenatge pleural 14G x85 port lateral							
9	30038845	dren pleural-pneumopericàrdic 14Gx7,4							
10	30017539	Equip drenatg pleural buït 1000ml PleurX							
10	30017561	Tub drenatge pleural 60cm adap PleurX							
10	30059871	dren pleural Seldinger ambul i ecog 15,5							
11	30004992	Eq cat toràc dren pleur PVC 12Fx30cm							
12	30003406	Eq cat toràc dren pleur PVC 10Fx20cm							
12	30003407	Eq cat toràc dren pleur PVC 8Fx18cm							
12	30003408	Eq cat toràc dren pleur PVC 12Fx22cm							
12	30003409	Eq cat toràc dren pleur PVC 16Fx41cm							
12	30003410	Eq cat toràc dren pleur PVC 20Fx41cm							
12	30004015	Eq cat toràc dren pleur PVC 14Fx41cm							
12	30040675	Eq cat toràc dren pleur PVC 18Fx41cm							
13	30012400	Eq cat toràc pleur PUR pigtail 5Fx15cm							
13	30012401	Eq cat toràc pleur PUR pigtail 6Fx15cm							
13	30032535	Eq cat toràc pleur PUR pigtail 8,5Fx15cm							
14	30032319	Eq dren pleural Seldinger pigtail 14Fx29							
15	30003170	Equip drenatg toràc humit-sec 2500ml							
15	30041409	Equip drenatg toràcic 1000ml Sinapi							
16	30004014	Recipient drenat toràcic 2000ml gravetat							
16	30069997	Drenatge toràcic DRENTECH WEARABLE REDAX							
17	30001219	Equip drenatge torà humit 2100ml+H2O							
17	30001844	Equip drenatge toràcic 2000ml							
17	30006906	Recipient drenatge toràcic 400ml							
18	30015940	Recipient PP drenat toràcic 0,3L Thopaz							
18	30015941	Recipient PP drenat toràcic 0,8L Thopaz							
18	30015942	Tub PVC drenat toràcic Ø5mmx1,5m							
18	30015943	Tub drenatge toràcic doble tipus Thopaz							
18	30038923	Tub drenatge toràcic doble/fi Thopaz							
18	30041498	Tub dren toràcic std simple 1llum Thopaz							
19	30014213	Vàlvula drenat toràc sec ambulat 100ml							
19	30033685	Vàlvula de Heimlich catèter toràcic							
19	30042611	Vàlv Heimlich catèter toràcic+bossa							
19	30061185	Connector LL per a drenatge toràcic							

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha requisits d'obligat compliment per aquesta licitació)

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'excel **ANNEX_D4_1101434775**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	OBLIGATORI
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	OBLIGATORI
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	OBLIGATORI
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI /NO, no es pot deixar en blanc	OBLIGATORI
-----------------	---	-------------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI

TOTS els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb el compliment definit informat (desplegable).

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

Si l'arxiu no està degudament complimentat pot suposar la no comptabilització del criteri.

SI PRESENTA OFERTA = NO

Els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SÍ/NO	3 punts SÍ/NO	5 punts SÍ/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Sí	Sí	Sí	No

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data

ANNEX E – Presentació de mostres

(Per aquesta licitació no es obligatori la presentació de mostra del material licitat)