

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101454545/26/AMUP

INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A
PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ARTROSCÒPIA, CIRURGIA
TRAUMATOLÒGICA I TORÀCICA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 1 de 89

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	7
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació	10
4.3. Manual d'usuari	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	10
4.4.1. Condicions de subministrament	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3. Sistema EDI	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges	15
4.5.2. L'albarà	16
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 3 de 89

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: artroscòpia, Cirurgia traumatològica i toràctica per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Es obligatori, per ser acceptat i avaluat presentar una Declaració jurada de l'empresa on certifiqui que,

- El terminal/motor/peça de mà/vaporitzador/bomba d'aigua/cànula i agulles-Broques per a artroscòpia hauran de ser del mateix fabricant per garantir la compatibilitat i el funcionament òptim del sistema.
- Els terminals de vaporització per radiofreqüència/electrocirurgia hauran d'incloure un sistema de regulació de la pressió d'aspiració mitjançant bomba i un sistema de regulació de temperatura.
- Els sistemes d'aspiració/irrigació hauran de disposar d'un sistema de regulació de la pressió d'aspiració.

Així mateix, els licitadors que presentin oferta als lots de Terminals de motors d'artroscòpia han de presentar obligatòriament oferta, al lot equivalent d'Equips de tubs, Terminals de vaporització, Cànules i Agulles-Broques d'artroscòpia ja que aquest material es considera complementari i necessari per realitzar el procediment i/o tècnica.

El licitador que presenti oferta al Lot 01 - Terminals de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/peça de mà Arthrex o equiv, obligatòriament ha de presentar oferta als materials inclosos als lots següents:

- Lot 02 - Terminals vaporitzador d'un sol ús per a artroscòpia comp a/cònsola Arthrex o equiv
- Lot 03 - Equips d'irrigació/aspiració d'un sol ús per a bomba d'artroscòpia Arthrex o equiv
- Lot 04 - Cànules per a artroscòpia d'un sol ús compatible amb sistema Arthrex o equiv
- Lot 15 - Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, un sol ús comp a/sistema Arthrex o eq

El licitador que presenti oferta al Lot 05 - Terminals de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible a/motor/peça de mà Conmed o equiv, obligatòriament ha de presentar oferta al material inclòs al lot:

- Lot 006 - Terminals de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/peça de mà Conmed, Linvatec, Ergo, Apex, Advantage, Advantage Turbo o equiv

El licitador que presenti oferta al Lot 07 - Terminal motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/consola/generador/peça de mà Dyonics o equiv, obligatòriament ha de presentar oferta als materials inclosos als lots següents:

- Lot 08 - Terminal vaporitzador d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb consola/generador ArthroWand Quantum, Werewolf o equiv
- Lot 09 - Equip d'irrigació/aspiració un sol ús per a artroscòpia comp a/sistema/consola/generador Dyonics 25 o equiv
- Lot 10 - Cànules per a artroscòpia d'un sol ús comp a/sistema Smith & Nephew o equivalent



- Lot 16 - Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, un sol ús compatible amb sistema Smith&Nephew o equiv

El licitador que presenti oferta al Lot 11 - Terminal de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible a/motor/consola/generador/peça de mà Crossfire o equiv, obligatòriament ha de presentar oferta als materials inclosos als lots següents:

- Lot 12 – Terminal vaporització d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/consola/generador/Crossfire o equiv
- Lot 13 - Equips d'irrigació/aspiració d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb consola/generador de Stryker o equiv
- Lot 14 - Cànules per a artroscòpia d'un sol ús compatible amb sistema Stryker o equivalent
- Lot 17 - Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, un sol ús comp a/sistema Stryker o equiv

Es obligatori, per ser acceptat i avaluat, presentar un Certificat d'un organisme notificador acreditat, de la normativa següent:

Norma UNE-EN-ISO 13485:2016/AC: 2017 darrera actualització UNE-EN ISO 13485: 2018 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc. que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.



3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: Excel Licitació 1101454545_2bis

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**



Exemple: *Resum.xls* o *.xlsx*

- **Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4** Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.
El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

Els marcats CE podran presentar-se en català, castellà o anglès.

3.3. Presentació de mostres



L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excident ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.



Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no és possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats



- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	



Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.



El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:



Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

PPT_23_2026_Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: Artroscòpia, Cirurgia Traumatològica i Toràctica

14 / 20



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 14 de 89

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

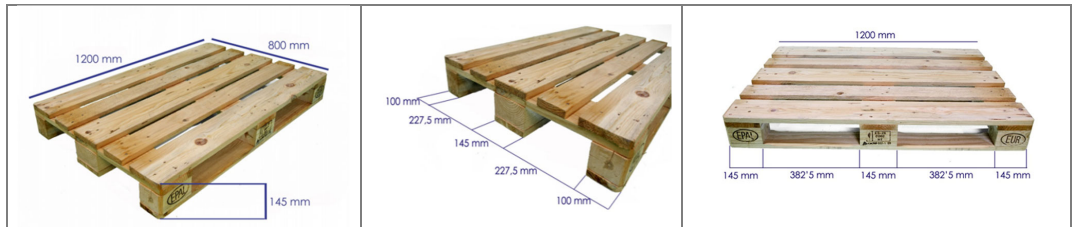

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.



En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat



real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 – Llista resum, Criteris judici de valor
ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a
valorar per l'aplicació del criteris objectius.
El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació
ANNEX E - Presentació de mostres (no es demanen mostres)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 20 de 89

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE

MATERIAL

CS/CC00/1101454545/26/AMUP

INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A

PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ARTROSCÒPIA,

CIRURGIA TRAUMATOLÒGICA I TORÀCICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 21 de 89



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 22 de 89

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101454545/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT Obligatori S/N
001	Terminals de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/peça de mà Arthrex o equivalent	SI
002	Terminals vaporitzador d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb cònsola Arthrex o equivalent	SI
003	Equips d'irrigació/aspiració d'un sol ús per a bomba d'artroscòpia Arthrex o equivalent	SI
004	Cànules per a artroscòpia d'un sol ús compatible amb sistema Arthrex o equivalent	SI
005	Terminals de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/peça de mà Conmed, Linvatec, Ergo, Apex, Advantage, Advantage Turbo o equivalent	SI
006	Terminals vaporitzador d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb cònsola Conmed, Linvatec, Ergo, Apex, Advantage, Advantage Turbo o equivalent	SI
007	Terminal motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/consola/generador/peça de mà Dyonics o equivalent	SI
008	Terminal vaporitzador d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb consola/generador ArthroWand Quantum, Werewolf o equivalent	SI
009	Equip d'irrigació/aspiració d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb sistema/consola/generador Dyonics 25 o equivalent	SI
010	Cànules per a artroscòpia d'un sol ús compatible amb sistema Smith & Nephew o equivalent	SI
011	Terminal de motor d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/consola/generador/peça de mà Crossfire o equivalent	SI
012	Terminal vaporització d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb motor/consola/generador/Crossfire o equivalent	SI
013	Equips d'irrigació/aspiració d'un sol ús per a artroscòpia compatible amb consola/generador de Stryker o equivalent	SI
014	Cànules per a artroscòpia d'un sol ús compatible amb sistema Stryker o equivalent	SI
015	Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, un sol ús compatible amb sistema Arthrex o equivalent	SI
016	Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, un sol ús compatible amb sistema Smith&Nephew o equivalent	SI
017	Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, un sol ús compatible amb sistema Stryker o equivalent	SI
018	Altres material tallant un sol ús	NO
019	Equips per a reconstrucció artroscòpica, un sol ús	SI
020	Equips i instrumental per a reparació artroscòpica, un sol ús	SI
021	Artroscòpia: Recuperador-passador de sutures i tendons, un sol ús	SI
022	Artroscòpia: Recuperador-passador de sutures i equip d'instruments per a maluc, un sol ús	SI
023	Equips d'instruments per a cirurgia endoscòpica de columna i mínimament invasiva, un sol ús	SI
024	Artroscòpia: Recuperador-passador de sutures i equip reparació meniscal, un sol ús	NO
025	Altres material i accessoris per a cirurgia endoscòpica mínimament invasiva, un sol ús	NO
026	Instruments i accessoris per a cirurgia endoscòpica de columna, mínimament invasiva un sol ús, compatible sistema Everest o equivalent	SI
027	Terminal de vaporització per a cirurgia endoscòpica de columna mínimament invasiva, un sol ús	SI
028	Instrumental i accessoris per a cirurgia de columna d'un sol ús, compatible amb sistema Horizon o equivalent	SI
029	Instrumental i accessoris per a cirurgia de columna d'un sol ús	SI
030	Altres material per a cirurgia d'espatlla d'un sol ús	SI
031	Altres material per a cirurgia traumatològica d'un sol ús	NO
032	Equips i accessoris per extracció de material d'osteosíntesi d'un sol ús, compatible amb sistema Operace o equivalent	SI
033	Separadors, retractors protectors cirurgia traumatològica d'un sol ús.	SI
034	Manegots isquèmia complet per a cirurgia traumatològica d'un sol ús	SI
035	Manegots d'isquèmia d'un sol ús per a equip SmartPump o equivalent	SI
036	Manegots d'isquèmia reutilitzables per a equip pneumàtic VBM o equivalent	SI
037	Manegots d'isquèmia i exanguinador reutilitzables per a equip pneumàtic DTS-3000 o equivalent	SI
038	Manegots d'isquèmia reutilitzables per a equip pneumàtic ATS 2200-4000 o equivalent	SI
039	Sistemes d'irrigació/aspiració intramedul·lar i accessoris un sol ús	SI
040	Sistemes d'irrigació i aspiració Pulsàtiu: peça de mà i terminals varies mides	SI
041	Sistemes d'irrigació i aspiració, compatible amb sistema Interpulse o equivalent	SI
042	Sistemes d'irrigació i aspiració, compatible amb sistema Pulsavac o equivalent	NO
043	Equips d'inmovilització/fixació, compatible amb torre de tracció Arthrex o equivalent	SI
044	Equips d'inmovilització/fixació per a tracció de dits	SI
045	Equips d'inmovilització/fixació compatible amb Smith&Nephew o equivalent	SI



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 23 de 89

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 24 de 89

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 1 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30007254
Descripció llarga: Terminal p/artroscòpia Incisor Plus Elite,p/procediments artroscòpics genoll,tall ample-fula interna/dent,punta recta-llarga a/fine str 4 ,5mmx18cm llarg,acer-polycarbonat,pissarra,est,lús.Compatible amb peça mà i consola Dyonics Power i Power II o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30007375
Descripció llarga: Esponja escuma protectora genoll p/artroscòpia,p/protegir genoll de premsa q/aplica p/fer artroscòpies,mida:96cm+/-3cm(llarg)x9cm+/- 0 ,5cm(ample)x3,5cm+/-0,3cm(alt),escuma polièster-polietilè,no làtex,no est,lús.Comp/sist/Allen suport de cama o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30007885
Descripció llarga: Equip de rentat pulsatiu d'alt flux,inclou:peça de mà angulada, ergonòmica ,i terminal netejador d'os,succió i irrigació control manu al, per a neteja de ferides i lesions òssies. Estèril i d'un sol ús.Compatible amb sistema Interpulse o equiv		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30007886
Descripció llarga: Terminal d'irrig/aspir Ø 3,17 cm, sistema doble tub, amb protector contra esquitxades flexible i adaptable a la zona de treball. Per a cirurgia de pròtesi de genoll i fresat acetabular.Compat pistola rentat sistema Ultrex o equiv.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30007887
Descripció llarga: Terminal raspall de rentat pulsatiu del canal femoral , tub irrigació i aspiració, fluxe màxim 771ml/minut. Estèril. D'un sol ús. Co mpatible amb sistema Interpulse o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30007888
Descripció llarga: Terminal raspall de rentat pulsatiu d'irrigació i aspiració femoral, diàmetre 32mm,llargària 280mm, estèril, un sol ús. Compatible a mb pistola de rentat pulsatiu amb bateria tipus W-202-B i W-202-A o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30008735
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Aggressive Plus, recta,finestra interior dentada de 4,0mm,per a procediments artroscòpics de resecció de teix it,d'acer inoxidable,estèril,lús.Compatible motors Shaver i CrossBlade i dentificació consola Crossfire o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30008738
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Ressector, recta, finestra interior dentada de 3 ,5mm,per a procediments artroscòpics de resecció de teixit,d' acer inoxidable,estèril, lús. Comp/motors Formula Shaver i CrossBlade i dentificació consola Crossfire o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 2 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30008740
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Slap,recta,finestra de 4,0mm,p/procediments artroscòpics p/protecció labrum núcli ossi del glenoides en una lesió,ace inox,estèril,lús.Comp/motors Formula Shaver i CrossBlade i identificació consola Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30008743
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Full Radius, finestra de 2,5 x 145 mm, per a procediments artroscòpics de petites articulacions, d'acer inoxi dable, estèril, d'un sol ús.Comp/motors Formula Shaver i CrossBlade i identificació consola Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30008746
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Tomcat, recta, finestra dentada de 4,0mm, per a procediments artroscòpics de resecció agressiva de teixit tou , d'acer inoxidable, estèril, lús. Comp/motors Formula Shaver i CrossBlade i identificació consola Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30008747
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Barril de 12 arestes, finestra amb fresa de 4,0x190mm, per a procediments artroscòpics de resecció d' os, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Stryker i amb identificació en consola Stryker o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30008748
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia agressiva +Stonecutter, finestra amb fresa de 4,0mm, per a procediments artroscòpics de resecció d'os , d'acer inoxidable,max rpm 10000, estèril, lús Compatible amb motor i amb identificació en consola Dyonics o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30009601
Descripció llarga: Terminal fresa d'artroscòpia barril de 6 arestes, finestra amb fresa de Ø 5,5mm. Per a procediments artroscòpics de resecció d'os, d 'acer inoxidable, estèril, lús. Comp/motors Formula Shaver i CrossBlade i identificació consola Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30010338
Descripció llarga: Agulla passador, per a artroscòpia d'espalla,Ø1,5mm x 25,45cm+/-2cm, l'agulla travessa el fil de sutura, metàl·lica, flexible,de Ni tinol, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pinça Scorpion o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30010346
Descripció llarga: Equip per a artroscòpia, per a inserció, consta: broca, insertador del chondral Dart Ø1,3mm x 18mm llarg,camisa-guia,cànula,d'acer i noxidable i plàstic,estèril,lús.Compatible amb Sistema de reparació Dart Condral o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 3 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30010354
Descripció llarga: Equip extractor de cilindre osteocondral OATS (mosaicoplastia), per a artroscòpia, de 6,0mm-7,0mm,Consta: 1 trefina de donant,1 tref ina receptor,1 barra alienació,1 impactador,1 tub transferència,1 extractor de nucli. estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30010355
Descripció llarga: Equip extractor de cilindre osteocondral OATS (mosaicoplastia), per a artroscòpia, de 8,0mm-9,0mm,Consta: 1 trefina de donant,1 tref ina receptor,1 barra alienació,1 impactador,1 tub transferència,1 extractor de nucli. estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30010356
Descripció llarga: Equip extractor de cilindre osteocondral OATS (mosaicoplastia), per a artroscòpia, de 10,0mm-11,0mm,Consta: 1 trefina de donant,1 tr efina receptor,1 barra alienació,1 impactador,1 tub transferència,1 extractor de nucli. estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30010379
Descripció llarga: Passador de fils Micro Suture Lasso curt, angle de 70° i llaç de nitinol, d'acer inoxidable i mànec de plàstic, per a la reparació d e desgarraments perifèrics cubitals del disc articular (TFCC), estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30010380
Descripció llarga: LLaç sutura SutureLasso FASTak II, de 45° corbada a la esquerra punta fina, per a artroscòpia d'espàtlla, filferro de nitinol, estèr il, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30010382
Descripció llarga: LLaç sutura SutureLasso FASTak II, de 45° corbada a la dreta punta fina, per a artroscòpia d'espàtlla, filferro de nitinol, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30010383
Descripció llarga: LLaç sutura SutureLasso FASTak II, de 90° recta amunt, per a artroscòpia d'espàtlla, filferro de nitinol, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30010410
Descripció llarga: Cànula transparent, per a artroscòpia d'espàtlla, de diàmetre 8,25mm x 70mm de llargària, estèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 4 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30010411
Descripció llarga: Cànula transparent, per a artroscòpia d'espatlla, de diàmetre 6,0mm x 70mm de llargària, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30010412
Descripció llarga: Cànula transparent, per a artroscòpia d'espatlla, de diàmetre 8,25mm x 90mm de llargària, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30010415
Descripció llarga: Cànula transparent, per a artroscòpia d'espatlla, de diàmetre 5,75mm x 70mm de llargària, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30010431
Descripció llarga: Mànega de tracció amb velcro, per a artroscòpia d'espatlla, per traccionar l'extremitat superior amb 1- 2 traccions, de niló i poliu retà, estèril, d'un sol ús. Compatible amb torre de tracció d'espatlla (Holder) o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30010493
Descripció llarga: Terminal p/artroscòpia Full Radius,p/procediments artroscòpics,menjadora teixits tous,punta corba,còncava-llarga a/finestra de 4,5mm x18cm,acer inox i policarbonat,co/ident/groc,est,lús.Compatible amb motor i a/identificació en consola Dyonics o equival		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30010634
Descripció llarga: Equip de tubs en una sola peça, unió de tub principal i sistema d'extensió de tub de pacient, per irrigar i mesurar la pressió en bo mba d'artroscòpia, estèril, d'un sol ús,envàs individual.Compatible amb bomba Arthrex (AR-6450) o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30011082
Descripció llarga: Beina amb cànula de 15° per a menisc,cap a dalt,UHMWPE,acer inox i plàstic, estèril		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30011305
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Aggressive Plus, recta, finestra interior dentada de 5,5 x 190 mm, per a procediments artroscòpics de resecció, d'acer inoxidable, estèril, lús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 5 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30011321
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Ressector, recta, finestra de 4,0 x 190 mm, per a procediments artroscòpics de resecció de teixit -condrotomi es, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30011323
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Scalloped,recta,finestra amb ganiveta 4,0x190 mm ,p/procediments artroscòpics resecció teixit (cartileg dur i desbridamentrestes LCA),acer inox,estèril,lús.Comp/motor Stryker i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30011327
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Ressector, recta, finestra de 5,0x190 mm, per a procediments artroscòpics de resecció de teixit - condrotomie s, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30011334
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Aggressive Cutter,recta,finestra 2,5x145mm,ganiveta interior dentada,no dentada extern,p/procediments artroscòpics petites articulacions-sinoviotomia,acer inox,est,lús.Compatible a/motor i a/identificació en consola Stryker o equiv		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30011346
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Aggressive Cutter,recta,finestra 3,5x145mm,ganiveta interior dentada,no dentada extern,p/procediments artroscòpics petites articulacions-sinoviotomia,acer inox,est,lús.Compatible a/motor i a/identificació en consola Stryker o equiv		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30011391
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Hooded,finestra amb beina i interior amb fresa esfèrica i poder d'abradió de 3,0mm,p/procediments artroscòpics de petites articulacions,acer inox,estè,lús..Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equiv		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30011392
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Round-Rodona de 6 arestes, finestra amb fresa de 4,0mm, per a procediments artroscòpics de resecció d 'os, d'acer inoxidable, estèril, lús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30011397
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Barril de 6 arestes, finestra amb fresa de 4,0mm, per a procediments artroscòpics de resecció d'os, d 'acer inoxidable, estèril, lús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 6 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30011415
Descripció llarga: Terminal fresa d'artroscòpia Rodona de 12 arestes, finestra amb fresa de 5 ,0 x 190 mm. Per a procediments artroscòpics de resecció d 'os. D'acer inoxidable, estèril, lús Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30011418
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Barril de 12 arestes, finestra amb fresa de 5,5 x 190 mm, per a procediments artroscòpics de resecció d'os, d'acer inoxidable, estèril, lús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30011420
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Barril de 12 arestes, finestra amb fresa de 5,0 x 190 mm, per a procediments artroscòpics de resecció d'os, d'acer inoxidable, estèril, lús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30011431
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas micro pinça,mànc manual,artroscòp petites articula,6 nivells abl ació i 3 coag ,detecc impedància,Ø 2,5mmx270mm llarg cable incorporat,estèril,sol ús.Compatible amb sistema Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30011432
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas micro raspall,mànc manual,artroscòp petites articula,6 nivells a blació i 3 coag,detecc impedància,Ø 2,5mmx270mm llarg cable incorporatestèril,sol ús.Compatible amb sistema Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30011436
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas succió a/mànc manual 50°,artroscòpia maluc,11 nivells ablació,3 coag,detecció impedància,Ø3,5mmx360mm llargària,cable incorporat,estèril,sol ús.Compatible amb sistema Crossfire o equival		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30011438
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas ganxo XL a/succió,mànc manual,p/proced/artroscòpia maluc,a/ganxo ,7niv/ablació i 3 coagulació,detec/impedància,Ø3,5mmx360mm llarg,a/cable incorporat ,est,lús.Comp/istema Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30011439
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas 90S a/succió,mànc manual,artroscòpia-modula genoll i espatlla,11 niv/ablació i 3/coagulació,a/detec/impedància,Ø3,5mmx330mm llarg,cable incorporat,est ,lús.Comp/ sistema Crossfire o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 7 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30011440
Descripció llarga: Terminal vaporitzador rper adiofreqüència bipolar elèctrode Serfas 90-S XL a/succió,mà nec manual 90°,artroscòpia maluc,11 niv/ablaci 6,3 coag, teixi tou i cartilag articular,Ø4mmx360mm llarg,cable incorporat,estèril,sol ús.Comp/sistema Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30011441
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas, 90°, a/succió,mà nec manual,artrosc/modula genoll i espatlla,11ni v/ablació ,3/coagulació,a/detec/impedància,Ø4,0mmx330mm llarg,cable incorporat,est,1ús.Compatible istema Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30011558
Descripció llarga: Equip d'instrumental per anclatge TigerWire, amb: broca de 1,6mm, guia corbada i obturador. Estèril. Compatible amb Ref: AR-3600 o e quivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30011832
Descripció llarga: Recuperador / Passafils de sutures, per a intervencions d'artroscòpia, retràctil, per passar sutures a través d'instrumental amb can ulacions de 1,5mm o més, estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30014590
Descripció llarga: Cartutx amb tubs integrats per a irrigació en procediments d'artroscòpia, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb bomba d' artroscòpia Flosteady o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30014928
Descripció llarga: Cànula d'artroscòpia d'espatlla, diàmetre de 6,5x 75mm+/-5mm, amb vàlvula ajustable i obturador, roscada, de plàstic molt resistent i translúcid, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30014929
Descripció llarga: Cànula d'artroscòpia d'espatlla, diàmetre de 8,0x 75mm+/-5mm, amb vàlvula ajustable i obturador, roscada, de plàstic molt resistent i translúcid, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30016211
Descripció llarga: Broca d'artroscòpia,per a fixació femoral-cortical per a la reparació del lligament creuat anterior, de diàmetre de 4.5mm, amb ullal ,estèril,lsol ús.Comp cargols Sist Endobutton,Endobutton CL o RCI o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 8 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30016214
Descripció llarga: Agulla-Pin amb punta de broca i amb trau/ullal, per a procediments artroscòpics del lligament creuat LCA/LCP, de diàmetre 2,4mm x 38 cm+/-3cm de llargària, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30016215
Descripció llarga: Agulla-Pin amb punta de broca i sense trau/ullal, per a procediments artroscòpics del lligament creuat LCA/LCP, de diàmetre 2,4mm x 25cm+/-2cm de llargària, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30016652
Descripció llarga: Beina d'artroscòpia, per a tracció de dit (atrapa dits / cazamuchachas), amb ganxo a l'extrem distal, mida petita de diàmetre 15mm f ins a 25mm aproximadament, de nylon, sense làtex, estèril,lús.Compatible qualsevol aparell tracció canell o equ. Paqu Zun		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30018386
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Gator,per tall i resecció de teixit tou i cartileg ,petites articulacions i endos nasal pediàtrica, Ø 2,0mmx8c m long, tija d'acer,velocitat màxim 6.000rpm,no làtex,estèril,1 ús.Comp/motors Ergo,Apex,Advantage, Advantage Turbo o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30018387
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Gator,per tall i resecció de teixit tou i cartileg de petites articulacions,Ø 2,9mmx8cm long,base de plàstic i tija d'acer ,velocitat màxim 6.000rpm,no làtex,estèril,1 ús.Comp/a/motors Ergo,Apex,Advantage, Advantage Turbo o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30018821
Descripció llarga: Cànula PassPort Button per a artroscòpia, de diàmetre 6mm x 2cm de llargària, de silicona flexible amb dues pestanyes de baix perfil i un separador de 5mm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30018822
Descripció llarga: Cànula PassPort Button per a artroscòpia, de diàmetre 8mm x 3cm de llargària, de silicona flexible amb dues pestanyes de baix perfil i un separador de 5mm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 30018823
Descripció llarga: Cànula PassPort Button per a artroscòpia, de diàmetre 8mm x 4cm de llargària, de silicona flexible amb dues pestanyes de baix perfil i un separador de 5mm, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 9 / 46
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 30018825
Descripció llarga: Cànula PassPort Button per a artroscòpia, de diàmetre 10mm x 4cm de llargària, de silicona flexible amb dues pestanyes de baix perfil i un separador de 5mm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30023292
Descripció llarga: Trocar d'accés ossi per tècnica percutània accés vertebral compost:ltrocar d'iniciació de punta diamant Ø11GA x15 cm long, mànec pla stic 7,8cm ampla, agulla bisellada,acer a/interior teflonat, 8Gx15cm long. Connexió luer-lock . Estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30027591
Descripció llarga: Protecció per la bota del sistema posicionador decúbit supí/lateral p/procediments artroscòpics de maluc, d'un sol ús. Compatible am b sistema posicionador Active Heel i taules quirúrgiques: Maquet, Eschmann, Berchtold, Amsco i ALM de Steris o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30027618
Descripció llarga: Terminal per a artroscòpia, amb dents, diàmetre 5mm x 13cm llarg, per a resecció de teixit, tub d'acer i connexió a peça de mà de pl àstic, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor d'Arthrex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30027619
Descripció llarga: Terminal motor fresa ovalada, ClearCut 8 estries,Ø 5,mm x 13cm llarg,per a resecció d'os en artroscòpia, tub d'acer i connexió a peç a de mà de plàstic.Compatible amb motor artroscòpia Arthrex.Lliure de làtex,estèril ,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30027620
Descripció llarga: Terminal de vaporització monopolar,ganxo de 90°,ablació i coagulació de teixit tou en procediments artroscòpics,30cm de llargària,d' cer inox ,plàstic,PTFE,sense làtex,estèril,sol ús.Compatible amb CoolCut Arthrex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30027644
Descripció llarga: Cànula per a artroscòpia de maluc, de 7mm x 11cm+/-1cm, amb cànula de polièster transparent i obturador de polímer ABS, sense làtex, estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30027936
Descripció llarga: Terminal per a artroscòpia, amb punta oval estriada, diàmetre 5mm x 13cm llargària, per a resecció d'os, tub d'acer, sense làtex, es tèril, d'un sol ús. Compatible amb motor d'Arthrex o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 10 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30028614
Descripció llarga: Agulla flexible passadora de sutures en cirurgia ortopèdica artroscòpica i oberta, estèril, d'un sol ús Compatible amb pinça passasu tures RP 360° (ref. 39910-900-090) de Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30029248
Descripció llarga: Agulla-guia per a cargol interferencial, de nitinol, de 1,2mm x 30cm+/-3cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb cargol Biosure o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 30030252
Descripció llarga: Equip rentat pulsatiu per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: pistola i terminal d'irrigació/aspiració amb doble connexió, protector antiesquitxades. Compatible amb sistema tipus Pulsavac Plus bateria Fan Spray eq. Est lús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30030333
Descripció llarga: Agulla-Guia per a artroscòpia de genoll sistema Retrobutton, flexible, mil·limetrada, per a reconstrucció del lligament creuat anterior (LCA), amb trauc per enfil·lar la sutura, d'acer inoxidable, estèril, lús. Compat/Sistema Retrobutton o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30030495
Descripció llarga: Terminal motor dissecció corba, resecció de teixit tou en artroscòpia de maluc, de Ø 4,2mm x 19cm de llargària, tub d'acer inoxidable i connexió a peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, lús. Compatible amb motor artroscòpia Arthrex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30030496
Descripció llarga: Terminal motor fresa rodona, per a resecció d'os en artroscòpia de maluc, Ø 5,0mm x 19cm de llargària, 8 estries, tub d'acer i connexió a peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, lús. Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30030497
Descripció llarga: Terminal motor Bone Cutter resecció de teixit tou en artroscòpia de maluc, de diàmetre 4,2mm x 19cm de llargària, tub d'acer inoxidable i connexió a peça de mà de plàstic, sense làtex, estèril, lús. Compatible amb motor artroscòpia Arthrex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30030714
Descripció llarga: Broca per a artroscòpia, de diàmetre 2mm x 46cm de longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb sistema Cinch Lock SS (implant) o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 11 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30030875
Descripció llarga: Full/ganiveta per a sistema percutani descompressió nuclear avançada, per a la necrosis del cap femoral, obertura màxima 21mm, de ti tani. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb substitut ossi Prodense Ref. 87SR-CK15 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30031816
Descripció llarga: Equip de tubs de flux d'entrada/sortida amb sistema de casset,amb sortida estàndard,amb succió,p/subministrar flux d'irrigació a l'a rticulació intraarticular en procediments artroscòpics,estèril,lús.Compatible unitat control Dyonics 25 o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30031965
Descripció llarga: Agulla-passador sutures, per a artroscòpia d'espàtlla, amb rosca a la punta i el fil passa al voltant, metàl·lic, flexible, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pinça Passa-Sutures Scorpion d'Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30032186
Descripció llarga: Agulla-Guia d'artroscòpia, de nitinol, gruix de 1,8mm (cos principal), 26 ,5mm de longitud, punt d'inserció de 0,4mm en forma d'arpó, per passar i recuperar a la vegada la sutura en cirurgia artroscòpica d'espàtlla, estèril, lús. Compatible Pinça GT o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30032273
Descripció llarga: Cànula per a artroscòpia de maluc, de 8,5mm x 11cm+/-1cm, amb cànula de polièster transparent i obturador de polímer ABS, sense làte x, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30032309
Descripció llarga: Beina de protecció hística exterior 12.0, per a clau tibial Expert, per a abordatge suprarotulià, recta, per a claus de 8.0 a 11.0mm , de polietilè, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30032348
Descripció llarga: Passador de sutura Accu-Pass, per a artroscòpia d'espàtlla, recte, precarregat amb monofilament de nailon de nº0 x 121,9cm de llargà ria, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30032360
Descripció llarga: Beina de protecció hística exterior 14.5, per a clau tibial Expert, per a abordatge suprarotulià, tecta, per a claus de 12.0 a 13.0m m, de polietilè, estèril, un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 12 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30032661
Descripció llarga: Cànula introductora d'instrumental per a artroscòpia de maluc, de diàmetre 8,25mm x 11cm de llargària,rosca parcial, de PVC,silicona i Policarbonat estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30032779
Descripció llarga: Eq peça de mà ergonòmica per rentat pulsatiu amb funció d'irrig/aspir ,procediments ortopèdics i desbridament de ferides compost:peça de mà,broquet pulveritzador ventall curt i broquet femoral llarg.Estèril,iús.Comp/terminals rentat pulsatiu a/bat o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30032798
Descripció llarga: Llançadora / Filferro lliscant de nitinol per a passar sutures-fils, punta en forma romboidal, estèril, d'un sol ús. Compatible amb mànec (Ref: 3910-500-750) i agulles lliscants del Sistema Lliscant Champion o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30032894
Descripció llarga: Equip de localització i accés pedicular vertebral percutània en cirurgia de columna, compost de: cànula amb punta tròcar de 15 cm, m ànec en T universal , agulla d'accés pedicular Ø1,6mmx 450mm. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30033151
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic simple, adult. Mida 112x10 cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, tub de 40 "/ 102 cm Rang de pressió 100-475 mmHg,sense látex, un sol ús,estèril.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30033152
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic,simple, adult. Mida 86x10cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, tu b de 40 "/ 102 cm, Rang de pressió 100-475 mmHg,sense látex, un sol ús,estèril.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30033153
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic,simple, adult. Mida 30x8,75 cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, tub de 40 "/ 102 cm,Rang de pressió 100-475 mmHg, sense látex, un sol ús,estèril.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30033607
Descripció llarga: Agulla lliscant passadora de sutures, de 45° esquerra, color vermell, estèril, d'un sol ús. Compatible llançadora lliscant-filferro de nitinol (Ref:3910-500-761) i mànec (Ref:3919-500-750) del Sistema Lliscant Champion o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 13 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30033781
Descripció llarga: Cartutx amb tub d'entrada de color blau per a irrigació en procediments d'artroscòpia, estèril, d'un sol ús. Compatible amb bomba d' artroscòpia amb control total de flux Crossflow o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30033782
Descripció llarga: Cartutx integrat amb tubs d'entrada i de sortida per a irrigació i per a succió en procediments d'artroscòpia, estèril, d'un sol ús. Compatible amb bomba d'artroscòpia amb control total de flux Crossflow o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30033783
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas 90-S Accelerator,corb/90°,a/succió,c/manual,artroscòpia genoll-es patlla ,llniv/ablació i 3/coagul,a/detec/impedància,Ø3,5mmx330mm llarg,cable incorporat,est,lús.Comp/sistema Crossfire o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30033801
Descripció llarga: Agulla lliscant passadora de sutures, de 45° dreta, color vermell, estèril ,d'un sol ús. Compatible llançadora lliscant-filferro de n itinol (Ref:3910-500-761) i mànec (Ref:3919-500-750) del Sistema Lliscant Champion o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30034116
Descripció llarga: Cargol /pin per a distractor Caspar.Mida 70mm longitud total, 14mm longitud de treball, acer inoxidable, lliure de latex, estèril, u n sol ús. Compatible amb distractor Caspar FF891R /FF901R o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 30034190
Descripció llarga: Equip tubs de succió p/procediments d'artroscòpia,casset en una peça,1 tub succió de peça de mà de motor i 1 tub de succió de cànula ,estèril ,lús.Comp/bomba irrigació artroscòpia Bomba Dual (Dual Ware Arthroscopy Pump/Ref: 6480) d'Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 30034191
Descripció llarga: Terminal motor amb fresa oval, per a resecció de teixit tou en artroscòpia de clavicula, Ø 4,0mm x 13cm llarg, 8 estries, tub d'acer i connexió a peça de mà de plàstic,no làtex, estèril, lús.Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 30034192
Descripció llarga: Terminal motor amb fresa bola, per a resecció de teixit tou en artroscòpia, Ø 4,0mm x 13cm llarg, 8 estries, tub d'acer i connexió a peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, lús. Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 14 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30034203
Descripció llarga: Terminal motor amb dents, per a resecció d'os i teixit tou en artroscòpia, de diàmetre 4,0mm x 13cm de llargària, tub d'acer inoxidable i connexió peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, ús. Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30034211
Descripció llarga: Terminal motor sense dents, per a resecció d'os en artroscòpia, de diàmetre 4,0mm x 13cm de llargària, tub d'acer inoxidable i connexió a peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, ús. Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30034254
Descripció llarga: Terminal motor fresa recíproca per a resecció d'os en procediments artroscòpics, Ø 4 mm x 13 cm de llargària, connexió a la peça de mà de plàstic, tub intern i extern d'acer, no làtex, estèril, 1 ús. Compatible amb motors artroscòpia Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30034482
Descripció llarga: Adaptador i tornavis per cargol multiaxial fenestrat, per mànec de connexió ràpida, permet injectar ciment PMMA. No estèril, un sol ús. Compatible amb sistema CD Horizon LEGACY.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30034609
Descripció llarga: Terminal motor dissecció i resecció de teixit tou en procediments artroscòpics, Ø 3mm x 7cm de llargària, connexió a peça de mà de plàstic, tub intern i extern d'acer, no làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb motors d'artroscòpia Arthrex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30034683
Descripció llarga: Llaç passador de sutures, per artroscòpia de teixits tous, corba molt gran, d'acer inox, plàstic i titinol, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30035027
Descripció llarga: Equip d'agulles i cables de monitorització neurofisiològica intraoperatoria en cirurgia de columna vertebral, compatible amb sistema Armada, CoRoent, XLIFT XLP o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30035028
Descripció llarga: Equip dilatadors, clip connexió, palpador i agulles Kishner per a monitorització neurofisiològica intraoperatoria en cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 15 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30035029
Descripció llarga: Equip llum freda, bisturi, fixació, valves separació per a monitorització neurofisiologica intraoperatoria cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30035257
Descripció llarga: Passador de sutures d'artroscòpia NanoPass estàndard, per a sutura de baix perfil, de diàmetre de 1,5mm x 21cm+/-2cm de llargària, e stèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible sistema d'artroscòpia Pivot o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 30035261
Descripció llarga: Passador de sutures d'artroscòpia Slingshot 70° dalt, per a sutura de baix perfil, de diàmetre de 1,5mm x 21cm+/-2cm de llargària, e stèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible sistema d'artroscòpia Pivot o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 30035626
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mm que es pot transformar en broca de 6mm de diàmetre, en un sol instrument, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 30035628
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mm que es pot transformar en broca de 8mm de diàmetre, en un sol instrument, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 30035884
Descripció llarga: Llaç passador de sutures, de filferro de nitinol, longitud 56cm, diàmetre 1mm, estèril. Compatible amb SutureLasso o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 30037993
Descripció llarga: Broca canulada amb anima interna per a articulació amioclavicular, diàmetre 3mm, connexió rodona estàndard tipus Jacobs, acer inoxidable, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 30038007
Descripció llarga: Immobilitzador de dit (atrapa dits / cazamuchachas), de nylon amb cadena i ganxo a l'extrem distal, mida mitjana, diàmetre: 12,7mm, longitud: 178mm+/-10mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb torre de tracció de canell de ARTHREX o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 16 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30038848
Descripció llarga: Recol.lector - rascador de punta corba per a os cortical, cirurgia mínimament invasiva, zona de tall 160°,obertura lateral.Estèril,u n sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30039068
Descripció llarga: Sistema de recuperació de sutures TFCC Mender, amb: 2 agulles rectes amb mandri, 2 agulles corbes amb mandri, 2 llaços amb sistema d e fixació intern, d'acer inoxidable, punta dels llaços de plàstic, 152mm+/-1cm de llargària, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30040264
Descripció llarga: Tornavis-introductor dinamomètric per estrènyer els cargols de protesi de colze, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de prótesi de colze NEXEL.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30040572
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Agressive Plus llarga, recta, finestra dentada de 4 ,0mm x 25cm de llargària, per a procediments artroscòpics de maluc, d'ace inoxidable, estèril, un ús. Compatible amb motor Stryker i amb identificació en consola Stryker o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30040573
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Angled Agressive Plus llarga, angulada, finestra dentada de 4,0mm x 25cm de llargària, per a procediments art roscòpics de maluc, d'acer inoxidable, estèril, un ús. Comp/motor Stryker i amb identificació en consola Stryker o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30040578
Descripció llarga: Terminal fresa de pera XL de 8 arestes, finestra amb fresa Ø4,0mm i 25cm long. Per procediments artroscòpics de resecció d'os en art roscopia de maluc,acer inox,estèril,lús Compatible amb motor i amb consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30040580
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Rodona de 8 arestes, finestra amb fresa llarga de 5,5mm x 25cm llargària, per a procediments artroscò pics de maluc, d'acer inoxidable, estèril, lús. Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30040581
Descripció llarga: Agulla/Guia Nano Fx,per a nanoperforacions i per a estimulació de la medul·la òssia subcondral,de 23,5cm de longitud,de nitinol i d' acer inoxidable,punta d'atac de 9mm longitud x 1mm diàmetre,estèril ,lús.Comp/mànc i llengueta NanoFx o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 17 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 30040657
Descripció llarga: Equip de dos peces per a artroscòpia de maluc, consta: 1 per a zona perineal i 2 per a bota de tracció, no estèril, d'un sol ús. Com patible amb sistema de tracció de maluc		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 30040754
Descripció llarga: Broca canulada amb anima interna per a articulació amioclavicular, diàmetre 2,4mm, connexió rodona estàndard tipus Jacobs, acer inoxi dable, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 30040859
Descripció llarga: Cànula d'artroscòpia d'espàtlla, diàmetre de 6,5x 90mm+/-5mm, amb vàlvula ajustable i obturador, roscada, de plàstic molt resistent i translúcid, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 30040947
Descripció llarga: Terminal vaporitzador radiofreqüència bipolar, per procedi artroscòpics de genoll, angulació de 90°, Ø 3,75mm, cable integrat, d'acer inox i tungstè, estèril, d'un sol ús. Comp/generador radiofreqüència ArthroCare Quantum2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 30040949
Descripció llarga: Terminal vaporitzador-coagulador bipolar amb aspiració, p/procediments artroscòpics genoll, angulat 50°, Ø 3,75mm, 13cm+/-1cm long. cabl e integrat , acer inox i tungstè, estèril, ús. Compatible sistema Edge o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 30041212
Descripció llarga: Broca d'extracció de Ø 3.2 mm per a cargols de 2.6 a 3.2 mm diàmetre. Estèril, d'un sol ús. Per a mànec Operace o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 30041278
Descripció llarga: Adaptador per a cargol d'extracció Ø 2.0 mm, d'acer, estèril, d'un sol ús. Compatible sistema Operace o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 30041292
Descripció llarga: Fresa d'extracció 4 mm diàm, intercanviable i adaptable per cargols Ø 3.4-4mm, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible sist ema Operace o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 18 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 30041440
Descripció llarga: Terminal de vaporització/Ablador OPES (sist/electroquirúrgic procediments ortopèdics),bipolar,per a tall i coagulació, Ø 3,3mmx 110m m, 50°,estèril ,lús.Compat/consola-motor d'Arthrex o equ.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 30041441
Descripció llarga: Terminal de vaporització/Ablador OPES (sist/electroquirúrgic procediments ortopèdics),monopolar,per a tall i coagulació, 45°,estèril ,lús.Compat/consola-motor d'Arthrex o equ.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 30041442
Descripció llarga: Terminal vaporitzador Apollo, amb aspiració, bipolar, per a procediments artroscòpics, angulat 90°, amb cable integrat, d'acer inoxi dable i PTFE (politetrafluorotilè), estèril, d'un sol ús. Compatible consola-motor Apollo d'Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 30041502
Descripció llarga: Terminal motor per a ressecció de sinovial en petites articulacions en artroscòpia,Ø3,5mm x 13cm de llargària,connexió peça de mà de plàstic,tub intern i extern d'acer,no làtex,estèril,un sol ús.Compatible a/motors d'artroscòpia Arthrex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 30041635
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic,simple, adult. Mida 46x10 cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, t ub de 40 "/ 102 cm,Rang de pressió 100-475 mmHg, sense làtex, un sol ús,estèril.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 30041742
Descripció llarga: Llaç sutura QuickPass Lasso, per artroscòpia de teixits tous, corba 90° recta, d'acer inox, plàstic i nitinol, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 30041745
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mmx 74,5mm que es pot transformar en broca de 7mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 30041746
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mm que es pot transformar en broca de 7,5mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 19 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 30041747
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mmx 74,5mm que es pot transformar en broca de 8mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 30041748
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mmx 74,5mm que es pot transformar en broca de 8,5mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 30041749
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mmx 74,5mm que es pot transformar en broca de 9,0mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 30041750
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mmx 74,5mm que es pot transformar en broca de 9,5mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 30041751
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mm que es pot transformar en broca de 10mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 30041802
Descripció llarga: Equip de tall, compost de: regla flexible i serra, per a fixació en cirurgia toracolumbar posterior de fibra de carboni, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Carboclear o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 30041805
Descripció llarga: Agulla-guia per a cargol interferencial, de nitinol, de 1,2mm x 23cm+/-2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb cargol Biosure o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 30041967
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic, simple, adult. Mida 30x5 cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, tub de 40 "/ 102 cm, color. Lliure de látex, un sol ús, estèril.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 20 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 30041970
Descripció llarga: Terminal p/artroscòpia Incisor Plus,p/procediments artroscòpics genoll ,punta recta tallant-dentada a/finestra 4,5mmx18cm llarg,acer inox i policarbonat,color violeta,est,lús.Compatible amb motor i a/identificació en consola Dyonics o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 30041972
Descripció llarga: Pistola precarregada a/autocaptura Firstpass ST,p/procediments artroscòpia ,amb agulla corbada de nitinol de diàmetre 5,2mm,llargària de 162mm+/-10mm i obertura boca d'adherència del10mm,estèril,lús.Compatible amb sutures i cintes d'alta resistència		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 30041979
Descripció llarga: Aplicador plasma a baixa temperatura Flow 50°,p/proced/artroscòpics ,angulat 50°,Øeix 3,76mm,ex/distal 2,95mm ample,long treball 135mm,potència ablació mitjana i a/coagulació,cable integrat,est ,lús.Comp/generador plasma Werewolf o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 30041980
Descripció llarga: Equip d'instruments per a artroscòpia de maluc, consta de: 2 agulles guia de nitinol de 1,2mm, 2 agulles espinals de 17G (6"), regla , xeringa de 30cc amb connexió luer-look i retolador, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 30041982
Descripció llarga: Bisturi Samurai Full Radius, per a artroscòpia de maluc, recte, mànec fix ergonòmic, polivalent segons el pacient, per a procediment s de capsulectomia, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 30041984
Descripció llarga: Cànula introductora d'instrumental per a artroscòpia de maluc, ajustable, de diàmetre 8mm, llargària telescòpica de 4-5-6cm, amb por t per a irrigació, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 30042379
Descripció llarga: Bisturi per a artroscòpia de maluc,capsulotom corbat,Ø39mm x 252mm (±20mm) ,punta corba amb 15°d'angulació,mànec d'acer inoxidable,es tèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 30042615
Descripció llarga: Broca d'extracció petita de Ø 2.5mm per a cargols de 2.1 a 2.5 mm diàmetre.d'acer, Estèril,d'un sol ús.Per a mànec Operace o equival ent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 21 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 30042618
Descripció llarga: Fresa d'extracció 3.2mm intercanviable i adaptable per cargols Ø2.6mm titani i acer inoxidable. Estèril,d'un sol ús. Compatible sis tema Operace o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 30042622
Descripció llarga: Fresa d'extracció 4.5 intercanviable i adaptable per cargols Ø4.2mm titani i acer inoxidable. Estèril,d'un sol ús.Compatible Sistem a Operace petit o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 30042623
Descripció llarga: Fresa d'extracció 5.8 intercanviable i adaptable per cargols Ø4.7mm titani i acer inoxidable. Estèril,d'un sol ús.CompatibleSistema Operace petit o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 30042624
Descripció llarga: Fresa d'extracció 7.5 intercanviable i adaptable per cargols Ø6.0mm titani i acer inoxidable. Estèril,d'un sol ús.Compatible Sistem a Operace petit o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 30042630
Descripció llarga: Insertador per a botó per al sistema acromioclavicular o biceps distal ,d'acer inoxidable i plàstic, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 30042647
Descripció llarga: Equip per a la dilatació del psoas, compost de: dilatadors + palpador + agulles Kishner,per a inserció retractor i/o monitorització neurofisiològica en cirurgia columna vertebral intersomàtic lateral. Compatible amb sistema XLIFT o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 30042672
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols hexàgon interior Hex1.8,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 30042675
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 7,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 22 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 30042676
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 8,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 30042677
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 9,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 30042678
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 15,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 30042679
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 20,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 30042683
Descripció llarga: Cargol d'extracció Ø 2.6 mm,intercanviable. Estèril,d'un sol ús.Per a mànec Operace o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 30042684
Descripció llarga: Cargol d'extracció Ø 3,5 mm,intercanviable, estèril, d'un sol ús, per a mànec Operace o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 30042699
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols hexàgon interior Hex 5.0,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 30042700
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 25, caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 30042701
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 30,caixa d'osteosintesis sistema Operace, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 23 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1780	MATERIAL: 30042713
Descripció llarga: Cànula PassPort Button per a artroscòpia, de diàmetre 6mm x 3cm de llargària, de silicona flexible amb dues pestanyes de baix perfil i un separador de 5mm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1790	MATERIAL: 30042766
Descripció llarga: Passador de fils Micro Suture Lasso recte, llaç de nitinol, acer inoxidable i mànec de plàstic, per a la reparació de desgarraments perifèrics cubitals del disc articular (TFCC), estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1800	MATERIAL: 30042767
Descripció llarga: Agulla passador, per a artroscòpia de genoll, l'agulla travessa el fil de sutura, metàl·lica de nitinol, flexible, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pinça Scorpion d'Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1810	MATERIAL: 30042768
Descripció llarga: Terminal vaporitzador Apollo, sense aspiració, bipolar, per a procediments artroscòpics, angulat 90° (ganxo), amb cable integrat, d'acer inoxidable i PTFE (politetrafluorotilè), estèril, 1 ús. Comp/consola-motor Apollo d'Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1820	MATERIAL: 30042785
Descripció llarga: Terminal vaporitzador radiofreqüència bipolar per a procediments artroscòpics de maluc, Ambient HipVac 50 (ablació controlada, +/-3°), angulat 50°, Ø 4,7mm, cable integrat, acer inox, est, 1 ús. Comp/generador radiofreqüència ArthroCare Quantum2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1830	MATERIAL: 30043415
Descripció llarga: Cànula PassPort Button per a artroscòpia, de diàmetre 12mm x 3cm de llargària, de silicona flexible amb dues pestanyes de baix perfil i un separador de 5mm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1840	MATERIAL: 30043741
Descripció llarga: Equip de descompressió percutanea de cap femoral, canal de Ø6mm.x 295mm de llargària, compost de cànula, barra trocar i émbol, compatible amb sistema PERFUSE/BIOCUE, acer inox., esteril un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1850	MATERIAL: 30043789
Descripció llarga: Insertador per a botó per al sistema acromioclavicular, d'acer inoxidable i plàstic, per a sistema de fixació amb tecnologia ZipLoop, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 24 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1860	MATERIAL: 30043810
Descripció llarga: Terminal vaporitzador radiofreqüència bipolar,p/proced artroscòpics genoll ,angulat 50°,Ø 3,75mm,cable integrat,acer inox i tungstè.L liure làtex,est,lús.Ambient Super Multi Vac 50 IFS.Comp/generador radiofreqüència ArthroCare Quantum2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1870	MATERIAL: 30043811
Descripció llarga: Terminal - fresa p/artroscòpia Abrader- rodona,estriada,finestra amb fresa de 5,5mm x 18cm,procediments artroscòpics de maluc,resecc ió ràpida d'os ,d'acer inox.max rpm 8000,estèril,lús Compatible amb motor i a/identificació en consola Dyonics o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1880	MATERIAL: 30043812
Descripció llarga: Terminal vaporitzador Apollo, amb aspiració, bipolar, per a procediments artroscòpics, angulat 50°, amb cable integrat, d'acer inoxi dable i PTFE (politetrafluorotilè), estèril,1 ús. Compatible consola-motor Apollo d'Arthrex o equiv		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1890	MATERIAL: 30047499
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic,simple, adult. Mida 46x7,5 cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, tub de 40 "/ 102 cm.Rang de pressió 100-475 mmHg,Lliure de làtex, un sol ús,estèril.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1900	MATERIAL: 30047500
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia per a torniquet pneumàtic,simple, adult. Mida 76x10 cm, port únic amb connexió ràpida amb protecció de la zona, t ub de 40 "/ 102 cm.Rang de pressió 100-475 mmHg,Lliure de làtex, un sol ús,estèril.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1910	MATERIAL: 30047504
Descripció llarga: Llaç passador sutura Quickpass Lasso, de 45° corbada a la esquerra punta fina, per a artroscòpia d'espallla, llaç de nitinol, amb ca rgol/roda de seguretat, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1920	MATERIAL: 30047515
Descripció llarga: Sistema de reparació meniscal viper, per a procediments d'artroscòpia, amb sutura 2/0 UHMWPE i empenyedador de nusos, estèril, d'un so l ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1930	MATERIAL: 30047533
Descripció llarga: LLaç passador sutura SutureLasso, de 25° corbada tancada esquerra,per a artroscòpia d'espallla, filferro de nitinol, estèril, d'un s ol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 25 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1940	MATERIAL: 30048719
Descripció llarga: Equip/Sistema invers (extern-intern) de reparació meniscal Mender II ,p/procediments artroscòpia,de menisc anterior,amb:4 agulles esp inals (2 corbes i 2 rectes),4 guies/estilets i 2 bucles p/passar sutures,estèril,lús.Comp/Sistema Meniscus Mender II o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1950	MATERIAL: 30048857
Descripció llarga: Funda elàstica Ø 8x11cm d'inserció del clau de tibia per abordatge suprapatellar del sistema d'instrumental suprarrotulià(SPI) tibia T2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1960	MATERIAL: 30048858
Descripció llarga: Funda elàstica Ø 8x13cm d'inserció del clau de tibia per abordatge suprapatellar del sistema d'instrumental suprarrotulià(SPI) tibia T2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1970	MATERIAL: 30050186
Descripció llarga: Fulla de cisell 10mm d'amplada per a mànec enformador. Compatible amb mànec enformador Ref. FL665R d' Aesculap o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1980	MATERIAL: 30050537
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Full Radius Platinum,p/procediments artroscòpics menjadora teixits tous i os,punta recta i ampla finestra tal l a/ganiv/int/dent i ext/llisa,4,5mm,acer inox i policarbonat,est ,lús.Comp/motor Dyonics Powermax Elite o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 1990	MATERIAL: 30050747
Descripció llarga: Pistola precarregada a/autocaptura Firstpass MINI,p/procediments artroscòpia,amb agulla corbada de nitinol,amplada boca 4,1mmx12,5mm llarg ,llargària 236mm+/-20mm i llargària boca d'agafament superior a 21mm,estèril,lús.Comp/sutures i cintes # resistència		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2000	MATERIAL: 30051108
Descripció llarga: Equip de localització i introducció d'accés pedicular percutani,canulat per posicionament d'agulla Kirschner posterior, compost: 2 dilatadors + palpador, neuromonitorització NVMS en cirurgia columna vertebral Compatible amb sistema PRECEPT		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2010	MATERIAL: 30051133
Descripció llarga: Agulla-Pin iniciador punta roscada Ø3.2mm per accedir al centre del canal femoral, per clau intramedular femoral Orthopediatrics -P EDINAIL, acer, estèril, un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 26 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2020	MATERIAL: 30051134
Descripció llarga: Guia femoral llisa sense oliva Ø2.0mm per a introducció de clau al canal intramedul·lar femoral PEDINAIL, estèril , un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2030	MATERIAL: 30051135
Descripció llarga: Guia femoral punta oliva Ø2.7mm per a reducció i fresat de canal intramedul·lar femoral PEDINAIL, estèril , un sol ús.Ref: OPE.10.1500.006		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2040	MATERIAL: 30051316
Descripció llarga: Bisturi retràctil canulat per a artroscòpia, recte, de fulla tipus banana de 2,67cm, longitud de treball de 16,62cm, d'acer inoxidable i material plàstic, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2050	MATERIAL: 30051396
Descripció llarga: Equip d'instrumental per anclatge percutani FiberTak, amb: broca de 1,8mm, guia corbada i obturador punta roma. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2060	MATERIAL: 30051397
Descripció llarga: Equip d'instrumental per anclatge percutani FiberTak, amb: broca de 1,8mm, guia recta i obturador punta roma. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2070	MATERIAL: 30051399
Descripció llarga: Terminal motor dissector recte, resecció de teixit tou en artroscòpia de petites articulacions, de Ø3,0mm x 7cm de llargària, tub d'a cer inoxidable i connexió a peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, lús.Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2080	MATERIAL: 30051400
Descripció llarga: Terminal motor amb fresa rodona amb 10 estries, per a resecció de teixit tou en artroscòpia de petites articulacions, Ø 3,0mm x 7cm llarg, tub d'acer i connexió a peça de mà de plàstic, no làtex, estèril, lús. Compatible a/motor artroscòpia Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2090	MATERIAL: 30051589
Descripció llarga: Passador de tendons Shuttle, per a transposició tendinosa, cirurgia reconstructiva de lligaments mà- canell, peu-turmell, mida peti ta ,Ø1.5mmx 160mm longitud, material plàstic, lliure de làtex, estèril, un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 27 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2100	MATERIAL: 30051597
Descripció llarga: Passador de sutura per a artroscòpia i sistema pròtesi colze Latitud i Latitud Evolution,mà o petites articulacions,roscat 25 curt,a cer inox,cos proximal fi i llaç de filferro flexible distal,estèril,d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2110	MATERIAL: 30051634
Descripció llarga: Terminal motor Sabre resecció de teixit tou en artroscòpia petites articulacions, Ø 2mm x7cm de llargària,connexió a la peça mà de p làstic ,tub intern i extern d'acer inox,no làtex, estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'artroscòpia Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2120	MATERIAL: 30051638
Descripció llarga: Agulla passador de sutura, per a artroscòpia, l'agulla travessa el fil de sutura i la pinça, metàl·lica de nitinol, flexible, estèri l, d'un sol ús. Compatible amb pinça Mini Scorpion o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2130	MATERIAL: 30051765
Descripció llarga: Terminal p/artroscòpia Incisor Plus Elite,p/procediments artroscòpics genoll,tall ample-fula inter/dent,punta recta amb finestra 4, 5mm ,acer-polycarbonat,pissarra,estèril,1 sol ús.Compatible amb motor i a/identificació en consola Dyonics o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2140	MATERIAL: 30051824
Descripció llarga: Equip d'instrumental per a inserció d'ancoratge impactat de Mini SutureTak, consta:1 broca amb topall de Ø 1,8mm,1 broca amb topall de Ø 2mm,1gua de broca i 1 iniciador,acer inox,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2150	MATERIAL: 30051852
Descripció llarga: Equip instrumental ancoratge p/reconstrucció lligament col·lateral dit polze,CONSTA:3 agulles de Kirschner Ø1,35mm,1 broca canulada Ø3mm,1 broca canulada Ø3,5mm,1 guia broca a/topall profunditat,acer inox i mat/plàstic,estèril,lús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2160	MATERIAL: 30051853
Descripció llarga: Passador de fils Micro Suture Lasso corba petita amb llaç de nitinol, d'acer inoxidable i mànec de plàstic, per a la reparació artro scòpiques, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2170	MATERIAL: 30051856
Descripció llarga: Equip guies de perforació per a grapa de compressió contínua, cirurgia de peu,migpeu i retropeu, guies de 15,18,20,25,i 30mm,estèril ,sistema BME Elite o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 28 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2180	MATERIAL: 30051881
Descripció llarga: Equip d'instrumental per a artroscòpia de maluc, compost per: 3 agulles punció, 3 agulles guia de nitinol Ø1,1mm x38,5cm llargària, 1 bisturi tipus banana, 1 cànula oberta transparent punta cònica.Material de plàstic i d'acer,sense làtex,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2190	MATERIAL: 30051899
Descripció llarga: Cargol /pin per a distractor Caspar.Mida 70mm longitud total, 16mm longitud de treball, acer inoxidable, lliure de latex, estèril, u n sol ús. Compatible amb distractor Caspar FF891R /FF901R o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2200	MATERIAL: 30051900
Descripció llarga: Cargol /pin per a distractor Caspar.Mida 70mm longitud total, 12mm longitud de treball, acer inoxidable, lliure de latex, estèril, u n sol ús. Compatible amb distractor Caspar FF891R /FF901R o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2210	MATERIAL: 30052255
Descripció llarga: Pistola precarregada a/autocaptura FirstpassMINI,Esquerra,p/procediments artroscòpia,agulla corbada de nitinol,amplada boca 4,1mmx12 ,5mm llarg ,llargària 236mn+/-20mm i llargària boca agafament superi/a 21mm,estèril,lús.Comp/sutures i cintes # resistència		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2220	MATERIAL: 30052333
Descripció llarga: Broca Sistema artroscòpia de maluc Nano Tack, per a implant Nano Tack ,diàmetre 1,4mm. estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2230	MATERIAL: 30053022
Descripció llarga: Trefina canulada i pin amb vorell, per a artroscòpia,extracció teixit osterocondral i tunelitzar, de diàmetre 9mm,estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2240	MATERIAL: 30053164
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas 50-S Sweep,succió 90% forma d'ós entre l'elèctrode,punta distal emmotllable d'acer,9 nivells ablació,1 coag,133mm llarg treball,estèril,sol ús.Comp Serfas 50-S Sweep Crossfire2 o equiv.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2250	MATERIAL: 30053221
Descripció llarga: Broca-Pin per guia de precisió amb topall per a sistema pròtesi espatlla invertida Comprehensive,Ø2,7mm,acer inoxidable,estèril,un s ol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 29 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2260	MATERIAL: 30053222
Descripció llarga: Cargol per a guia de precisió sistema pròtesi espatlla invertida Comprehensive,acer inoxidable,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2270	MATERIAL: 30053223
Descripció llarga: Camisa-guia per a la guia de precisió sistema pròtesi espatlla invertida Comprehensive,Peek,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2280	MATERIAL: 30053231
Descripció llarga: Terminal vaporitzador Apollo XL90, amb aspiració, bipolar,per a procediments artroscòpics,angulat 90°,amb cable integrat,d'acer inoxidable i PTFE (politetrafluorotilè), estèril,d'un sol ús.Compatible consola-motor Apollo d'Arthrex o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2290	MATERIAL: 30053238
Descripció llarga: Equip compost per agulla guia de 2,4mm Ø ,broca canulada retrograda de7 ,5mm de diàmetre, i un recuperador de sutures (tub i monofila ment), d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Acufex TRUNAV o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2300	MATERIAL: 30053239
Descripció llarga: Equip compost per agulla guia de 2,4mm Ø ,broca canulada retrograda de8 ,0mm de diàmetre, i un recuperador de sutures (tub i monofila ment), d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Acufex TRUNAV o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2310	MATERIAL: 30053240
Descripció llarga: Equip compost per agulla guia de 2,4mm Ø ,broca canulada retrograda de8 ,5mm de diàmetre, i un recuperador de sutures (tub i monofila ment), d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Acufex TRUNAV o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2320	MATERIAL: 30053241
Descripció llarga: Equip compost per agulla guia de 2,4mm Ø ,broca canulada retrograda de9 ,0mm de diàmetre, i un recuperador de sutures (tub i monofila ment), d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Acufex TRUNAV o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2330	MATERIAL: 30053243
Descripció llarga: Equip compost per agulla guia de 2,4mm Ø ,broca canulada retrograda de 10 ,0mm de diàmetre, i un recuperador de sutures (tub i monofi lament), d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Acufex TRUNAV o equivalent		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 53 de 89

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 30 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2340	MATERIAL: 30053296
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia EEII complet.Mida 105cm de llarg, per a circumferència entre 30-60cm,PA <190mmHg, P dispositiu 319+62mmHg, codi d e color marró ,anell de silicona i roba de cotó i lycra,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2350	MATERIAL: 30053332
Descripció llarga: Màneg posicionador per a reparació meniscal, sistema ZoneNavigator,control de col.locació de sutura i agulla en increments d'1cm,erg onòmic,d'acer inoxidable, estèril,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2360	MATERIAL: 30053333
Descripció llarga: Passador de sutura SwiftStichs, per a artroscòpia de maluc, corbat crescent (mitja lluna), ganxo de nitinol,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2370	MATERIAL: 30053356
Descripció llarga: Cànula posicionadora mitja/posterior dreta reparació meniscal per a sistema ZoneNavigator,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2380	MATERIAL: 30053407
Descripció llarga: Cànula posicionadora anterior reparació meniscal per a sistema ZoneNavigator, d'acer inoxidable, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2390	MATERIAL: 30053408
Descripció llarga: Cànula posicionadora mitja/posterior esquerra reparació meniscal per a sistema ZoneNavigator,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2400	MATERIAL: 30053931
Descripció llarga: Cànula portal artroscòpia per a reparacions meniscals, 20,32cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2410	MATERIAL: 30054009
Descripció llarga: Broca de microfracturas PHOENIX, corba, punta relliscant amb boca de peix, 0,9mm diametro punta de broca,funció d'anell tope de la b roca per perforació segura, de 5mm de profunditat		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2420	MATERIAL: 30054091
Descripció llarga: Agulla-passador sutures, per a artroscòpia de maluc, amb rosca a la punta i el fil passa al voltant, acer inox i plàstic, per transp ort de sutura teixit tou,305mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pinça Passa-Sutures Scorpion o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 31 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2430	MATERIAL: 30054154
Descripció llarga: Punxa o pin bloquejador de 2mm de diàmetre, per posicionar o mantenir fragments d'os. Acer inox.1 sol ús.No esteril		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2440	MATERIAL: 30054423
Descripció llarga: Equip d'instrumental per anclatge FiberTak, compost per: broca de 2,6mm de diàmetre, guia recta i obturador punta roma,d'acer i plàs tic. Estèril.Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2450	MATERIAL: 30054472
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia pediàtric EEII complet. Mida 50cm de llarg, per a circumferència entre 14-28cm,PA <130mmHg, P dispositiu 197+/-24 mmHg, codi de color rosa,anell de silicona i roba de cotó i lycra,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2460	MATERIAL: 30054473
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia EEII complet. Mida 70cm de llarg, per a circumferència entre 24-40cm,PA <130mmHg, P dispositiu 215+/-24mmHg, codi de color verd ,anell de silicona i roba de cotó i lycra,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2470	MATERIAL: 30054474
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia EEII complet. Mida 95cm de llarg, per a circumferència entre 30-60cm,PA <130mmHg, P dispositiu 268+/-24mmHg, codi de color blau ,anell de silicona i roba de cotó i lycra,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2480	MATERIAL: 30054507
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia EESS complet. Mida 70cm de llarg, per a circumferència entre 24-40cm,PA <190mmHg, P dispositiu 235+/-23mmHg, codi de color groc ,anell de silicona i roba de cotó i lycra,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2490	MATERIAL: 30058417
Descripció llarga: Eq visualització artroscòpia mínimament invasiu compost per: peça de mà amb òptica Ø1,9mm, sensors d'imatge d'un 1mm, font de llum L ED, dues cànules d'irrigació, dos obturadors i dues vàlvules. Estèril,s/làt ,lús.Compatible amb NanoScope o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2500	MATERIAL: 30058663
Descripció llarga: Sistema de reparació menisc corb per a procediments d'artroscòpia Fast-Fix Flex compost per: agulla pre-carregada de 2 implants de P eek amb sutures no absorbibles calibre 2-0, cànula de aplicació i doblador,estèril,un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 32 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2510	MATERIAL: 30058666
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia EEII complet. Mida 120cm de llarg, per a circumferència entre 50-90cm,PA <160mmHg, P dispositiu 326+/-21mmHg, cod i de color blanc/negre, anell de silicona i roba de cotó i lycra,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2520	MATERIAL: 30058834
Descripció llarga: Barra de prova 290mm per a sistema ENNOVATE CERVICAL o equivalent, estèril d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2530	MATERIAL: 30058874
Descripció llarga: Broca d'ancoratge de sutura, de diàmetre 1,7mm (S) per a dispositiu d'inserció d'ancoratge ossi, sense làtex, estèril, d'un sol		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2540	MATERIAL: 30058905
Descripció llarga: Equip per a fresat intramedul·lar, longitud 520mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o e quivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2550	MATERIAL: 30058906
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 11,0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2560	MATERIAL: 30058907
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 10,0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2570	MATERIAL: 30058908
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 10,5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2580	MATERIAL: 30059460
Descripció llarga: Equip d'instrumental per anclatge percutani FiberTak, amb: broca flexible Ø1,8mm, guia corbada i obturador punta roma. Estèril. Un s ol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2590	MATERIAL: 30059535
Descripció llarga: Equip dilatadors i agulles Kirshner per a monitorització neurofisiologica intraoperatoria cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema NVM5 XLIFT o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 33 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2600	MATERIAL: 30059537
Descripció llarga: Equip per a sistema de fixació múltiple per a braç i mà , atraumàtic, ajustable, compost per: cingla de subjecció avantbraç, cingla per a biceps i 2 beines per a tracció de dits (atrapa dits / cazamuchachas),estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2610	MATERIAL: 30060083
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas 50-S Sweep XL,artroscòpia maluc,angulació de 50° amb succió potèn cia max 11W ,Ø3,5mm i 180mm de long de treball,Nivel tall 9 i coag 1,estèril,sol ús.Comp Serfas 50-S Sweep Crossfire2 o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2620	MATERIAL: 30060102
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Crossblade, de diamant,Ø4,0mm,procediments artroscòpics de maluc,resecció rapida d'os,d'acer inox.max rpm 12000,acer inoxidable,estèril,lús.Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2630	MATERIAL: 30060110
Descripció llarga: Divisor de cànula PassPort Button per a artroscòpia,de diàmetre 12mm, de policarbonat,per a mantenir vies d'accés independents dins la mateixa cànula,estèril, d'un sol ús.Compatible amb cànula de Ø12mm.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2640	MATERIAL: 30060146
Descripció llarga: Distractor ràpid MAX de clau Intramedul·lar per allargament d'extremitats, extensible per interacció magnètica,maneig intraoperatori ,velocitat de distracció 1500rpm, 7mm/minut. Estèril, d'un sol ús.Sistema Precice o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2650	MATERIAL: 30060201
Descripció llarga: Equip d'instrumental per a anclatge FiberTak,amb: 1 introductor recte ,broca Ø1,8mm i 1 obturador punta roma,d'acer i plàstic.Estèri l, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2660	MATERIAL: 30060269
Descripció llarga: Recipient amb doble ganiveta rebutjable per a processament d'os. Volumen màx 10cc. Amb espàtula per retirar os processat, estèril,un sol ús. Compatible amb MIDAS REX Bone Mill o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2670	MATERIAL: 30060298
Descripció llarga: Equip d'accés amb agulla introductora 17Gx 150mm, i agulla guia de nitinol Ø1,0x 450mm per sistema endoscòpia de columna Maxmore Spi ne,estèril,un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 34 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2680	MATERIAL: 30060299
Descripció llarga: Terminal de vaporització bipolar radiofreqüència plasma Ø2,4mm,longitud de treball 390mm+/-10mm,compatible amb procediments endoscòp ics d'abordatge transforamidal,interlaminar o descompresió de l'estenosi Maxmore Spine o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2690	MATERIAL: 30060325
Descripció llarga: Terminal motor amb dents, per a dissecció de teixits tous en procediments artroscòpics,Ø 4 mm x 13 cm de llargària, connexió a la pe ça de mà deplàstic, tub intern i extern d'acer, no làtex,estèril,1 ús. Compatible motors artroscòpia Arthrex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2700	MATERIAL: 30060400
Descripció llarga: Dispositiu de llum freda de fibra òptica per a camps quirúrgics profunds i cirurgia de columna vertebral,de plàstic amb adaptador per a cable il·luminador,estèril, un sol ús,lliure de làtex.Compatible amb cable il·luminador Spineart o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2710	MATERIAL: 30060497
Descripció llarga: Agulla/pin guia de 3,5mmx 74,5mm que es pot transformar en broca de 6,5mm de diàmetre, en un sol instrument, curta, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2720	MATERIAL: 30060554
Descripció llarga: Estilet per a localització pedicular,de Ø1.6mm Estèril, d' un sol ús. Compatibles amb sistema de navegació vertebral Viper Prime o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2730	MATERIAL: 30060589
Descripció llarga: Equip instrumental per sist endoscòpic transforamidal/interlaminar Maxmorespine o equivalent compost:agulla guia 1,5mm i 1mm,broca ò ssia manual 4,0mm,agulla de columna 17Gx150mm,coagulador esfèric 390mm ,bisturi,rotulador de pell i regla,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2740	MATERIAL: 30060665
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 11,5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2750	MATERIAL: 30060666
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 12,0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 35 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2760	MATERIAL: 30060667
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 12,5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2770	MATERIAL: 30060668
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 13,0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2780	MATERIAL: 30060669
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 13,5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2790	MATERIAL: 30060670
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 14,0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2800	MATERIAL: 30060671
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 14,5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2810	MATERIAL: 30060672
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 15mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2820	MATERIAL: 30060673
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 15,5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2830	MATERIAL: 30060674
Descripció llarga: Guia de fresat ø2.5x 950mm de longitud, punta oliva, estèril. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2840	MATERIAL: 30060702
Descripció llarga: Equip bàsic per a artroplàstia de cap de radi. Compost: mànec d'anclatge ràpid; 5 Sondes de 4,5-8,5; Implants de prova Ø19 (tija 5,5/6, 5 i 7,5mm), Ø22 (tija 5,5/6, 5/7,5, i 8,5) i Ø25mm (tija 6,5/7,5 i 8,5); 1 fresa; caps prova/separ Ø19,22 i 25mm, estèril, 1 sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 36 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2850	MATERIAL: 30060739
Descripció llarga:	Equip per a extracció d'os intramedul·lar, longitud 520mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2860	MATERIAL: 30060741
Descripció llarga:	Bisturi/Tenotomo per a extracció de plàstia de tendons,Ø 9mm,d'acer inoxidable i policarbonat,estèril,un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2870	MATERIAL: 30060742
Descripció llarga:	Bisturi/Tenotomo per a extracció de plàstia de tendons,Ø10mm,d'acer inoxidable i policarbonat,estèril,un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2880	MATERIAL: 30060746
Descripció llarga:	Agulla-guia per a cargol interferencial, de nitinol, de 1,2mm x 46cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb cargol Biosure o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2890	MATERIAL: 30060876
Descripció llarga:	Terminal motor amb dents Sabre per resecció de teixit tou en artroscòpia, Ø 3,5mm x 13cm de llargària,connexió peça de mà de plàstic ,tub intern i extern d'acer,no làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'artroscòpia Arthrex o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2900	MATERIAL: 30061018
Descripció llarga:	Guia de llum freda angulada de fibra òptica i alumini per a camps quirúrgics en cirurgia de columna vertebral,estèril, sol ús, lliure de làtex. Compatible amb sistema NVM5 XLIFT o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2910	MATERIAL: 30061457
Descripció llarga:	Estilet per a navegació pedicular de Ø1.6mm. Estèril, d' un sol ús. Compatibles amb sistema de navegació vertebral Viper Prime o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2920	MATERIAL: 30061851
Descripció llarga:	Tub intercanviador d'agulla guia,per a introducció de clau al canal intramedul·lar, estèril , un sol ús,Sistema Piccolo CarboFix ref :CBF.PFT912240	
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2930	MATERIAL: 30062093
Descripció llarga:	Cànula per procediments artroscòpia PassPort Button,Ø12mmx5cm,silicona flexible,dues pestanyes de baix perfil i separador de 5mm,est èril,un sol ús.	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 37 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2940	MATERIAL: 30062164
Descripció llarga: Equip d'instrumental per anclatge FiberTak, amb: broca de 1,8mmx25,6cm i obturador flexible. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2950	MATERIAL: 30062187
Descripció llarga: Bisturi Samurai Full Radius, per a artroscòpia de maluc, corb, mànec fix ergonòmic, polivalent segons el pacient, per a dissecció lab rum, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2960	MATERIAL: 30062337
Descripció llarga: Terminal vaporitzador Apollo, amb aspiració, bipolar per a procediments artroscòpics, angulat 50°, diàmetre de 4.5x185mm+/-10mm, amb cable integrat, d'acer inoxidable i PTFE (politetrafluorotilè), estèril,1 ús.Comp/console-motor Apollo d'Arthrex o equiv		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2970	MATERIAL: 30062590
Descripció llarga: Punta per a cànula de cimentació, metàl·lica, per a cargols sistema CD Horizon,Solera i Voyager 5,5/6,0 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2980	MATERIAL: 30062592
Descripció llarga: Broca d'ancoratge de sutura sense nusos, de diàmetre 2,2mm per a dispositiu d'inserció d'ancoratge ossi, d'acer,sense làtex, estèril , d'un sol		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 2990	MATERIAL: 30062610
Descripció llarga: Equip broques per a cargols Ø4,5mm, sistema ENNOVATE CERVICAL o equivalent, estèril d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3000	MATERIAL: 30062611
Descripció llarga: Equip 6 topalls de profunditat, sistema ENNOVATE CERVICAL o equivalent, estèril d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3010	MATERIAL: 30062612
Descripció llarga: Tornavis per a sistema ENNOVATE CERVICAL o equivalent, estèril d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3020	MATERIAL: 30062631
Descripció llarga: Terminal de vaporització bipolar radiofreqüència plasma Ø2,4mm,longitud de treball 390mm+/-10mm,compatible amb procediments endoscòpics d'abordatge transforamidal,interlaminar o descompresió de l'estenosi Maxmore Spine o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 38 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3030	MATERIAL: 30062635
Descripció llarga: Immobilitzador de dit (atrapa dits / cazamuchachas), de nylon amb cadena i ganxo a l'extrem distal, mida petita, diàmetre: 9,5mm, lo ngitud: 178mm+/-10mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb torre de tracció de canell de ARTHREX o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3040	MATERIAL: 30062637
Descripció llarga: Immobilitzador de dit (atrapa dits / cazamuchachas), de nylon amb cadena i ganxo a l'extrem distal, mida gran, diàmetre: 15,9mm, lon gitud: 178mm+/-10mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb torre de tracció de canell de ARTHREX o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3050	MATERIAL: 30062638
Descripció llarga: Immobilitzador de dit (atrapa dits / cazamuchachas), de nylon amb cadena i ganxo a l'extrem distal, mida extragran, diàmetre: 17,5mm , longitud:178mm+/-10mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb torre de tracció de canell de ARTHREX o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3060	MATERIAL: 30063590
Descripció llarga: Equip de pins de Ø3,15mm per a sistema ATTUNE INTUITON o equivalent inclou: un pin universal, un pin roscat amb cap, i un pin rosc at sense cap, estèril d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3070	MATERIAL: 30063591
Descripció llarga: Bisturi amb mànec contornejat, lama de 21mm,d'acer inoxidable i polipropilè,estèril,un sol ús. Sistema Everest MI i XT o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3080	MATERIAL: 30063685
Descripció llarga: Guia d'acer configuració 2 peces per a sistema espinal toracolumbar ,estèril,un sol ús. Compatible amb sistema Everest MI o equivalen t		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3090	MATERIAL: 30063686
Descripció llarga: Agulla per a accés pedicular per a sistema espinal toracolumbar, de 8G amb punta de diamant,estèril,un sol ús. Compatible amb sistem a Everest MI o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3100	MATERIAL: 30064016
Descripció llarga: Agulla-guia passador de fils amb llaç de nitinol, Ø1,4mm, d'acer inoxidable per a la reparació artroscòpiques, estèril, d'un sol ús, compatible amb sistema Microlink o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 39 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3110	MATERIAL: 30064132
Descripció llarga: Agulla-passador flexible sutures, per a artroscòpia d'espatlla, nitinol i plàstic, per transport de sutures,254mm+/-10mm, estèril, d 'un sol ús. Compatible amb pinça Passa-Sutures Scorpion o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3120	MATERIAL: 30065916
Descripció llarga: Agulla guia passador sutures artroscòpia,Ø2,4mm x 435mm+/-10mm de llargària amb ullal,acer inoxidable,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3130	MATERIAL: 30065962
Descripció llarga: Òptica artroscòpia mínimament invasiva per a petites articulacions, 125mm longitud, estèril, un sol ús, compatible amb consola NanoS cope o similar		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3140	MATERIAL: 30065963
Descripció llarga: Equip cànules artroscòpia, mínimament invasiva per a petites articulacions, d'alt fluxe,compost per: cànula recta, cànula angulada 1 0° amb obturadors de Ø3,3mm,125mm longitud i clau de pas, estèril, un sol ús ,compatible amb òptica NanoNeedle o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3150	MATERIAL: 30065988
Descripció llarga: Equip instrumental per a ostotomia de Weil,Ø2mm,compatible amb cargols Snapp-Off o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3160	MATERIAL: 30066156
Descripció llarga: Component adaptador per a cargol per a sistema de fixació toraco lumbar.Compatible amb sistema CD HORIZON/SOLERA o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3170	MATERIAL: 30066212
Descripció llarga: Empenyedor de cànula per a cargols fenestrats de sistema pròtesi columna toracolumbar Everest MI, per a subministrament de ciment, e stèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3180	MATERIAL: 30066226
Descripció llarga: Bisturi/Tenotomo per a extracció de plàstia de tendons,Ø 8mm,d'acer inoxidable i policarbonat,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3190	MATERIAL: 30066227
Descripció llarga: Agulla lliscant passadora de sutures, de 30° recta, color verd clar, estèril, d'un sol ús. Compatible llançadora lliscant-filferro d e nitinol (Ref:3910-500-761 i mànec Ref:3919-500-750 del Sistema Lliscant Champion o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 40 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3200	MATERIAL: 30066489
Descripció llarga: Equip broques per a cargols Ø5,5mm, sistema ENNOVATE CERVICAL o equivalent, estèril d'un sol ús,SZ121SU		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3210	MATERIAL: 30066808
Descripció llarga: Terminal - fresa d'artroscòpia Crossblade, de diamant,Ø5,5mm,procediments artroscòpics de maluc,resecció rapida d'os,d'acer inox.max rpm 12000,acer inoxidable,estèril,lús.Compatible amb motor i amb identificació en consola Stryker o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3220	MATERIAL: 30066809
Descripció llarga: Terminal vaporitzador per radiofreqüència bipolar elèctrode Serfas 50-S corb/50°, a/succió,c/manual,artroscòpia genoll-maluc,1lniv/a blació i 3/coagul,a/detec/impedància,Ø3,5mmx33cm llarg,cable incorporat,est ,lús.Compatible a/consola Crossfire o equ		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3230	MATERIAL: 30067775
Descripció llarga: Terminal de vaporització amb succió per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, 90° i 150mm+/-10mm de llargària. Sis tema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3240	MATERIAL: 30067776
Descripció llarga: Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, 70° i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS B iportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3250	MATERIAL: 30067777
Descripció llarga: Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral,tija corba,punta 45° i 150mm+/-10mm de llargària . Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3260	MATERIAL: 30067787
Descripció llarga: Instrument per a tall tipus pit bull Ø4,0 x 130mm de llargària, estèril,un sol ús.Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3270	MATERIAL: 30068142
Descripció llarga: Separador-protector quirúrgic ortopèdic 360°,cèrcol superior rigid inferior flexible,incisió 2,5-7cm,llarg membrana 14-15cm forma cò nica ,auto-retracció,cèrcol fixació i distensió,subjec automàtica,polièster-PUR laminat color púrpura,n/làtex/DEHP,est,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 41 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3280	MATERIAL: 30068143
Descripció llarga: Separador-protector quirúrgic ortopèdic 360°,cèrcol superior rígid inferior flexible,incisió 2,5-8cm,llarg membrana 14-15cm forma re cte ,auto-retracció,cèrcol fixació i distensió,subjec automàtica,polièster-PUR laminat color púrpura,n/làtex/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3290	MATERIAL: 30068144
Descripció llarga: Separador-protector quirúrgic ortopèdic 360°,cèrcol superior rígid inferior flexible,incisió 2,5-8cm,llarg membrana 14-15cm forma cò nica ,auto-retracció,cèrcol fixació i distensió,subjec automàtica,polièster-PUR laminat color púrpura,n/làtex/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3300	MATERIAL: 30068145
Descripció llarga: Separador-protector quirúrgic ortopèdic 360°,cèrcol superior rígid inferior flexible,incisió 5-13cm,llarg membrana 17-18cm forma cò n ica ,auto-retracció,cèrcol fixació i distensió,subjec automàtica,polièster-PUR laminat color púrpura,n/làtex/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3310	MATERIAL: 30068146
Descripció llarga: Separador-protector quirúrgic ortopèdic 360°,cèrcol superior i inferiorflexible,incisió 2,5-7cm,llarg membrana 14-15cm forma cò nica, auto-retracció,cèrcol fixació i distensió,subjec automàtica,polièster-PUR laminat color púrpura,n/làtex/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3320	MATERIAL: 30068216
Descripció llarga: Dispositiu de llum freda de fibra òptica per a camps quirúrgics profuns i cir.espinal menys invasiva, amb adaptador per a cable il·l uminador ,estèril,un sol ús,lliure de làtex.Compatible amb separador lateral Otelo MIS de Spinart o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3330	MATERIAL: 30068369
Descripció llarga: Guia/cànula per a cargols fenestrats de sistema pròtesi columna toracolumbar Everest MI, Ø10G, punta bisellada, per a subministramen t de ciment, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3340	MATERIAL: 30068389
Descripció llarga: Cànula d'artroscòpia d'espatlla, diàmetre de 8,0mm i 90mm de llargària, amb vàlvula ajustable i obturador, roscada, de plàstic molt resistent i translúcid, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3350	MATERIAL: 30068440
Descripció llarga: Agulla-Guia per a artroscòpia de genoll,per a reconstrucció del lligament creuat anterior (LCA),Ø4,0mm amb ullal tancat per enfilear la sutura,d'acer inoxidable,estèril,lús.Compat/Sistema TightRope o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 42 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3360	MATERIAL: 30068447
Descripció llarga: Equip per a sistema de fixació per a luxacions acromi-clavicular tècnica ZipLoop compost per: Agulla guiaØ2,4mm,broca anulada Ø4,5mm , agulla kirschner Ø2,4mm i aplicador. Sistema Zip Tight o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3370	MATERIAL: 30068849
Descripció llarga: Clip DSC de connexió del sistema de monitorització al instrumental quirúrgic per al control neurofisiològic intraoperatòri per cirurgies de columna vertebral provist d'electrodes, compatible amb sistema NVM5 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3380	MATERIAL: 30069654
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16.0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3390	MATERIAL: 30069655
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16.5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3400	MATERIAL: 30069656
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 17.0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3410	MATERIAL: 30069657
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 17.5mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3420	MATERIAL: 30069658
Descripció llarga: Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 18.0mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA2		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3430	MATERIAL: 30070016
Descripció llarga: Broca canulada amb cap per a creació de túnels ossis en reparació artroscòpica o oberta,diàmetre 5mm, d'acer inoxidable,no estèril,u n sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3440	MATERIAL: 30070017
Descripció llarga: Broca canulada amb cap per a creació de túnels ossis en reparació artroscòpica o oberta,diàmetre 6mm, d'acer inoxidable,no estèril,u n sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 43 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3450	MATERIAL: 30070642
Descripció llarga: Cànula per a artroscòpia d'espatlla, amb aletes expandibles, de diàmetre int 8,25mm x 90mm de llargària, amb obturador, per a mantenir accés a l'articulació durant el procediment, estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3460	MATERIAL: 30070643
Descripció llarga: Equip tracció/estabilització axial encoixinat, per a artroscòpia d'espatlla, per a traccionar lateral, de niló i poliuretà, estèril, d'un sol ús. Compatible amb torre de tracció d'espatlla (Holder) o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3470	MATERIAL: 30070742
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Cuda, per tall i resecció de teixit tou i os de petites articulacions, Ø 2,0mm x 8cm long, base de plàstic i tija d'acer, velocitat màxim 6.000rpm, no làtex, estèril, 1 ús. Comp/a/motors Ergo, Apex, Advantage, Advantage Turbo o eq		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3480	MATERIAL: 30070743
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 4, caixa d'osteosíntesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3490	MATERIAL: 30070744
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 5, caixa d'osteosíntesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3500	MATERIAL: 30070745
Descripció llarga: Punta tornavis per retirada de cargols Torx i Stardrive T 6, caixa d'osteosíntesis sistema Operace, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3510	MATERIAL: 30070746
Descripció llarga: Tròcar per a clau intramedul·lar tibial de diàmetres 8-11mm, petit, per a abordatge suprapatel·lar. Compatible sistema TNA o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3520	MATERIAL: 30071170
Descripció llarga: Aplicador plasma a baixa temperatura Flow 90°, p/proced/artroscòpics, angulat 90°, Øeix 3,76mm, ex/distal 2,95mm ample, long treball 130-140mm, potència ablació mitjana i a/coagulació, cable integrat, est, 1ús. Comp/generador plasma Werewolf i Flow IQ o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PAGINA: 44 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3530	MATERIAL: 30071174
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Full Radius Elite,p/procediments artroscòpics menjadora teixits tous i os,punta recta ,4,5mm,lliure de làtex, estèril ,lús.Compatible sistema Dyonics Power II o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3540	MATERIAL: 30071175
Descripció llarga: Terminal d'artroscòpia Full Radius Elite,p/procediments artroscòpics menjadora teixits tous i os,punta recta ,5,5mm,lliure de làtex, estèril ,lús.Compatible sistema Dyonics Power II o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3550	MATERIAL: 30071176
Descripció llarga: Fresa d'artroscòpia Acromionizer,menjadora d'os i polidora,per a procediments d'Acromioplàstia(SAD),Ø 4,0mm,treb/màxim 10.000rpm,Lli ure de làtex,estèril, un sol ús.Comp/peça de mà i consola Dyonics Power i Dyonics Power II o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3560	MATERIAL: 30071777
Descripció llarga: Agulla guia punta broca Ø2,4x311mm , acer, estèril.Ref; AR1250LS		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3570	MATERIAL: 81001905
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 1 tub, una càmera. Mida braçal aprox 61cm+/-2cm x 10cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Comp atible amb ATS 2200 o equivalent. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3580	MATERIAL: 81002045
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 1 tub, una càmera. Mida braçal aprox 86cm+/-2cm x 10cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Comp atible amb ATS 2200 o equivalent. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3590	MATERIAL: 81002048
Descripció llarga: Manegot d'isquèmia simple cònic per a braç per a torniquet pneumàtic, mides aproximades de 65 cm llargària i 12 cm d'amplada, amb ta ncament de veta adherent i corretja. Lliure de làtex, autoclavable.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3600	MATERIAL: 81002373
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 2 tubs, una càmera. Mida braçal aprox 30cm x 10cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Compatibl e amb ATS 4000 equivalent. Lliure de làtex		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 45 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3610	MATERIAL: 81002374
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 2 tubs, una càmera. Mida braçal aprox 30cm x 9,0cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Compatible amb ATS 400 o equivalent. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3620	MATERIAL: 81002375
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 2 tubs, una càmera. Mida braçal aprox 46cm+/-2cm x 10,0cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Compatible amb ATS 4000 o equivalent. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3630	MATERIAL: 81002376
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 2 tubs, una càmera. Mida braçal aprox 86cm+/-2cm x 10,0cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Compatible amb ATS 4000 o equivalent. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3640	MATERIAL: 81002377
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 2 tubs, una càmera. Mida braçal aprox 107cm+/-2cm x 10,0cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Compatible amb ATS 4000 o equivalent. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3650	MATERIAL: 81002415
Descripció llarga: Manegot isquèmia complet per a torniquet pneumàtic digital, 1 tub, mida cambra 52cm x 7cm, contorn braçal >30cm <45cm. Rang de pressió 100-400mmHg (+/-2% precisió). Connexió luer o equivalent. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3660	MATERIAL: 81002431
Descripció llarga: Manegot isquèmia complet per a torniquet pneumàtic digital, 1 tub, mida cambra 46cm x 11cm, contorn braçal >23cm <39cm. Rang de pressió 100-400mmHg (+/-2% precisió). Connexió luer o equivalent. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3670	MATERIAL: 81002433
Descripció llarga: Manegot isquèmia complet per a torniquet pneumàtic digital, 1 tub, mida cambra 61cm+/-2cm x 11cm, contorn braçal >39cm <54cm. Rang de pressió 100-400mmHg (+/-2% precisió). Connexió luer o equivalent. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3680	MATERIAL: 81002610
Descripció llarga: Braçal isquèmia complet, per cama, 1 tub. Mida braçal 107cm +/-2cm. Rang de pressió fins a 600mmHg (+/-2% precisió). Compatible amb torniquet VBM 2x500ELC/230. Reutilitzable.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 01.12.2025 HORA: 08:12:34 PÀGINA: 46 / 46
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3690	MATERIAL: 81002611
Descripció llarga: Braçal isquèmia complet, infantil, 1 tub. Mida braçal 30cm +/-2cm. Rang de pressió fins a 600mmHg (+/-2% precisió). Compatible amb t orniquet VBM 2x500ELC/230. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3700	MATERIAL: 81002612
Descripció llarga: Braçal isquèmia complet, per nadó, 1 tub. Mida braçal 20cm +/-2cm. Rangde pressió fins a 600mmHg (+/-2% precisió). Compatible amb to rniquet VBM 2x500ELC/230. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3710	MATERIAL: 81002768
Descripció llarga: Exanguinador tipus maneguet per a cama i braç, previ a l'aplicació de torniquet, pressió inflat constant.Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101454545	POSICIÓ: 3720	MATERIAL: 81002829
Descripció llarga: Manegot isquèmia recte complet, 2 tubs, una càmera. Mida braçal aprox 61cm x 10cm. Ports col.locats a 90°, connectors PLC. Compatibl e amb ATS 4000 equivalent. Lliure de làtex		



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101454545_2bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 71 de 89

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma
electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 72 de 89

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101454545_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR, en aquest cas només s'ha omplir la pestanya Oferta.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
13						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimnt hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cónica,flexible i angulara,longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BN186RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 73 de 89

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 74 de 89



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 75 de 89

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101454545.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101454545 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 76 de 89

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 77 de 89

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 78 de 89

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/11014545/26/AMUP	Subministrament agregat d' Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics. Artroscòpia, Cirurgia Traumatològica i Toràcica		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom		Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)			
Altres acreditacions i/o auto certificació Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnidy_pag1.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 79 de 89



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 80 de 89

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 81 de 89

ANNEX D2 LLISTAT RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. Expedient

CS/CC00/1101454545/26/AMUP

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 82 de 89



ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 83 de 89



**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101454545/26/AMUP**

Lot 15 -Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, 1 sol ús compatible amb sistema Arthrex o equivalent
Lot 16-Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, 1 sol ús comp a/sistema Smith&Nephew o equivalent
Lot 17- Agulles-Broques per a artroscòpia i navegació, 1 sol ús compatible amb sistema Stryker o equivalent

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Flexibilitat de l'agulla/pin guia: absència de rigidesa i deformatat. La deformatat pot afectar la precisió, seguretat i eficàcia de la cirurgia, una agulla deformada pot no encaixar correctament, pot provocar danys als teixits o dificultar la manipulació

Lot 33 - Separadors, retractors protectors cirurgia traumatològica d'un sol ús.

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Que l'anell de retracció flexible del protector ortopèdic permeti la conformitat anatòmica.

Que l'anell rígid del protector ortopèdic permeti una exposició òptima de la capsula articular.

NO HI HA UN MODEL DE DOCUMENT ESPECIFIC. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb la documentació i/o resums amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada

Per veure que es demana de forma ampliada, veure ANNEX 4 del PCAP.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 84 de 89





ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 86 de 89



S'ha d'omplir l'Excel **ANNEX_D4_1101454545**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya "**Pestanya proveïdor**" té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 87 de 89

2.1. Dades NO modificables de la pestanya Lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia.TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia.TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sí/cosí, zona crítica. Mida L, llarg 142cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	Sí	Sí	Sí	No

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la “pestanya del lot” de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30034110	Emulsió amb àcid
Proveïdor	LOT 27 LOT 28



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 88 de 89



Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

No es necessària la presentació de mostres.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
01/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06QCKXF2WUYZZ8BNI86RNQ9Y46HTO9NU

Data creació còpia:
11/12/2025 11:06:11

Pàgina 89 de 89