



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL MOBILIARI I COMPONENTS DELS MAGATZEMS PERIFÈRICS AMB SISTEMA "DOBLE CALAIX" DELS DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA.

EXPEDIENT CSMS 1/26-D

(IMP-SC-006)



INDEX

1.- OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT	3
2.- CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES MÍNIMES DE L'EQUIPAMENT	5
3.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS	5
4.- NORMATIVA OBLIGATÒRIA	7
5.- MOSTRES.....	7
6.- CONDICIONS DE LLIURAMENT I TRANSPORT	8
7.- MANTENIMENTS I REPOSICIONS EN GENERAL	9
8.- CONFIGURACIÓ DE L'OFERTA	9
Annex II PPT: "Plànols zona d'actuació"	11



1.- OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT

El present contracte de subministrament per una període de duració de 2 anys i amb comandes successives, té per objecte el disseny, adquisició, instal·lació i posada en funcionament de nous mòduls d'emmagatzematge perifèric de doble calaix, així com la renovació, adequació i estandardització dels mòduls existents en diferents àrees de l'hospital Sant Jaume de Calella per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

1.1 Àmbit d'aplicació

L'abast del contracte inclou, de forma no limitativa:

- Dissenyar els magatzems perifèrics de les plantes tenint en compte el material a situar en aquests, l'espai disponible, la freqüència de reposició i altres elements necessaris per a un òptim aprofitament.
- El subministrament de mobiliari específic (mòduls estàndard o mobles a mida) i els components necessaris (cistelles, separadors, suports d'etiquetes d'identificació de producte, etc..) per a emmagatzematge de doble calaix, conforme a les especificacions tècniques detallades en els plec del concurs i en compliment amb norma ISO corresponent.
- La retirada i desinstal·lació, si és el cas, de mobiliari obsolet o incompatible amb el nou sistema.
- La instal·lació, ancoratge i anivellament dels nous mòduls d'emmagatzematge en els espais designats per cada servei.
- La integració dels mòduls amb els sistemes de reposició existents, garantint la seva funcionalitat immediata.
- L'estandardització del sistema de doble calaix conforme a criteris tècnics (Annex I del PPT) homogenis quant a dimensions, materials, accessibilitat, ergonomia i neteja.
- El manteniment i garantia mínima del mobiliari establerta legalment per qualsevol defecte o avaria.

Aquest contracte té caràcter de subministrament amb instal·lació, no constituint obra, i es regirà per la normativa aplicable en matèria de contractació del sector públic. D'acord amb aquesta normativa, al incloure també el servei de disseny previ es pot catalogar com a contracte mixt on la part més important del contracte és la del subministrament.

Els treballs d'instal·lació i adequació es coordinaran amb la persona que designi el centre per a minimitzar la interferència amb l'activitat assistencial.

1.2 Configuració del pressupost màxim de licitació:

A l'efecte de facilitar l'execució, seguiment i control econòmic del contracte, s'ha optat per estructurar el subministrament en un únic lot, dins del qual es desglossen els pressupostos màxims associats a cada planta, unitat o servei hospitalari que serà objecte d'intervenció.



El desglossament i l'assignació pressupostaria a cada un dels magatzems s'ha realitzat conforme a una anàlisi prèvia de preus de mercat, necessitats dels serveis i tenint en compte la superfície útil disponible, el volum de consums, i les característiques operatives de cada unitat.

En aquest sentit, cada "objecte" indicat en la següent taula es refereix a la instal·lació de noves estructures, ampliacions i actualitzacions (aprofitament de mobles i estructures ja existents) del sistema d'emmagatzematge perifèric de doble calaix, amb els seus elements estructurals i tots els accessoris necessaris.

A la columna "tipus intervenció" es detalla l'abast de la intervenció a realitzar en cada servei.

CODI OBJECTE	OBJECTE	TIPUS INTERVENCIÓ	PREU MAX S/IVA	PREU TOTAL AMB IVA
1	Magatzem Urgències PL0	Nou mobiliari	15.628,97 €	18.911,05 €
2	Magatzem Urgències - Fàrmacs	Nou mobiliari	3.258,32 €	3.942,57 €
3	Magatzem UPO - Fàrmacs	Nou mobiliari	2.417,29 €	2.924,92 €
4	Magatzem PL1	Actualització mobiliari i ampliació	5.349,71 €	6.473,15 €
5	Magatzem PL2	Actualització mobiliari i ampliació	5.349,71 €	6.473,15 €
6	Magatzem PL3	Actualització mobiliari i ampliació	6.455,31 €	7.810,93 €
7	Magatzem PL4	Actualització mobiliari i ampliació	6.455,31 €	7.810,93 €
8	Magatzem Sala de Proves	Nou mobiliari	1.606,80 €	1.944,23 €
9	Magatzem CCEE	Nou mobiliari	5.519,09 €	6.678,10 €

IMPORT MÁXIM DE LICITACIÓ = 52.040,51 € s/iva (62.969,02 € iva inclòs)

1.3 Plànols en vista en planta de la zona d'actuació:

Amb la finalitat de facilitar la correcta interpretació dels treballs a realitzar, el present plec incorpora, com a **Annex II al PPT els "Plànols zona d'actuació"**, la documentació gràfica corresponent als plànols generals de la planta, així com als plànols detallats de la zona objecte de la instal·lació dels magatzems de doble calaix, representats en vista en planta.



La documentació inclosa en l'esmentat annex **té caràcter merament orientatiu** i no eximeix el contractista de la correcta execució dels treballs objecte del contracte.

Així mateix, un cop publicada la licitació, es fixaran un o varis dies de visita, amb la suficient antelació respecte al termini de presentació d'ofertes, per tal de que els licitadors puguin veure els espais on s'haurà d'instal·lar el mobiliari per facilitar les tasques d'elaboració del disseny. La visita serà d'obligat compliment i no acreditar haver-la realitzat serà motiu d'exclusió del procediment.

El dia, hora i lloc de trobada de la visita o visites, seran publicats a l'espai d'avisos del perfil de contractant de l'entitat contractant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

2.- CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES MÍNIMES DE L'EQUIPAMENT

Les característiques tècniques són les que s'indiquen a l'annex I del present plec de prescripcions tècniques i s'han d'entendre com a mínimes. Per tant, s'acceptarà com a vàlida qualsevol proposició tècnica que iguali o augmenti les prestacions indicades, sempre que no superi el preu màxim de licitació total ni els preus unitaris base de licitació per objecte o servei.

El licitador, que en la seva oferta incompleixi alguna de les especificacions mínimes d'aquest plec, serà exclòs de la licitació. Davant la falta d'informació o la informació incompleta sobre el compliment d'aquestes característiques mínimes la CSMS requerirà un aclariment a l'empresa licitadora. En cas de que no es respongui el requeriment en termini, o persisteixi la poca claredat o manca d'informació completa, el licitador serà exclòs.

L'import de la licitació indicat en l'apartat anterior inclou tots els costos que el licitador haurà de realitzar per garantir el compliment del contracte en els termes descrits en aquest plec, inclosos, disseny, fabricació, el transport, la instal·lació de l'equip, la garantia per un mínim de 2 anys, i altres costos generals i tota classe de tributs i taxes en vigor, així com els que s'estableixin o modifiquin durant la vigència del contracte, i l'Impost del Valor Afegit (IVA).

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament, com a mínim durant els següents 10 anys a la data d'adquisició.

Si en la descripció s'utilitzés algun nom i/o referència subjecte a propietat comercial, haurà d'entendre's com a referència per a localitzar el/els equip/s en qüestió sense que en cap cas sigui obligatori oferir aquest equip.

3.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS

3.1. Les especificacions tècniques concretes dels objectes del subministrament es defineixen en el document anomenat "**Característiques Tècniques Mínimes**" (Annex I del PPT), Es tracta d'un arxiu en format Microsoft Office Excel (*.xls).

En aquest document es detallen tots els requeriments tècnics mínims que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar.

Tal i com s'indica en el quadre de característiques del contracte, totes les característiques tècniques que es detallen, o les condicions de servei tècnic i/o manteniment són d'obligat compliment.



Nota: en la columna “**Índex documental**”, i per a cadascuna de les corresponents files, caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofert així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment oferts (per exemple: catàleg del producte, pàg. XX del document memòria tècnica,...)

La complementació d'aquest document annex I és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o no admissió de la proposta.

Juntament amb el document Annex I del PPT, s'haurà de presentar la següent documentació:

- **Fitxa tècnica** de cadascun dels articles oferts, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a l'annex I del PPT, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels productes oferts.
- **Manual d'instal·lació** (si aplica).
- **Document descriptiu** de les dades de servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles oferts, per als productes on així s'indiqui en la seva fitxa tècnica.
- **Certificats de qualitat i homologacions.**
- **Restant documentació:** condicions de muntatge, instal·lació i altres productes, quan així es requereixi en l'annex I del PPT.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

Aquesta documentació s'haurà d'aportar al sobre B d'oferta i s'haurà d'ometre qualsevol informació referent a les valoracions incloses al sobre C.

El document Annex I del PPT haurà de ser degudament complimentat i presentat en excel i en pdf degudament signat digitalment pel representant legal de la licitadora.

3.2 Requisit Tècnic Obligatori: Presentació del Disseny del Sistema d'Emmagatzematge

Com a part de la documentació tècnica a presentar en l'oferta, serà obligatori lliurar un document que inclogui el disseny detallat del sistema d'emmagatzematge de doble calaix dissenyat, el qual ha de contenir com a mínim els següents elements:

- Plànols del disseny tècnic (en format PDF i editable, CAD o similar), que incloguin:



- Vista general del sistema proposat.
- Dimensions detallades.

- Distribució i configuració dins de l'espai assignat a l'hospital.
- Imatges o renders 3D del disseny proposat.

- Relació del material a subministrar per cada servei
 - Relació dels components necessaris pel muntatge com són el número de mòduls, número de cistelles a subministrar **(no incloure preus)**.

La no presentació d'aquest document en els termes requerits, comportarà l'exclusió de la proposta per incompliment dels requisits tècnics obligatoris.

4.- NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Tots els productes, objecte del present expedient, han de reunir les condicions per a la seva posada en servei i utilització, venda en el mercat espanyol, a més del total compliment de la normativa espanyola i europea vigent que sigui aplicable, sent així mateix de total responsabilitat del licitador l'obtenció dels certificats de marcat i de declaració de conformitat CE corresponents, si escau.

Aquesta documentació, s'haurà d'incloure en el sobre B d'oferta i serà part necessària perquè l'oferta pugui ser tinguda en consideració.

5.- MOSTRES

Una vegada obert el sobre B de les ofertes, les empreses licitadores, previ requeriment del departament de compres de la CSMS, hauran de presentar les mostres que es defineixen a continuació:

- Una cistella ISO de fons de 10cm, i una cistella de fons de 20 cmts.
- Mínim d'un separador de 60 i un de 40 per les 2 cistelles del punt anterior
- 2 porta-etiquetes i sistema de subjecció si es cau.

Un cop requerides, les empreses disposaran de 10 dies naturals per a presentar les mostres, a comptar des del dia següent a l'enviament del requeriment per correu electrònic.

L'enviament del requeriment es realitzarà al correu electrònic de contacte facilitat per les empreses licitadores en el document de Dades Complementàries.

El lliurament de les mostres es realitzarà en horari de 9:00 a 14:00 al departament de compres de l'Hospital Sant Jaume de Calella de la CSMS

A aquests efectes l'Hospital Sant Jaume de Calella es troba ubicat a Calella, carrer Sant Jaume 209-217 (08370).



La presentació de les mostres és condició essencial per a participar en la present licitació. La no presentació de mostres en el termini atorgat a l'efecte, suposarà el desistiment i exclusió del procediment de licitació.

Les mostres hauran d'ajustar-se a les característiques mínimes exigides en les prescripcions tècniques d'aquest plec.

Tot residu o rebuig originat com a conseqüència de l'actuació dels licitadors en el lliurament o retirada de les mostres pel proveïdor serà responsabilitat dels mateixos. En aquest sentit, seran a càrrec dels licitadors, la recollida i eliminació dels corresponents residus d'acord amb la normativa que sigui aplicable a cada cas.

Qualsevol desperfecte dels productes de mostra, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec del licitador.

6.- CONDICIONS DE LLIURAMENT I TRANSPORT

El proveïdor haurà de realitzar els lliuraments únicament quan el centre emeti una ordre de comanda formal, detallant les quantitats, objecte, centre destinatari de la mercaderia (que serà l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella), el preu segons contracte, i el número d'expedient.

6.1- Transport i muntatge

El material es lliurarà en perfectes condicions d'embalatge. Prèviament el proveïdor ha d'assegurar amb la CSMS que el transport seleccionat pel lliurament sigui l'adequat pels accessos, la càrrega o descarrega al Centre.

L'adjudicatari serà responsable del transport, descàrrega, muntatge i posada en marxa completa del sistema d'emmagatzematge de doble calaix al lloc establert en el disseny previ i segons el plànol de muntatge de l'oferta, incloent tots els materials, eines i personal necessaris.

Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec de l'adjudicatari.

Un tècnic o responsable designat per l'hospital realitzarà la supervisió directa del muntatge i la verificació de la correcta instal·lació de tots els elements. Aquesta revisió inclourà:

- Comprovació de l'estat físic dels materials.
- Adequació a les especificacions tècniques presentades en el projecte.
- Funcionament correcte dels mecanismes (calaixos, guies, frens, etc.).
- Ubicació exacta segons el plànol aprovat.

En cas que es detecti la manca de qualsevol component, defectes d'instal·lació o la necessitat de modificacions posteriors per garantir el correcte funcionament del sistema, el proveïdor haurà d'assumir íntegrament els costos de les reparacions, substitucions o intervencions addicionals necessàries, sense que això suposi cap despesa per a la CSMS ni afecti els seus drets a reclamar altres danys derivats.



Un cop la instal·lació es consideri finalitzada, s'emetrà i signarà un acta (Annex III PPT) que acrediti que el sistema de doble calaix és operatiu. La data i signatura d'aquesta acta entre l'adjudicatari i la CSMS marcarà l'inici legal de la garantia de la instal·lació en la seva totalitat.

Tot residu o rebuig originat com a conseqüència de l'actuació del proveïdor serà responsabilitat del mateix. En aquest sentit, seran a càrrec de l'adjudicatari, la recollida i eliminació dels corresponents residus d'acord amb la normativa que sigui aplicable a cada cas.

6.2- Comunicacions

Els lliuraments i las possibles incidències, es comunicaran al departament de compres de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (tel. 93.769.02.01 (ext. 2269/2000) ó e-mail: ajosep@salutms.cat o saraujolopez@salutms.cat

7.- MANTENIMENTS I REPOSICIONS EN GENERAL

Els proveïdors han de garantir els seus productes per un mínim de **2 anys** contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament.

El licitador haurà d'indicar la següent informació:

- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complet i de material fungible.
- Especificar recanvis bàsics i preus dels mateixos.
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir.
- A efectes informatius, oferta de contracte de manteniment correctiu, preventiu, predictiu, amb totes les modalitats possibles. Preu i descripció del manteniment requerit després del període d'aquest contracte, amb la metodologia de treball que proposen per a la prestació d'aquest tipus de servei.
- Tarifa d'assistència tècnica. (mà d'obra i desplaçaments post-garantia).

Estaran inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment de l'empresa adjudicatària durant el període de garantia. Incloent tots els components, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i demás costos que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.

8.- CONFIGURACIÓ DE L'OFERTA

SOBRE A:

- Documentació administrativa que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte (DEUC).

SOBRE B:

- Certificat CE en vigor i certificats compliment normativa vigent, si escau.
- Fitxa tècnica equip, i manuals, segons l'indicat a la clàusules 3 del present PPT.
- Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques.
- Qualsevol altra documentació necessària per a valorar les ofertes del sobre B d'acord amb els criteris de judici de valor prefixats en el Quadre de Característiques Específiques del contracte.



IMPORTANT: Els licitadors no podran, en cap cas, incorporar en el sobre B cap informació que pugui revelar el contingut de la seva oferta avaluable de manera automàtica del sobre C.
Serà motiu d'exclusió incorporar dins del sobre B qualsevol informació que permeti revelar el contingut de l'oferta del sobre C.

SOBRE C:

- Annex Oferta econòmica i altres criteris de valoració automàtica degudament complimentat. S'haurà de presentar en format excel i en format pdf amb la signatura digital del representant legal
- Dins de l'annex s'haurà d'indicar a quina pàgina i en quin apartat de les fitxes tècniques o documentació que s'han d'aportar a la licitació en el sobre C, consta la informació que prova cada un dels criteris automàtics, tenint en compte que aquesta informació no haurà de constar en el sobre B, com s'ha indicat en el quadre d'avís anterior.

Santiago Araujo
Coordinador de Compres
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital.




Annex II PPT: “Plànols zona d’actuació”

1 - Magatzem Urgències PL0






2 - Urgències - Fàrmacs

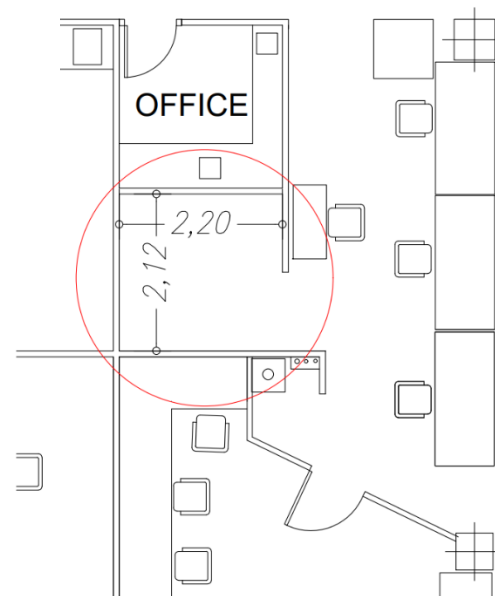





3 - Magatzem UPO - Fàrmacs

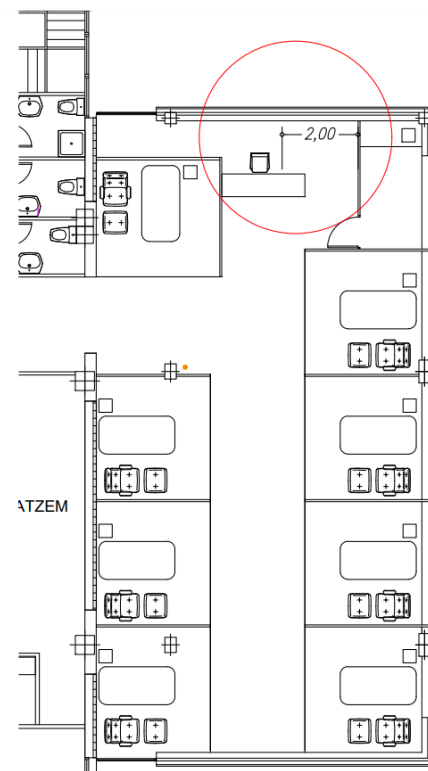





4 - Magatzem Planta 1

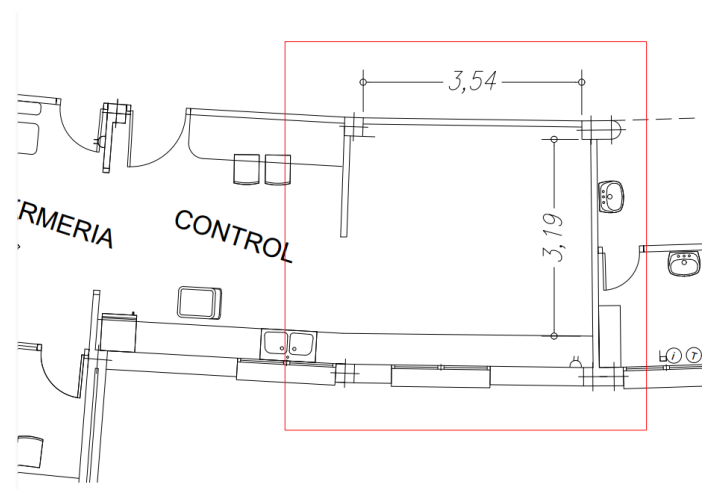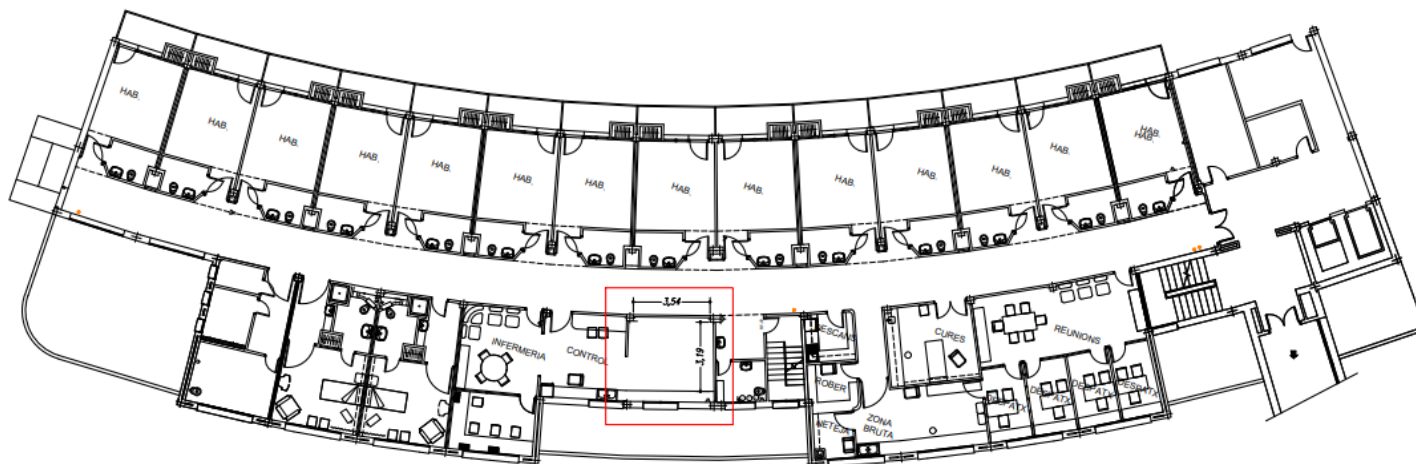





5 - Magatzem Planta 2

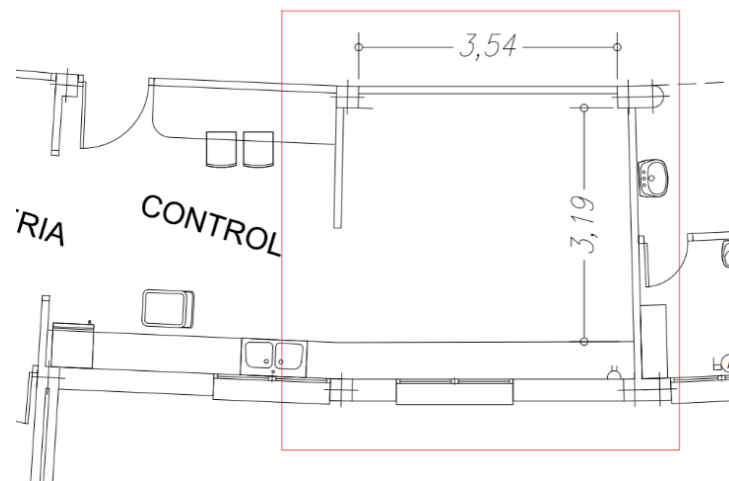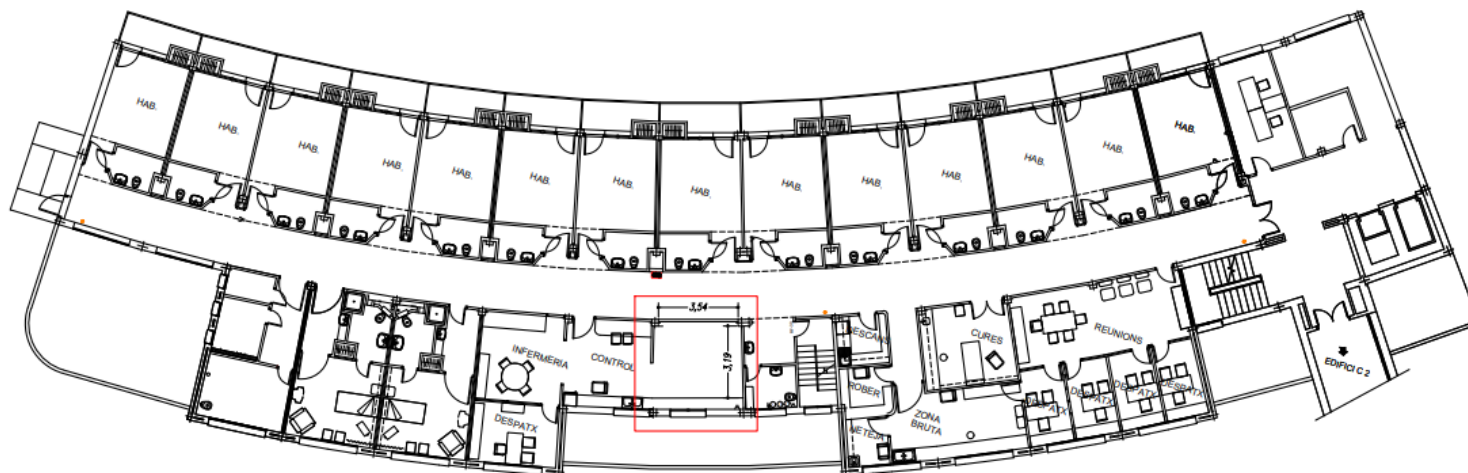





6 - Magatzem Planta 3

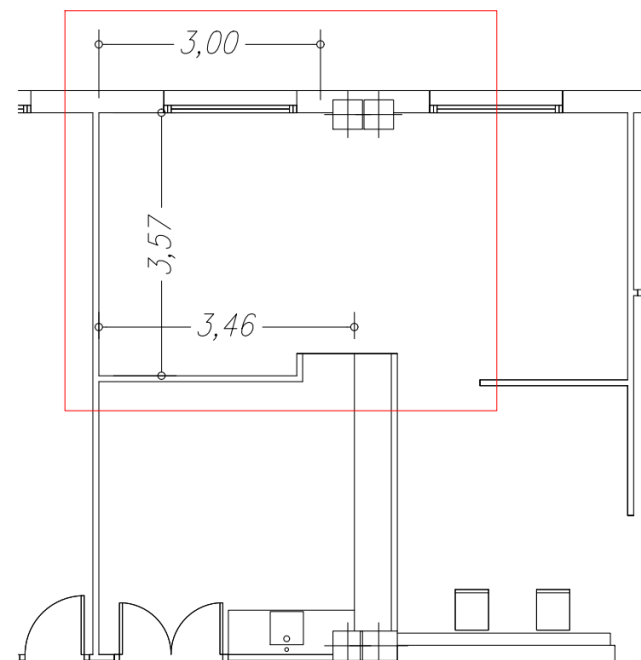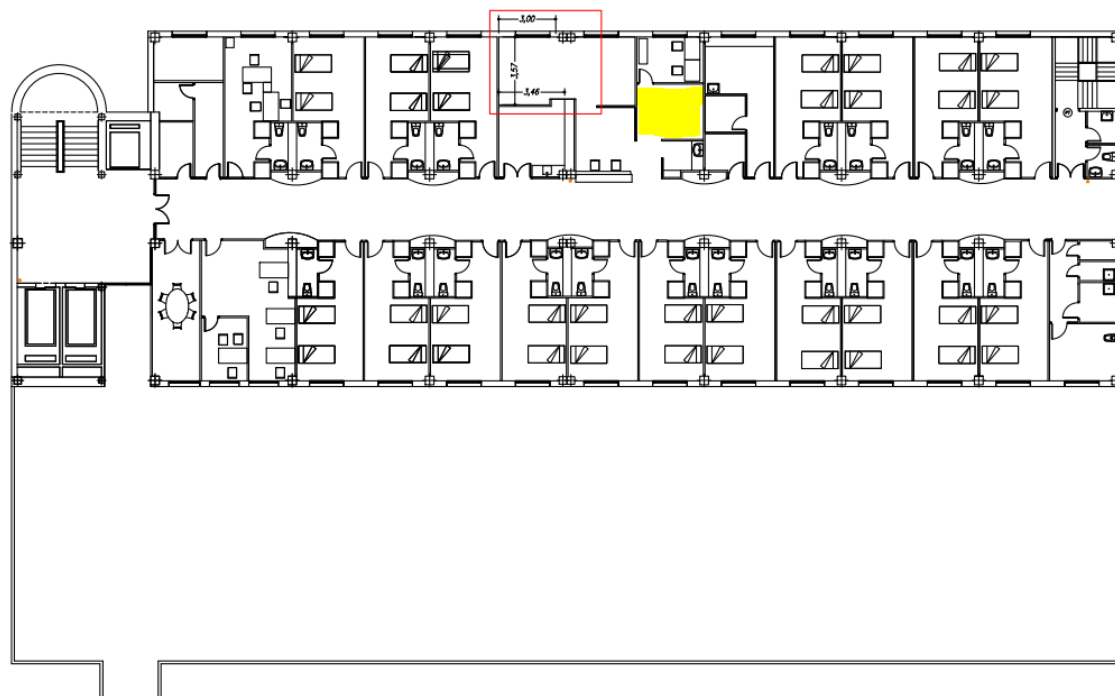




7 - Magatzem Planta 4

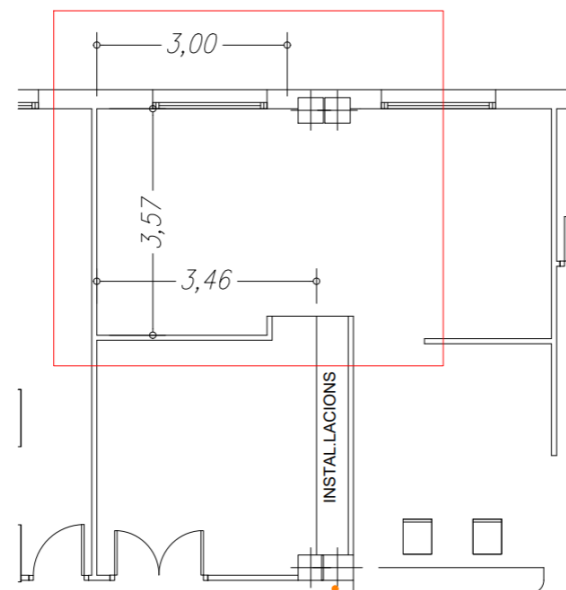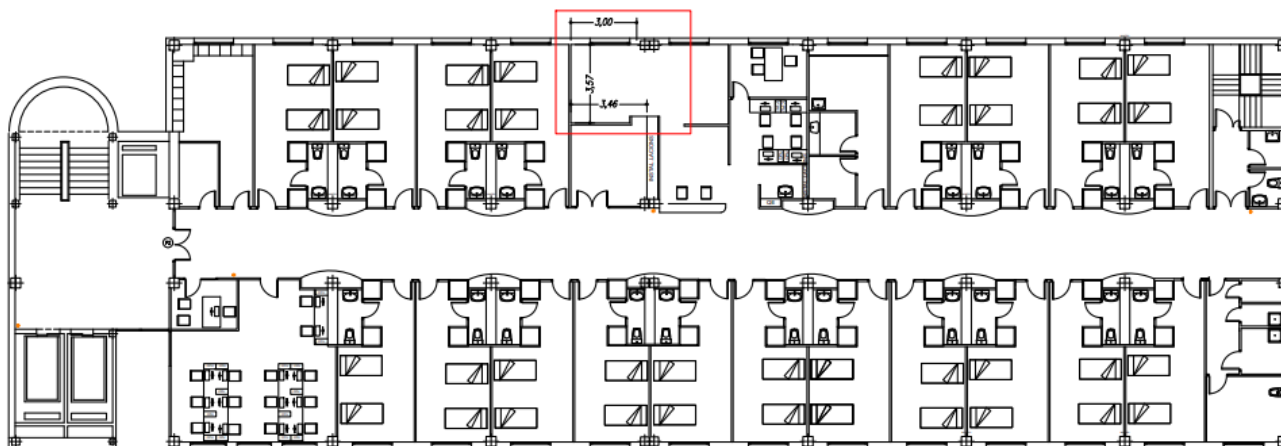



8 - Magatzem Sala de Proves

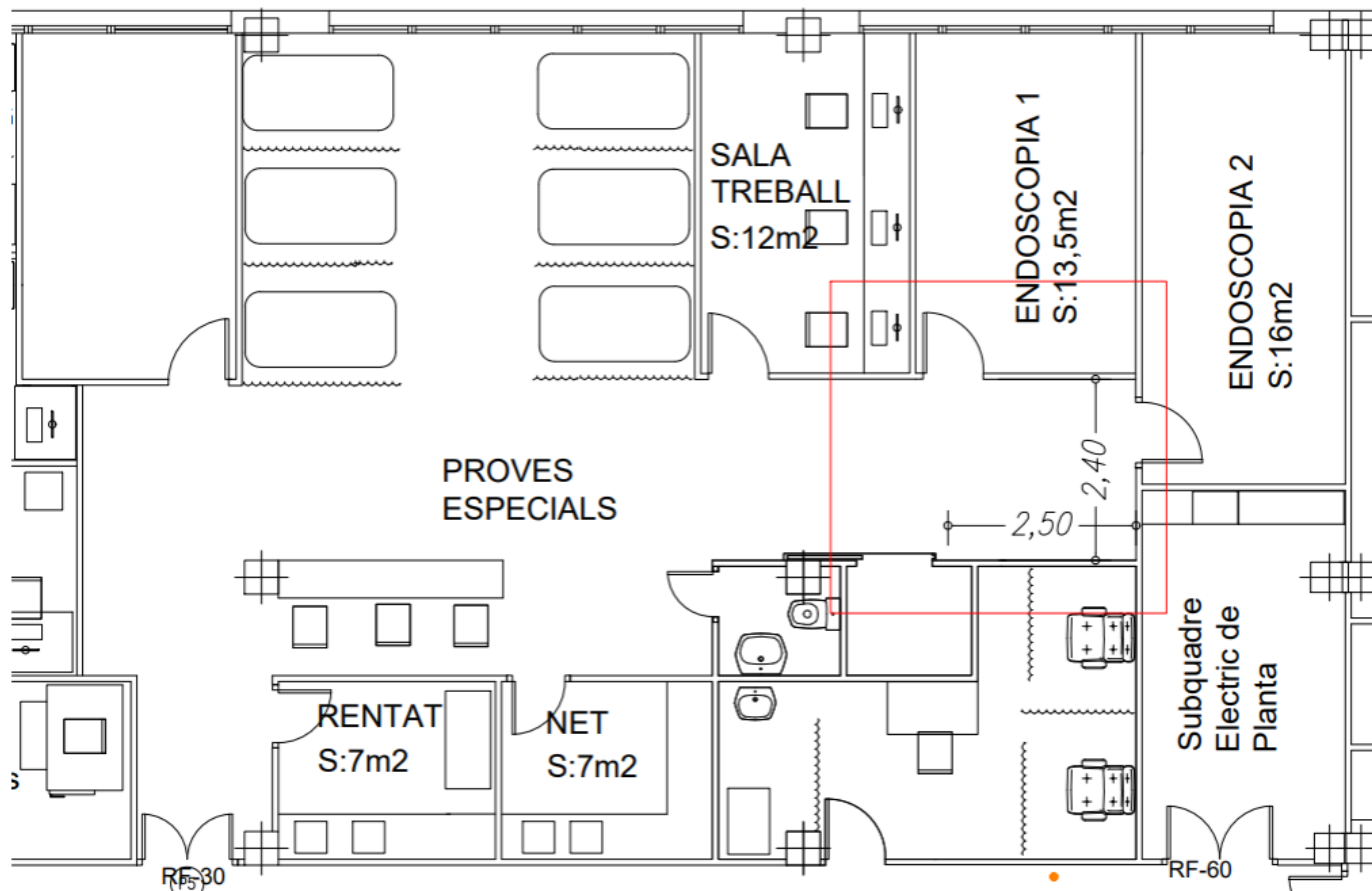



9 - Magatzem CCEE

